SUNRISE MEDICAL

Empulse

F35

Anpassungs- & Bestellleitfaden

1. Kompatibilitätsleitfaden

Ist Ihr Stuhl mit dem F35 kompatibel?

Kompatible Montagehöhe 249 - 370 mm (vom Boden bis zur Oberkante der Klemme)

Kompatible Rahmenbreite 260 - 480 mm (gemessen von Mitte zu Mitte Rahmenrohr)

Version A (EMD010029)
Passend für Rundrohre mit Durchmessern von 19,5 mm, 23 mm, 25 mm, 28,6 mm und 30 mm und QS5 X. Anpassbar durch im Lieferumfang enthaltene Einsätze.

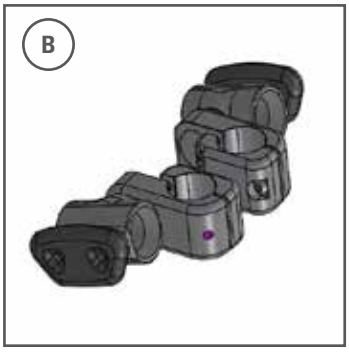

Version B (EMD010030)
Ovale Rohre für Xenon², Xenon² Hybrid, Helium & Nitrum.

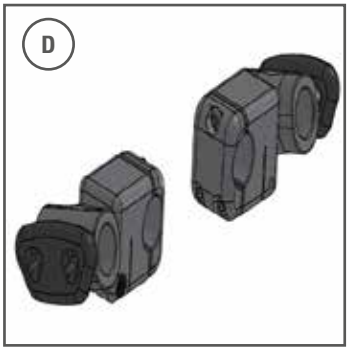

Version D (EMD010031)
Passend für Xenon² SA.

Version G (EMD010062)
Passend für Rundrohre mit Durchmesser von 32 mm.

Hersteller	Modell	Klemme
Sunrise Medical	Nitrum	B
	Nitrum Hybrid	B
	Helium	B
	Xenon²	B
	Xenon² Hybrid	B
	Xenon² SA	D
	Argon²	A
	Neon²	A
	Easy 200	A
	Easy 300 SA	A
	Easy Life R	A
	Easy Life	A
	Easy Life SA	A
	Easy Life T	A
	Easy Life T SA	A
	Easy Life RT	A
	Easy Life i	A
	Easy max	A
	Easy max SA	A
	Easy Life ECO	A
	HeliX²	D
	RubiX²	D
	Basix²	D
	PariX²	D
	UniX²	D
	QS5 X	A
RGK	Tiga	A
	Tiga SUB 4	A
	Tiga FX	A
	Octane	G
	Octane SUB 4	G
	Octane FX	G

2. Wie wird gemessen?

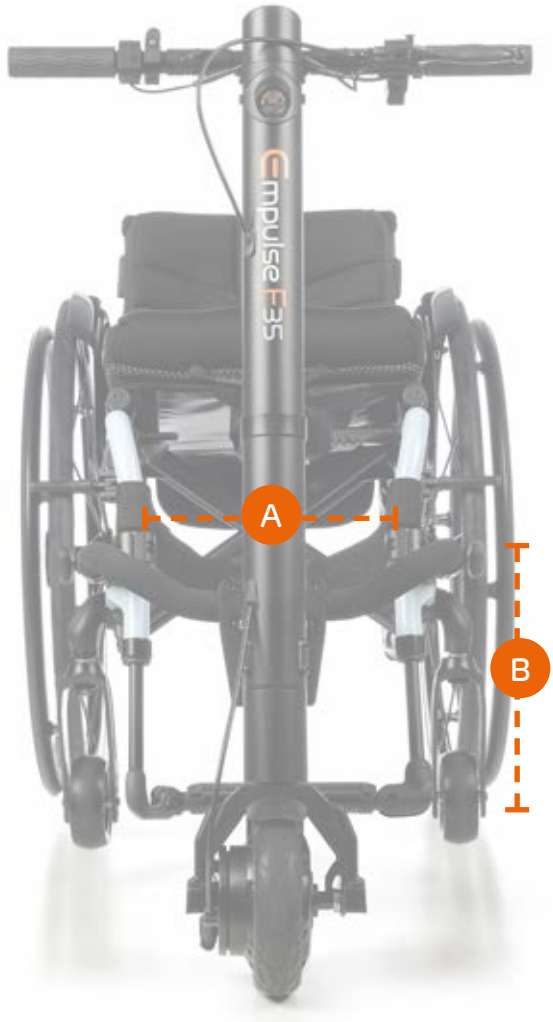

A Die Zwischenrahmenbreite wird von der Mitte bis zur Mitte des Rollstuhlrahmenrohrs in dem Bereich gemessen, in dem die Klemmen angebracht werden sollen, d.h. zwischen **260 und 480 mm**.

- Berücksichtigen Sie eventuelle Einzüge am Rahmen
- **Verwenden Sie nicht die Sitzbreite zur Bestimmung der F35-Zwischenrahmenbreite**

B Die Montagehöhe wird vom Boden bis zur Oberkante der Klemme gemessen. Klemme zwischen **249 und 370 mm**.

3. Bestellvorgang

1) Wählen Sie den Stuhlrahmen aus, an den das F35 montiert werden soll

- Fester Vorderrahmen
- Abschwenkbarer Vorderrahmen

2) Wählen Sie die Andockklemmen für den Stuhl, an dem das F35 montiert werden soll

- Ovalrohr (Xenon^2, Helium, Nitrum)
- Klemmen für Xenon^2 Swing Away
- Rundrohr (anpassbar an 19,5 mm / 23 mm / 25 mm / 25,4 mm / 28,6 mm / 30 mm und QS5 X)
- Rundrohr (32 mm)

3) Wählen Sie die Rahmenbreite für den Stuhl, an dem der F35 montiert werden soll

260 mm	270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm
340 mm	350 mm	360 mm	370 mm	380 mm	390 mm	400 mm	410 mm
420 mm	430 mm	440 mm	450 mm	460 mm	470 mm	480 mm	

4) Wählen Sie die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit

- 6 km/h
- 10 km/h
- 15 km/h

Die Höchstgeschwindigkeit ist nicht programmierbar. Eine Änderung der Höchstgeschwindigkeit kann nur durch den Tausch des Displays vorgenommen werden.

5) Wählen Sie das gewünschte optionale Zubehör

- Smartphone-Halterung
- Spannungswandler für PKW (12 V auf 230 V)
- Zusätzliches Ladegerät
- Diebstahlsicheres Schloss

4. Produktbezogene Überlegungen

Für wen ist das F35 geeignet?

- Nutzer von manuellen Rollstühlen, die sich selbständig fortbewegen; die Steuerung ist nicht für die Verwendung durch eine Begleitperson vorgesehen.
- Nutzer von manuellen Rollstühlen, die mit weniger Anstrengung weiter kommen wollen.
- Nutzer die ausreichende Sensibilität und Kontrolle der oberen Gliedmaßen und Hände haben, um die Bedienelemente, die Lenkung und das Andocken handhaben zu können.
- Nutzer die ein superkompaktes, ultraleichtes Hilfsmittel mit ausreichender Leistung für die Stadt und den täglichen Gebrauch suchen.
- Nutzer die Unterstützung durch ein vorne am Rollstuhl montiertes Zuggerät benötigen oder bevorzugen.
- Nutzer für die ein Zuggerät von großem Nutzen ist, wenn dadurch die Räder vom Boden abgehoben werden, um Hindernisse zu überwinden und Vibrationen zu minimieren.

Einsatzbereiche	
Rollstuhl Kompatibilität	
Flugreisetauglichkeit	
Rollstuhl-Abmaße/Grundfläche	
Manövrierfähigkeit in engen Umgebungen	
Outdoor-Nutzung	
Nutzung für größere Entfernungen	

5. Überlegungen zum Nutzer

Klinische Fragen

- Verfügt der Nutzer über eine ausreichende Handfunktion, um das Andockverfahren zu bedienen?
- Kann der Betroffene sicher lenken und die Bedienelemente steuern?
- An- und Abkoppeln - wie oft am Tag? Verfügt der Nutzer oder die Hilfsperson über die Funktion der oberen Gliedmaßen, um dies regelmäßig zu tun?
- Transfers - das Zuggerät erfordert einen festen Vorderrahmen oder eine Montage am Rollstuhlrahmen, wenn abschwenkbare Beinstützen verwendet werden. Es kann nicht direkt an den abschwenkbaren Beinstützen montiert werden. Würde dies bei Transfers stören?
- Ist der Nutzer in der Lage, das Gerät mit den verfügbaren Geschwindigkeiten und der erforderlichen erhöhten Konzentration, Antizipation und Aufmerksamkeit zu steuern?
- Ist die Sensibilität und Kraft der Hände ausreichend? Die Griffigkeit kann mit Handschuhen verbessert werden, und es gibt ergonomische Griffe mit hoher Griffigkeit, aber alternative Steuergeräte oder Joysticks sind nicht erhältlich.
- Erfüllt diese Technologie die Mobilitätsbedürfnisse für einen angemessenen Zeitraum, oder wäre ein Elektrorollstuhl effektiver für eine größere Auswahl an Sitzmöglichkeiten und die Möglichkeit, sich bei einer Verschlechterung des Zustands zu verändern?

Technische Daten

Reichweite	15 km
Max. Nutzergewicht	110 kg
Max. Geschwindigkeit	6 km/h; optional 10 oder 15 km/h (regulierbar in 3 Stufen)
Motorleistung (max Leistung)	250 W nominal, max. 400 W bürstenlos
Max. sichere Steigung	6° Steigung mit 110 kg Nutzergewicht
Breite	510 mm (Griffe ausgeklappt)
Gesamtgewicht	7,5 kg
Batterie	Lithium-Ion 36 V, 4 Ah Intelligentes Batterie-Management & 21700 er-Akkuzellen Nach IATA zugelassen für Flugreisen
Radgröße	6,5" Vollgummi
Bremse	Duales Bremssystem (mechanische Trommelbremse und separate proportionale elektronische Motorbremse), sowie Feststellbremse

SUNRISE MEDICAL

Kahlbachrig 2-4, 69254 Malsch/HD
T: +49 (0) 7253/980-0 | E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical ist um Ihre Sicherheit besorgt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den sicheren Betrieb, Anweisungen und Wartungsrichtlinien. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich Sunrise Medical das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen. Die neuesten Informationen finden Sie unter www.sunrisemedical.de.