

 Sittsystem

 Siddesystem

 Istuinjärjestelmä

000690810.04

Sledo Lite

Sittsystem bruksanvisning

Sædemanual

Istuimen käyttöopas



SUNRISE MEDICAL innehavar ett ISO 13485-certifikat, vilket säkerställer våra produkters kvalitet i varje led från FoU till produktion. Tillval eller tillbehör finns tillgängliga till extra kostnad.

Kørestolskomponenter

DK




SUNRISE MEDICAL er godkendt i henhold til ISO 13485, som bekræfter kvaliteten af vores produkter på alle stadier, fra udvikling til produktion. Det viste ekstraudstyr eller tilbehør kan købes mod tillægspris.

Pyörätuolin osat

FI



SUNRISE MEDICALille on myönnetty ISO-13485-sertifikaatti, joka takaa tuotteidemme korkean laadun kaikissa tuotantovaiheissa suunnittelusta valmistukseen. Esitettyt lisälaitteet ja -varusteet ovat saatavilla lisämaksusta.

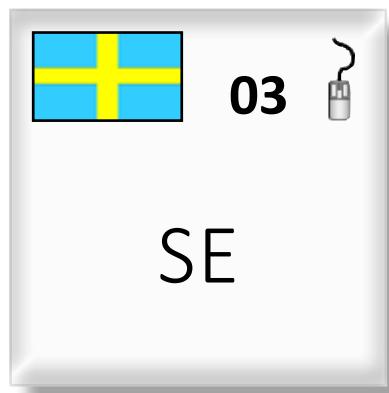

Om du har några frågor kring användning, underhåll eller säkerhet för ditt sittsystem, kontakta ditt lokala auktoriserade Sunrise Medical-serviceombud. Om det inte finns något auktoriserat Sunrise Medical-ombud eller hjälpmedelscentral i närlheten av där du bor, eller du har någon övrig fråga, får du gärna skriva eller ringa till Sunrise Medical AB (se adress och telefonnummer nedan)

Sunrise Medical AB

Neongatan 5

431 53 Mölndal

Sweden

Tel.: +46 (0)31 748 37 00

post@sunrisemedical.se

www.SunriseMedical.se



ISO 7010-M002
**Bruksanvisning/häfte måste
läsas! (blå ikon)**

Återförsäljarens underskrift och stämpel

Innehåll

1.0 Information till användare	5
1.1 Denna bruksanvisning	5
1.2 För ytterligare information	5
1.3 Symboler används i denna bruksanvisning	5
2.0 Säkerhet	6
2.1 Symboler och etiketter använda på denna produkt ..	6
2.2 Säkerhet: Temperatur	6
2.3 Säkerhet: Rörliga delar	6
2.4 Säkerhet: Kvävningsrisk	6
2.5 Säkerhet: Brickor	7
3.0 Allmän beskrivning	7
4.0 Inställning av sittsystemet	8
4.1 Förinställning av sittdjup	8
4.2 Förinställd sittbredd	9
4.3 Förinställt ryggstöd (denna justering kan endast utföras av en yrkesutbildad)	10
4.4 Förinställning av ryggmonterat uppfällbart armstöd med recline-funktion	12
4.5 Förinställning av centermonterat avtagbart armstöd	13
4.6 Förinställning av centermonterat fällbart armstöd	13
4.7 Sidoskydd	16
4.8 Förinställning av centralmonterat benstöd	17
4.9 Förinställning av fast centermonterat benstöd	18
4.10 Förinställning av centralmonterat eldrivet benstöd	19
4.11 Förinställning av SEDEO LITE swing away-benstöd	20
4.12 Förinställning av UNI swing away-benstöd	20
4.13 Förinställning av swing-away benstöd	21
4.14 Förinställning av nackstöd	22
4.15 Förinställning av fast/swing away fäste för styrenhet	23
4.16 Förinställning av inkapslad swing-away styrenhet	24
4.17 Förinställning av sidostöd	25
4.18 Förinställning av lateralt swing away-knästöd / lårstöd	26
4.19 Förinställning av abduktionsknapp	26
4.20 Höftbälte/positioneringsbälte	27
5.0 Användning av sittsystemet	28
5.1 Komma i och ur rullstolen (överförflyttning)	28
5.2 Förbereda sig för överförflyttning framåt	28
5.3 Förbereda sig för sidaöverföring	29
5.4 Nackstöd	30
5.5 Swing-away styrenhetsfäste	30
5.6 Sidostöd (Fig. 5.11)	30
5.7 Knästöd / Lårstöd (Fig. 5.12)	31
5.8 Hemiplegi armstöd (Fig. 5.13)	31
5.9 Abduktionsknapp (Fig. 5.14)	31
6.0 Manuella och eldrivna tillval	32
6.1 Manuella sitstillval	32
6.2 (El)sitstillval	33
7.0 Reducering av sittsystemets storlek för transportsyften	34
7.1 Sittdyna	34
7.2 Ryggstödsdyna	34
7.3 Nedfällning av ryggstödet (Fig. 7.4)	35
7.4 Nedfällning av bakåtlutande ryggstöd (Fig. 7.5)	35
7.5 Swing-away-benstöd (Fig. 7.6)	36
7.6 Löstagbara armstöd.	36
8.0 Underhåll och rengöring	37
8.1 Allmänt underhåll	37
8.2 Rengöring av sittsystemet	37
8.3 Hygienåtgärder för begagnade rullstolar:	37
8.4 Allmänna rengöringsanvisningar:	38
8.5 Rengöringstillbehör:	38
8.6 Rengöra manöverboxen:	38
8.7 Förvaring	38
9.0 Avfallshantering	39
10.0 Tekniska specifikationer:	40
10.1 Tillämpliga normer/standarder	40
10.2 Tekniska specifikationer: Sittsystem Sedeo Lite	41
11.0 Garanti	43

1.0 Information till användare

Tack för ditt val av en rullstol från Sunrise Medical. Sunrise Medicals mobila kvalitetsprodukter är designade för att förstärka ditt oberoende och göra ditt vardagsliv enklare.

1.1 Denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning hjälper dig att använda och underhålla ditt sittsystem på ett säkert sätt. Denna bruksanvisning för sitsar är ett komplement till Sunrise Medicals generella bruksanvisning för rullstolar:

- Den allmänna bruksanvisningen för rullstolen
- Bruksanvisning för sittsystem (detta häfte)
- Bruksanvisning för styrenhet.

Vid behov hänvisar denna allmänna bruksanvisning för sittsystem till andra bruksanvisningar enligt nedan:

- | | |
|---|---|
|  Allmänna bruksanvisning: | Hänvisar till allmän bruksanvisning för rullstolar. |
|  Styrenhet: | Hänvisar till bruksanvisning för styrenhet. |
|  Batteriladdare: | Hänvisar till bruksanvisning för batteriladdare. |

Använd inte din rullstol förrän hela bruksanvisningen (och alla andra häften) har lästs och förståtts!

Om någon av bruksanvisningarna inte inkluderades med din rullstol, kontakta din återförsäljare omedelbart. Utöver den här bruksanvisningen finns det också en servicehandbok för kvalificerade specialister.

1.2 För ytterligare information

Kontakta din hjälpmedelscentral om du har frågor gällande användning och underhåll av, eller säkerhet kring, din rullstol. Om du inte fått din rullstol via en hjälpmedelscentral eller om du har några frågor till oss, kontakta Sunrise Medical antingen per brev eller telefon.

För information kring produktsäkerhetsnotiser och återkallade produkter, gå till www.SunriseMedical.se

1.3 Symboler används i denna bruksanvisning

 **FARA/VARNING!**


Potentiell risk för personskada eller allvarlig skada eller dödsfall

 **OBS/VIKTIGT!**


Potentiell skada på utrustning.

Om du inte följer dessa anvisningar kan det resultera i fysiska skador, skador på produkten eller skador på miljön!

Meddelande till brukaren och/eller patienten: En allvarlig incident som inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där brukaren och/eller patienten är etablerad.

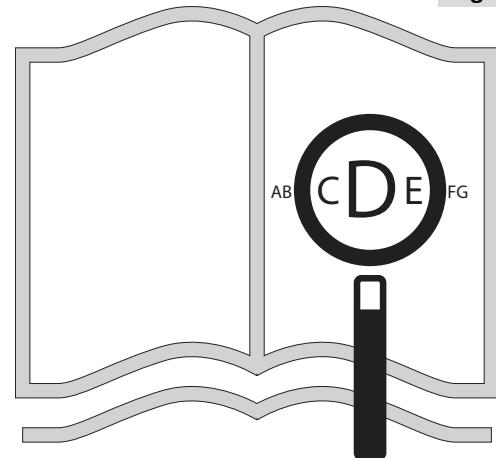

Om du är synskadad kan detta dokument visas i PDF-format på
www.SunriseMedical.se

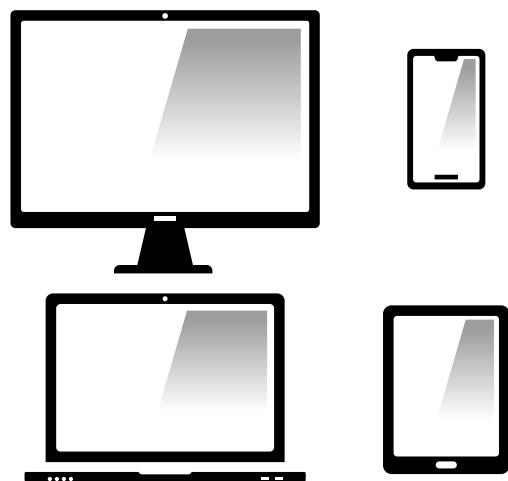

eller också på begäran i stor text.



2.0 Säkerhet

Följ anvisningarna bredvid dessa varningssymboler noggrant!

Undlåtenhet att följa dessa anvisningar kan resultera i fysiska skador, skador på rullstolen eller miljön. När möjligt, finns säkerhetsinformation i det relevanta kapitlet.

2.1 Symboler och etiketter använda på denna produkt

Skytar, symboler och anvisningar som fästs på rullstolen omfattar del av säkerhetsutrustning. De får aldrig täckas över eller tas bort. De måste förbli intakta och vara tydligt läsbara under hela rullstolens livslängd.

Byt ut eller reparera alla oläsliga eller skadade skytar, symboler och anvisningar omedelbart. Kontakta din hjälpmedelscentral/återförsäljare för assistans.

Fig. 2.1: Varning – Klämrisk.

Fig. 2.2: Varning – Tillse att sitsinfästningens snabbkoppling är ordentligt åtskruvad innan du använder rullstolen, särskilt på sluttande underlag

Fig. 2.3: Varning – Kör inte rullstolen i en sluttning med ryggstödet tillbakalutat och/eller sitsen i stående läge

2.2 Säkerhet: Temperatur

 **FARA/VARNING!**

- Om du inte använder rullstolen, se till att den inte utsätts för direkt solljus under längre perioder. Vissa delar av rullstolen, såsom sitsen, ryggen och armstöden kan bli varma om de har utsatts för starkt solljus under lång tid. Detta kan orsaka brännskador eller allergiska reaktioner på huden.

2.3 Säkerhet: Rörliga delar

 **FARA/VARNING!**

En rullstol har rörliga och roterande delar. Kontakt med rörliga delar kan orsaka allvarliga personskador eller skador på rullstolen. Kontakt med rörliga delar på rullstolen bör undvikas.

- Elektrisk tilt för justering av utrymme
- Elektrisk sitslift som tillval
- Elektrisk justering för bakåtlutning
- Swing-away konsoll för styrenhet

2.4 Säkerhet: Kvävningsrisk

 **FARA/VARNING!**

Detta förflyttningshjälpmittel använder små delar som under vissa omständigheter kan utgöra en kvävningsrisk för små barn.

Fig. 2.1

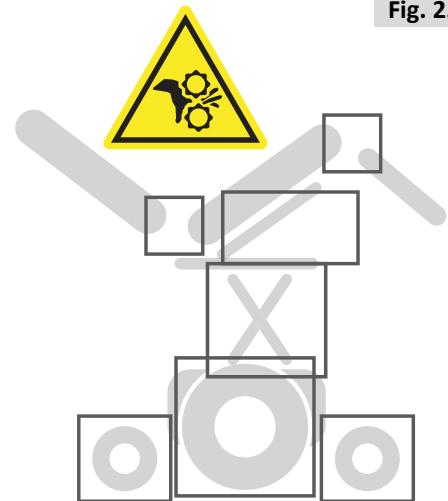


Fig. 2.2



Fig. 2.3



2.5 Säkerhet: Brickor

Säkerhet: Bricka/hållare för ventilator

⚠️ FARA/VARNING!

Om en ventilator monteras på rullstolen kommer dess stabilitet och totalvikt att påverkas.

- Tillse att ventilatorn och batterierna är ordentligt fastmonterade på brickan/hållaren före färd.
- Innan du kör med ventilator på rullstolen, vänj dig vid att rullstolen nu tar mer plats, så att du undviker kollisioner.
- Ska du vinkla ned ryggstödet, kontrollera först att ventilatorn inte är i vägen.
- Observera att ventilatorn utgör en klämrisk för fingrarna när ryggstödet vinklas bakåt.
- Brickan/hållaren ventilatorn monteras på är avsedd endast för andningshjälpmidel och tillhörande batterier, men inte exempelvis en syrgastub. Placering av främmande föremål på brickan kan leda till att rullstolen blir instabil.
- Ventilatorbrickan måste monteras och underhållas av en Sunrise-återförsäljare.

Säkerhet: Svängbart bord:

⚠️ FARA/VARNING!

- Högsta tillåtna vikt för bordet är 2,5 kg.
- Överbelämra inte bordet, det kan gå sönder och stolen kan bli instabil.
- Bordet kan skadas av brinnande cigaretter eller andra värmekällor.
- Se till att alla kroppsdelar och kläder är fria vid placering av brickor för användning.

3.0 Allmän beskrivning

Denna rullstol är utrustad med Sedeo Lite sittsystem. Sedeo Lite sittsystem erbjuder utmärkt stöd för huvud, bål, armar och ben. Optimalt kroppsstöd understödjer maximal självständighet för rullstolsbrukaren.

Rullstolen måste justeras av en kvalificerad specialist. Felaktiga inställningar kan ha negativa konsekvenser för sittställningen.

Huvudkomponenter (Fig. 3.1):

1. Nackstöd
2. Styrspak
3. Armstöd
4. Sittdyna
5. Benstöd
6. Ryggstöd

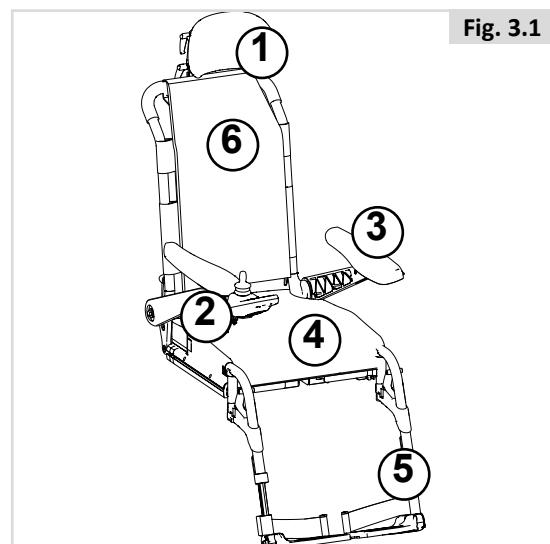


Fig. 3.1

4.0 Inställning av sittsystemet

Den genomsnittliga rullstolsbrukaren finns inte. Det är orsaken till varför Sunrise Medicals rullstolar kan förinställas till brukarens specifika behov.

Förinställningar utförs en gång första gången rullstolen ska användas. Dessa måste utföras av en kvalificerad specialist, såvida inte annat anges uttryckligen.

Verktyg och kalibreringsmarkeringar

En M5 insexyckel bör användas av en fackman för att justera alla inställningar i sittsystemet.


⚠️ OBS/VIKTIGT!

Det finns kalibreringsmarkörer på olika delar av sittsystemet. Tidigare fabriksinställningar indikeras.

4.1 Förinställning av sittdjup

Ryggstöd ramdjup (Fig. 4.1):

1. Lossa (A) ett varv på båda sidor.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

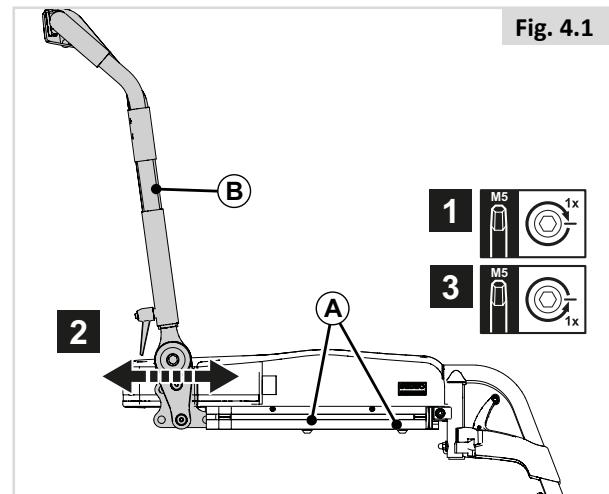

⚠️ OBS/VIKTIGT!


Vid SD 535 och 560 bör du ta ut (A) helt och justera dem i nästa skåra.

⚠️ OBS/VIKTIGT!

- När ett större sittdjup krävs se till att kablarna förlängs innan den mekaniska justeringen sker.

Sittdyna djup (Fig. 4.2)

För sittdynans position (för sittdynor med inbyggd sittplatta) använd hålen fig. 4.2. Dynan kan positioneras i ytterligare ett läge framåt för att skapa extra sittdjup.

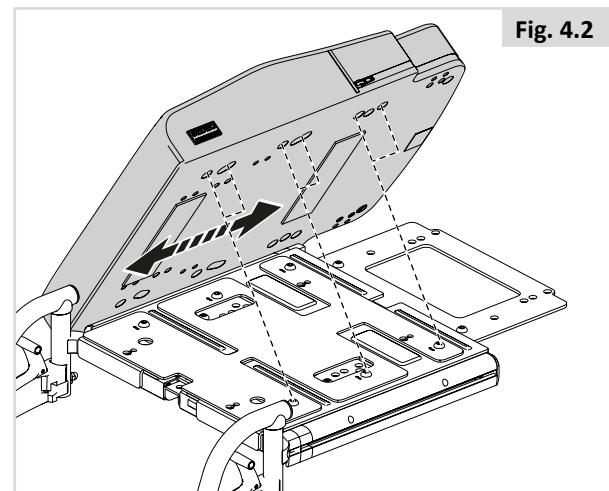


4.2 Förinställd sittbredd

För att justera sittramen behöver sittplattan och ryggramens bredd justeras samtidigt. För en enkel förklaring nämns dessa i fig. 4.3, 4.4 och 4.5 separat.

Sitram bredd (Fig. 4.3)

Lyft av sittdynan från kardborrebanden (Velcro®) för åtkomst till sittplattorna.

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

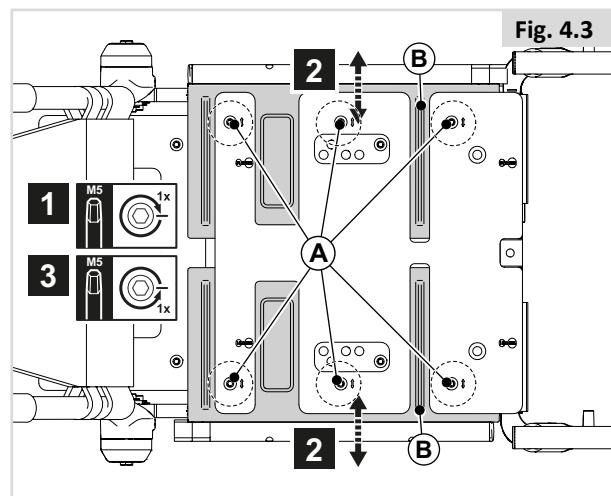

Ryggram bredd (Fig. 4.4)


1. Öppna höljet
2. Ta ut (A) helt.
3. Justera (B) till önskat läge.
4. Montera (A).
5. Stäng höljet



Det finns två storleksinställningar för ryggramens breddjustering. En för 385-485 mm och en för 460-510 mm.

Ryggramsbredd för eldriven bakåtlutning (Fig. 4.5)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

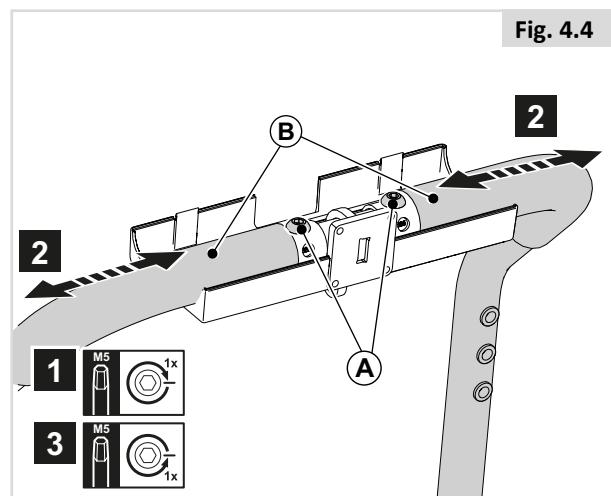



Centermonterat fällbart ryggstöd bredd (tillval) (Fig. 4.6)

Finjusteringar kan endast göras med armstöden.

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).



Kontrollera att den nya armstödspositionen inte stör något sittläge.

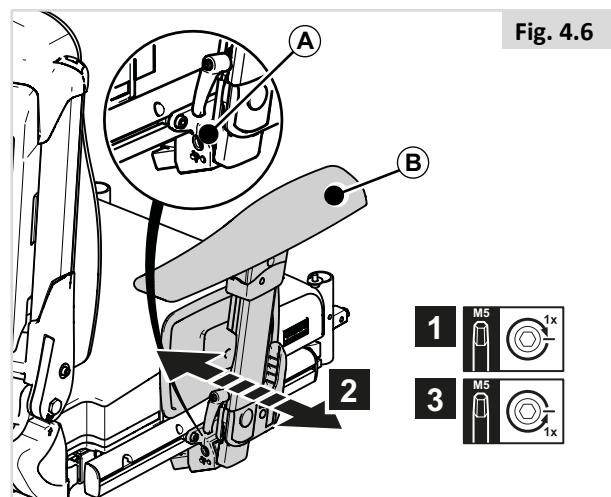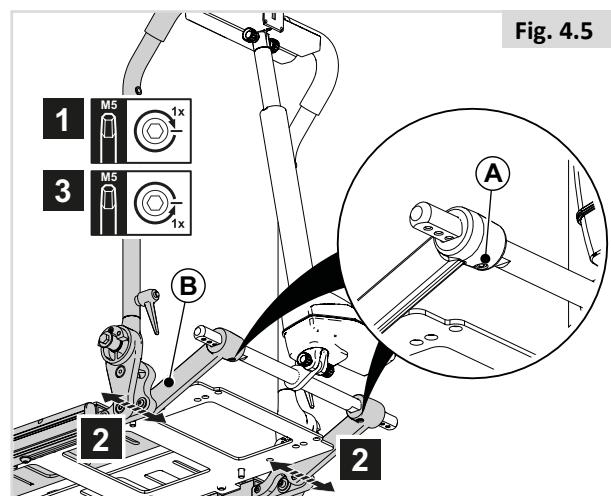

4.3 Förinställt ryggstöd (denna justering kan endast utföras av en yrkesutbildad)

Ryggstödsvinkel (Fig. 4.7)

1. Lossa (A) för att frigöra (B)
2. Justera (B) till önskat läge för att justera (C).
- Rotera (B) 180° för att uppnå -4°, 4°, 12°..
3. Dra åt (A)

OBS: Sprintar måste vara på insidan av hålen och plattan (B) måste fästas inriktad mot ytan.

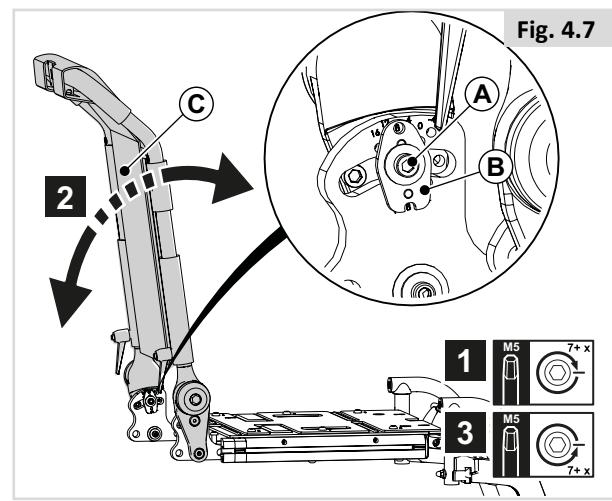


Fig. 4.7

Ryggstödshöjd för hängmatterygg (Fig. 4.8)

1. Avlägsna (A) genom att öppna (B).
2. Ta ut (C) helt.
3. Justera (D) till önskat läge.
4. Dra åt (C).
5. Ersätt (A).

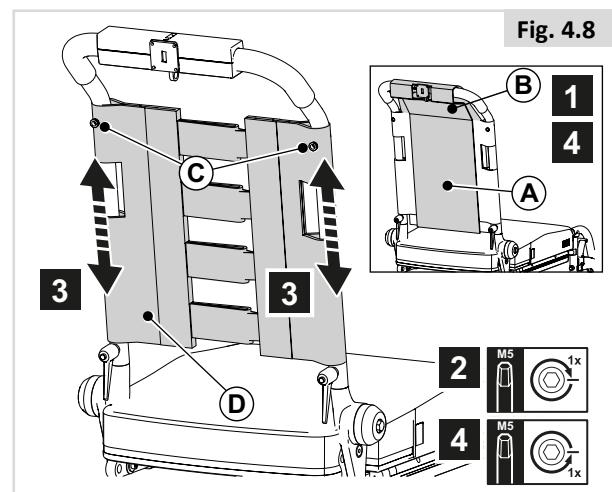


Fig. 4.8

Ryggstödshöjd SEDEO LITE Ryggdyna (Fig. 4.9)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

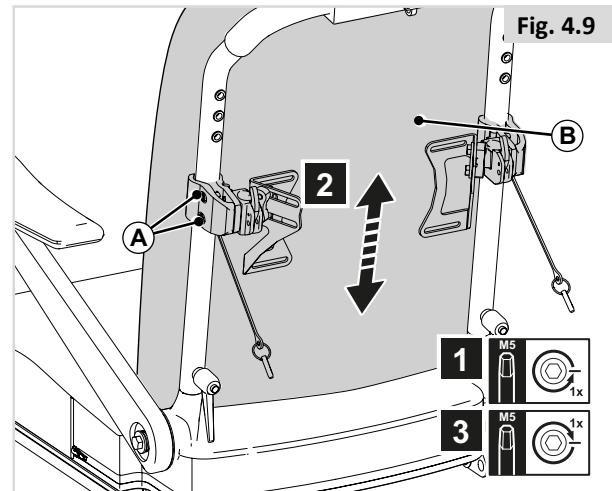


Fig. 4.9

Hängmatterygg med justerbara remmar (Fig. 4.10)

Rullstolen har en hängmatterygg som kan justeras efter ryggens krökning för att uppnå en bekväm sittställning och bra stabilitet. Brukaren kan sitta i stolen när du justerar kurvatur på rygg.

1. Fällbar (A).
2. Lossa eller spänn åt (B) med kardborreband.

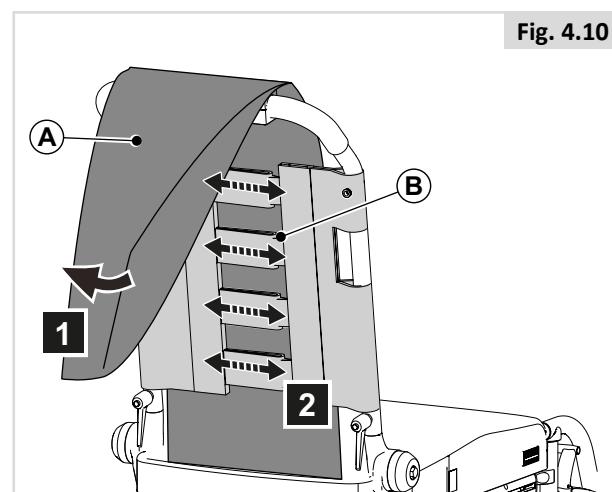


Fig. 4.10

OBS/VIKTIGT

Följande åtgärder får endast utföras av en tekniker som utbildats av Sunrise Medical.

Om du har en bakåtlutande rygg och remmarna är för lösa kan brukaren känna ställdonet genom ryggen. I detta fall kan ställdonet vridas 180° för att skapa mer utrymme (Fig. 4.11).

1. Avlägsna (A)
2. Vrid (B)
3. Återspänn (A)

OBS/VIKTIGT

Kablaget kan behöva återjusteras.

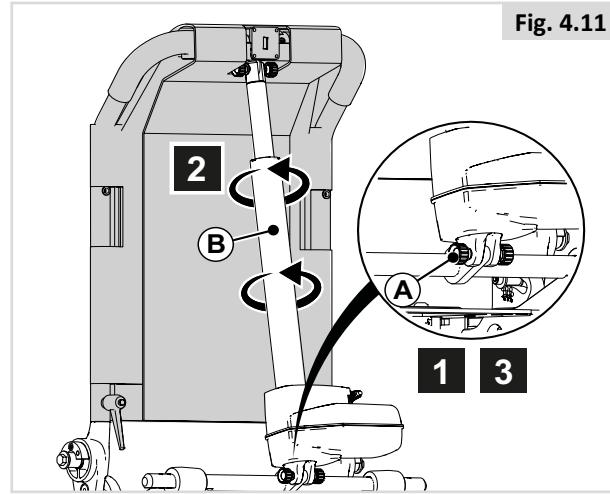


Fig. 4.11

Ryggstöd flexibel sidostödsvinkel (Fig 4.12)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Ryggstöd flexibel kurvatur/krökning (Fig 4.13)

Rullstolen har en polstrad rygg med 6 band för anpassning till ryggens kurvatur, detta för att uppnå en behaglig sittkomfort och god stabilitet. Användaren kan sitta i rullstolen när justeringar görs för krökningen av ryggstödet.

1. Öppna blixtlåset
2. Tryck A för att frigöra bandet
3. Lossa eller spänn varje band individuellt
4. Lossa A för att behålla bandets inställning

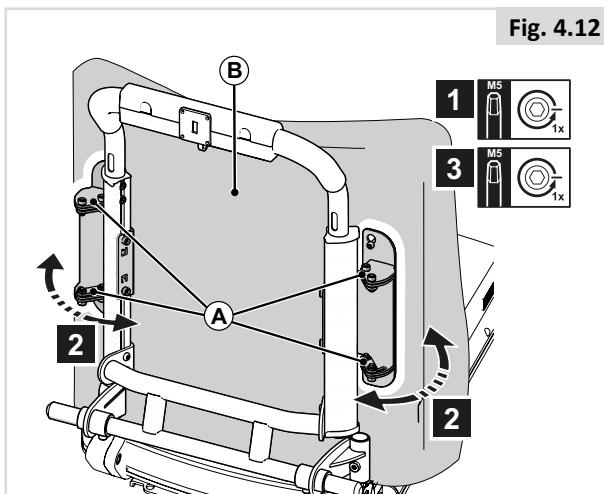


Fig. 4.12

J3 ryggstöd, (Fig. 4.14)

OBS: Jay 3 ryggstöd kan användas i kombination med Sedeo Lite sittsystem. Se J3 Rygg bruksanvisning för montering och justering.

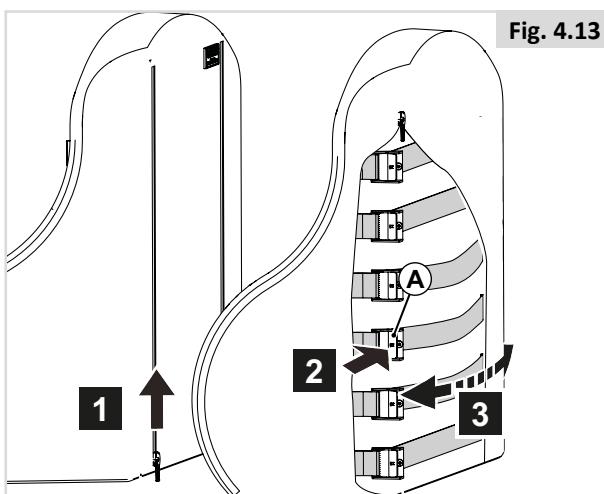


Fig. 4.13

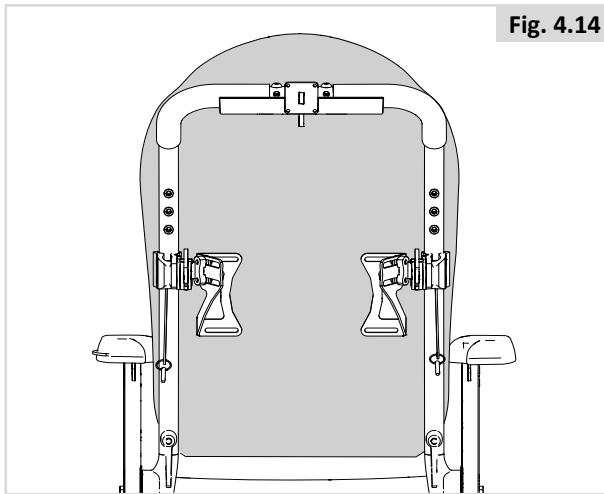


Fig. 4.14

4.4 Förinställning av ryggmonterat uppfällbart armstöd med recline-funktion

Armstödshöjd

Fin- eller grovjustering är en tvådelad process:

DEL 1 (Fig. 4.15)

- Vrid (A) för att justera (B).

DEL 2 (Fig. 4.16)

- Lossa (A) ett varv.
- Justera (B) till önskat läge.
- Dra åt (A).

Armstödsdyna djup (Fig. 4.17)

- Lossa (A) ett varv.
- Justera (B) till önskat läge.
- Dra åt (A).

OBS

För att nå den bakre skruven för att sänka armstödets höjd, lossa skruvarna (A) i Figur 4.16 och justera vinkeln på dynan först.

FARA/VARNING!

Alla skruvar bör kontrolleras periodvis för åtdragning. Om armdynan är lös kan den glida ner vid tryck.

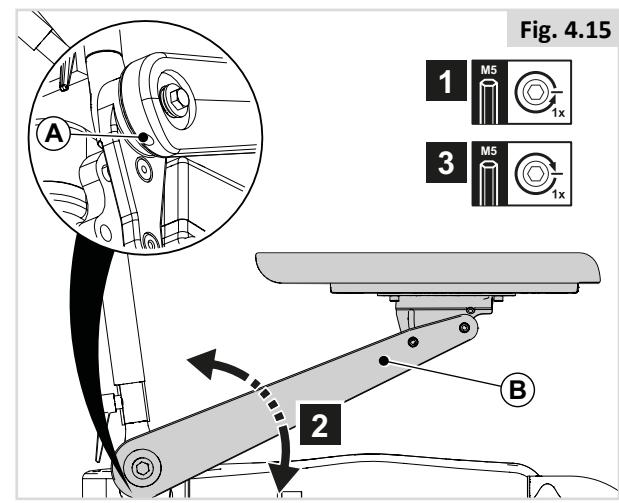


Fig. 4.15

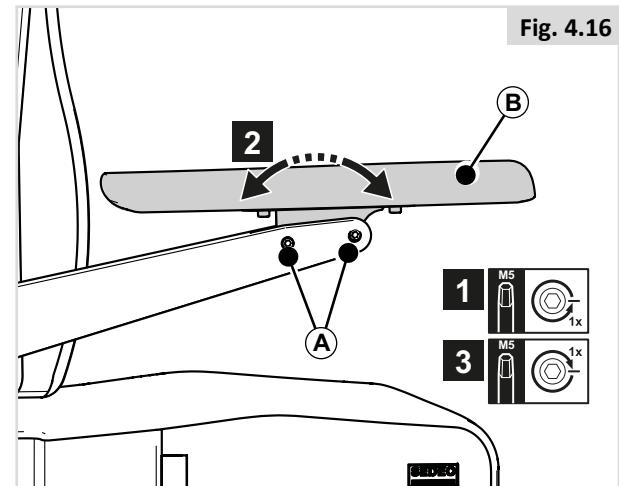


Fig. 4.16

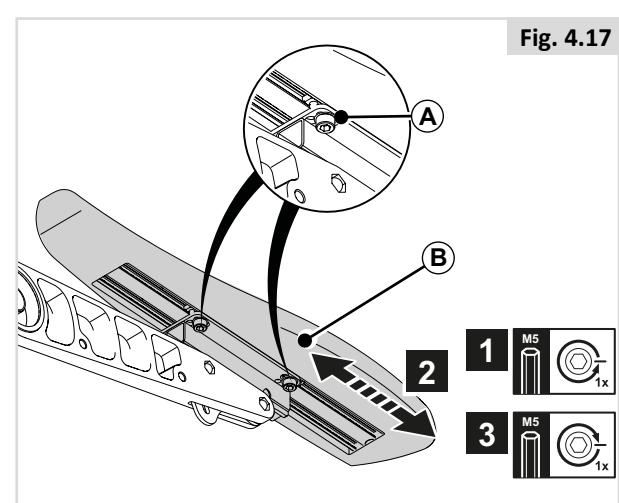


Fig. 4.17

4.5 Förinställning av centermonterat avtagbart armstöd

Armstödshöjd (Fig. 4.18)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Armstödsdjup (Fig. 4.19)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Lossa (B)
3. Justera (C) till önskat läge.
4. Dra åt (A) och (B).

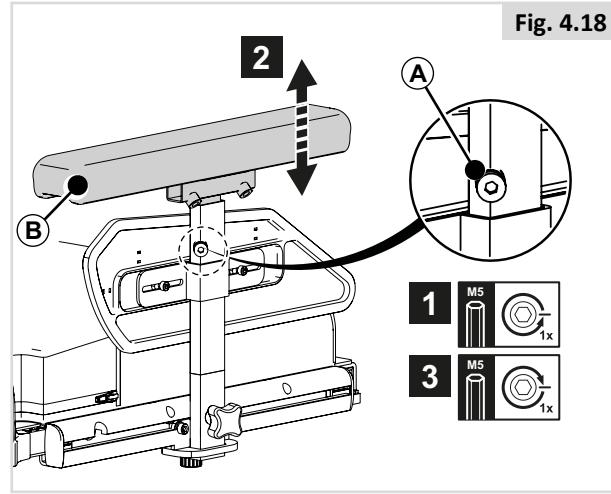


Fig. 4.18

4.6 Förinställning av centermonterat fällbart armstöd

Armstödshöjd (Fig. 4.20)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Se till att armarna understöds väl utan att axlarna skjuts uppåt.

Armstödsdjup (Fig. 4.21)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Positionera det fällbara armstödet ytterligare bakåt för att få mer utrymme för överförflyttningar sidledes. Positionera armstödet ytterligare framåt för att få mer utrymme för överförflyttningar framåt.

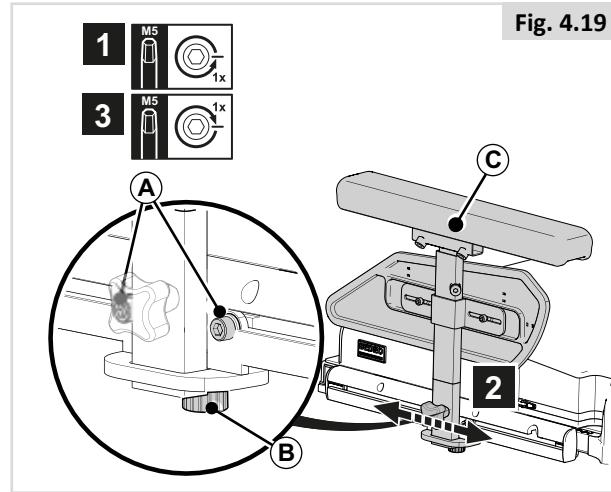


Fig. 4.19

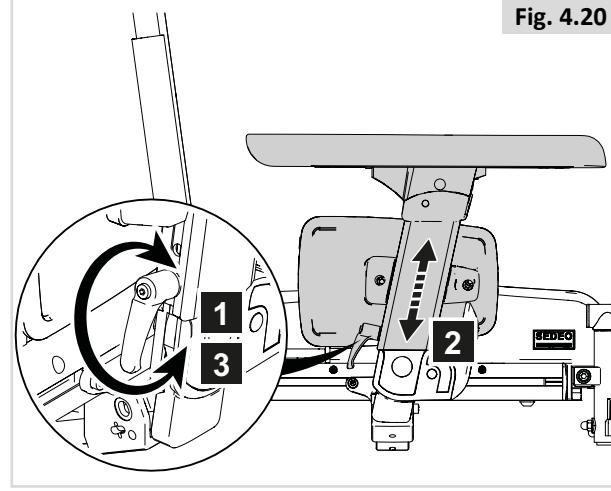


Fig. 4.20

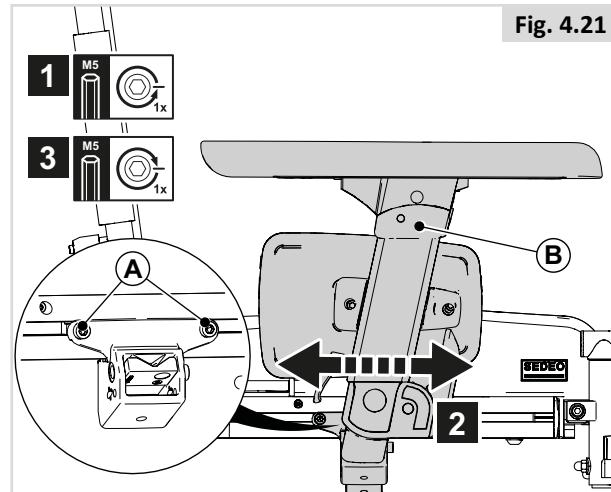




Fig. 4.21

Armstödsvinkel (Fig. 4.22)


1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Sidoskydd höjd (Fig. 4.23)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

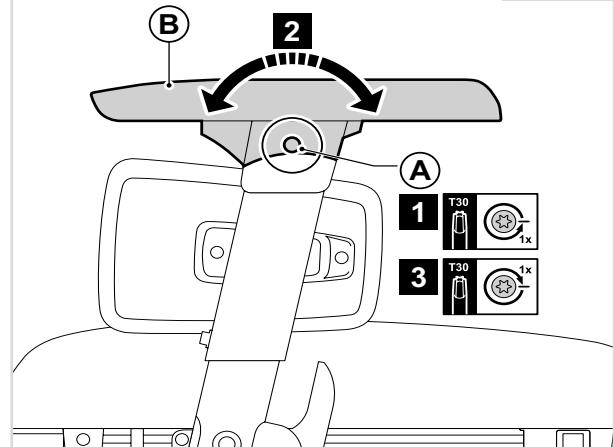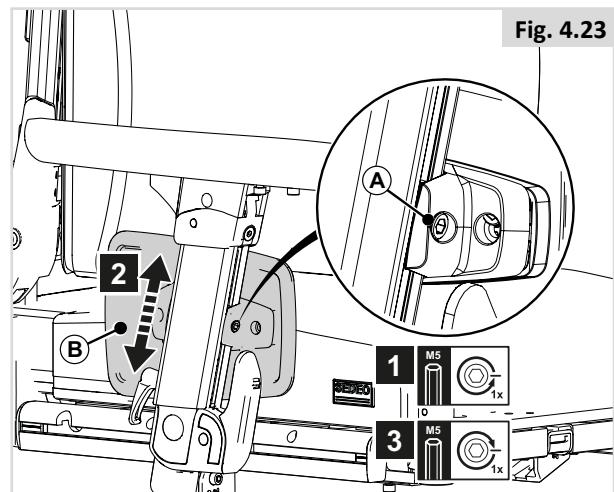Fig. 4.22**Fig. 4.23****Armstödsdyna djup (Fig. 4.24)**

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

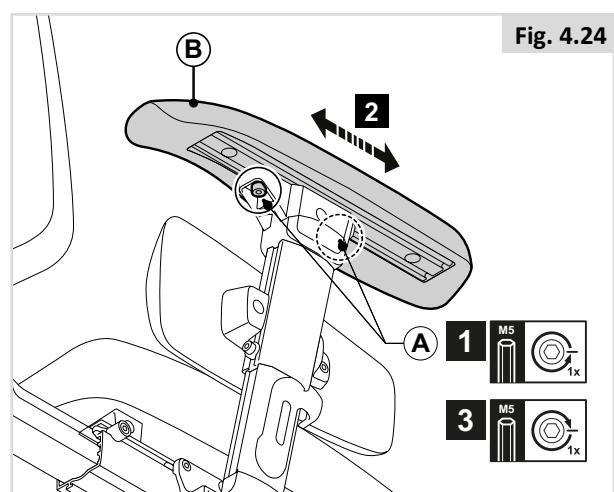Fig. 4.24

Armstödsdyna bredd (Fig. 4.25-4.28)

Fig. 4.25

För att ta bort:

1. Lossa (A).
2. Avlägsna (B).
3. Lossa (E) ett varv.
4. Avlägsna (B).

För att positionera:

1. Skjut (A) tillsammans med B eller C till D

OBS/VIKTIGT!

Se till att räfflan på kopplingsplinten faller in i öppningen

1. Justera djup på (A) och spänn (E).
2. Positionera styrenhetens fäste:
3. Positionera armstödet.

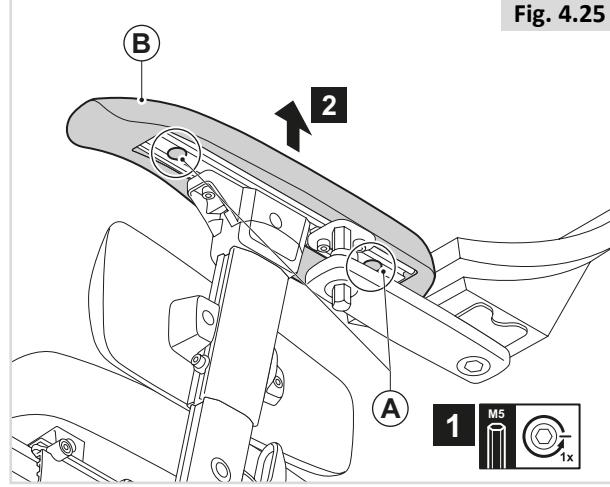


Fig. 4.26

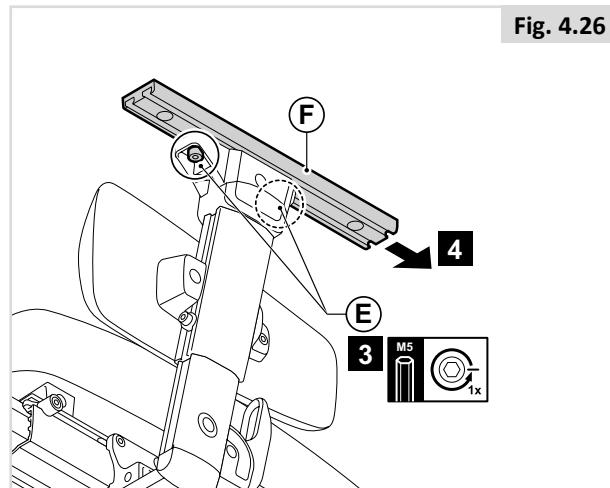


Fig. 4.27


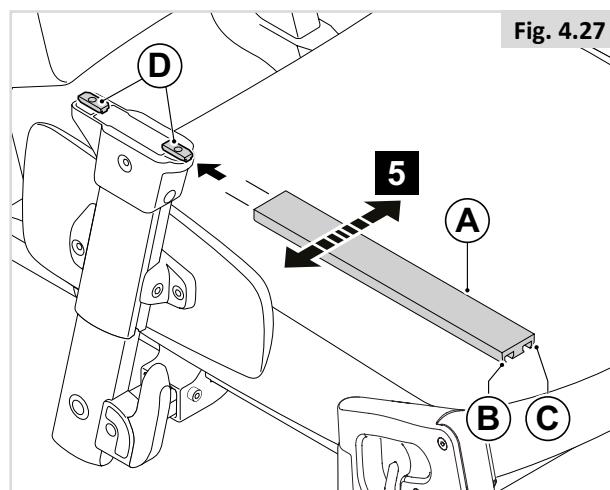


Fig. 4.28

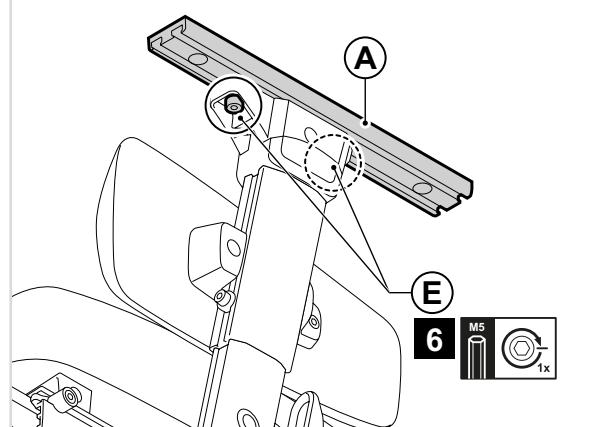



4.7 Sidoskydd

Sidostskydd höjd (Fig. 4.29)

1. Skruva loss (A).
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Sidostskydd djup (Fig. 4.30)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

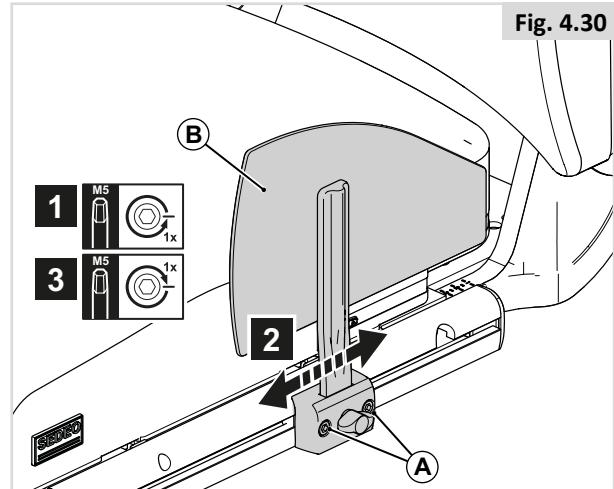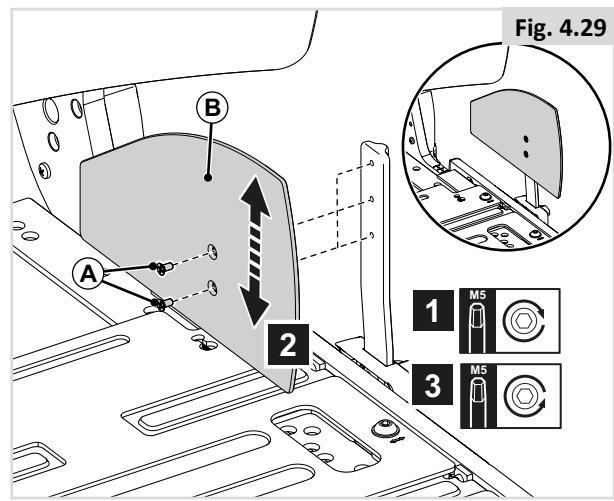

4.8 Förinställning av centralmonterat benstöd

Fig. 4.31

Underbenslängd (Fig. 4.31)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Knävinkel (Fig. 4.32)

1. Lossa (A) två varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!





Om fotstödet når länkhjulen, ändra höjden eller knävinkeln.

Vristvinkel (Fig. 4.33)

1. Fäll upp (A).
2. Vrid (B) för att reglera vristvinkeln enligt önskemål.
3. Fäll (A) ner.

Centralt vadstöd höjd (Fig. 4.34)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

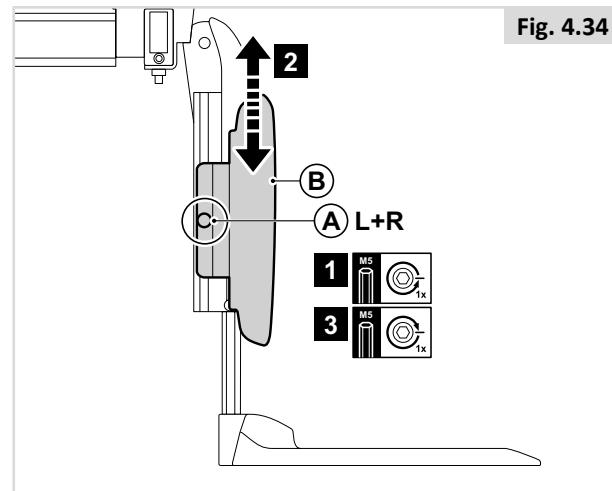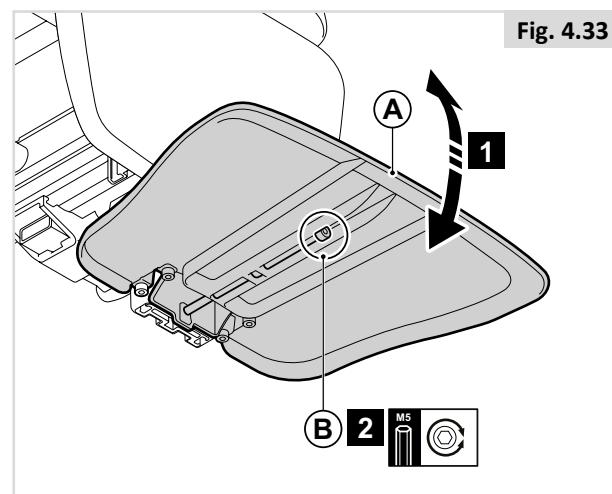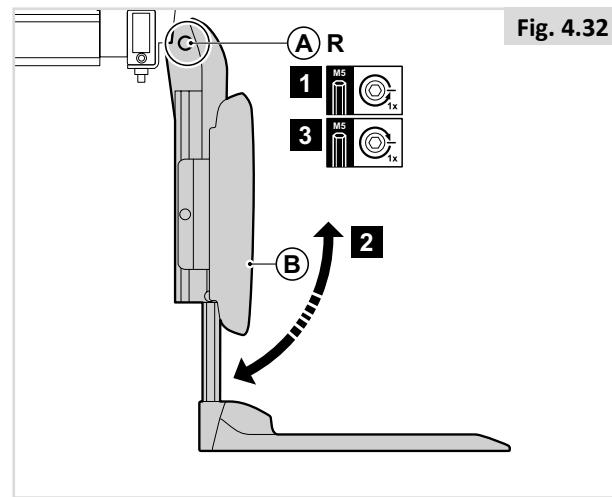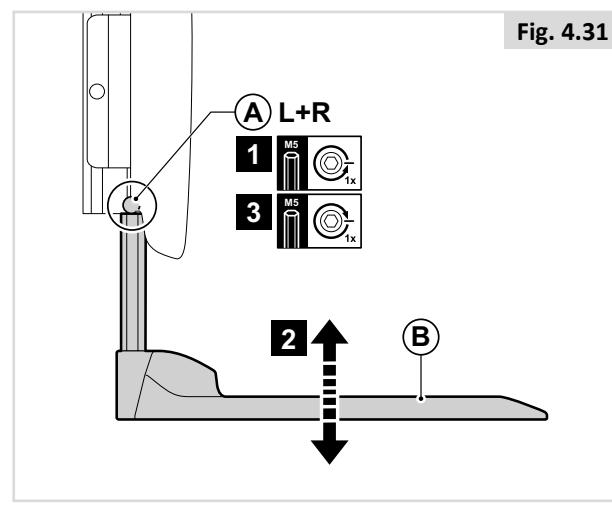

4.9 Förinställning av fast centermonterat benstöd

Underbenslängd (Fig. 4.35)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A)
4. Gör likadant på andra sidan.

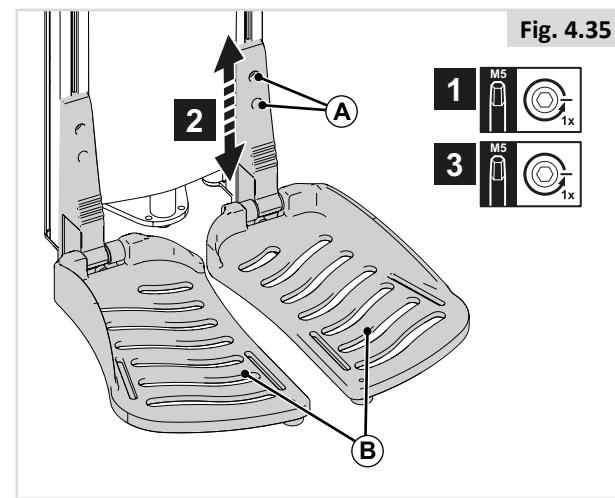


Fig. 4.35

Vristvinkel (Fig. 4.36)

1. Fäll upp (A).
2. Vrid (B) för att reglera vristvinkeln enligt önskemål (4 mm insexförspetsig nyckel)
3. Fäll (A) ner.

FARA/VARNING!

- Efter justeringen och med sitsen i normal driftposition. Se till att det alltid finns ett fritt utrymme (>25 mm) mellan golvet och fotplattan.
- Utför detta test med brukaren sittande i rullstolen och använder benstöden.
- Användning av rullstolen med benstöden inställda för lågt kan resultera i personlig skada eller skada på rullstolen och dess omgivningar.

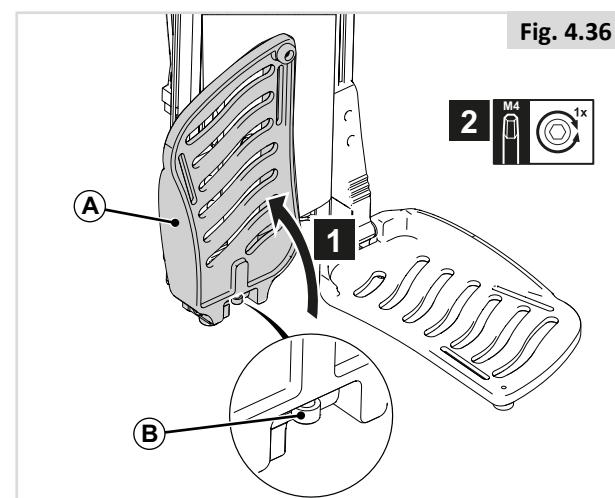


Fig. 4.36

Vadstöd höjd (Fig. 4.37)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (C) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstöd bredd (Fig. 4.37)

4. Lossa (B) ett varv.
5. Justera (C) till önskat läge.
6. Dra åt (B).

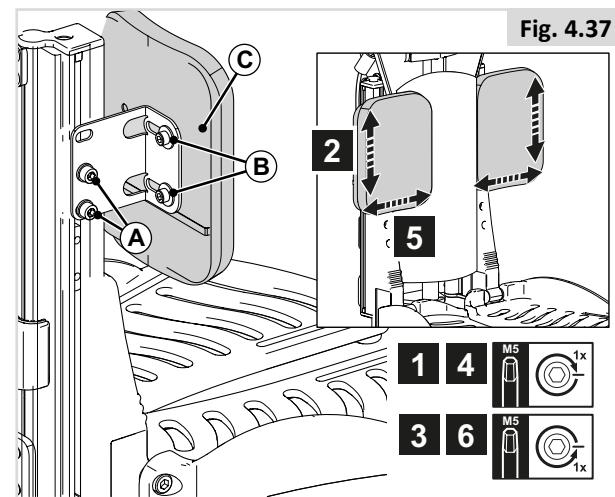


Fig. 4.37

4.10 Förinställning av centralmonterat eldrivet benstöd

Fig. 4.38

⚠ FARA/VARNING!

- Se till att du inte skadar benen när benstöden dras ut.
- Kontrollera alltid att benstöden inte kommer i kontakt med länkhjulen innan du kör rullstolen.
- Benstöden ska under inga omständigheter användas för att lyfta eller bärä rullstolen.
- Som med alla rörliga delar ska du vara försiktig så att du inte klämmer fingrarna, (Fig. 4.40).

Underbenslängd (Fig. 4.39)

Centralmonterat eldrivet benstöd tillåter vinkeljustering från 90° till 180° nivå till marken och en 180 mm eldriven längdutsträckning.

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).
4. Gör likadant på andra sidan.

Vristvinkel (Fig. 4.40)

1. Fäll upp (A).
2. Vrid (B) för att reglera vristvinkeln enligt önskemål (4 mm insexfnyckel)
3. Fäll (A) ner.

⚠ FARA/VARNING!

- Efter justeringen och med sitsen i normal driftposition. Se till att det alltid finns ett fritt utrymme (>25 mm) mellan golvet och fotplattan.
- Utför detta test med brukaren sittande i rullstolen och använder benstöden.
- Användning av rullstolen med benstöden inställda för lågt kan resultera i personlig skada eller skada på rullstolen och dess omgivningar.

Vadstöd höjd (Fig. 4.41)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (C) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstöd bredd (Fig. 4.41)

4. Lossa (B) ett varv.
5. Justera (C) till önskat läge.
6. Dra åt (B).

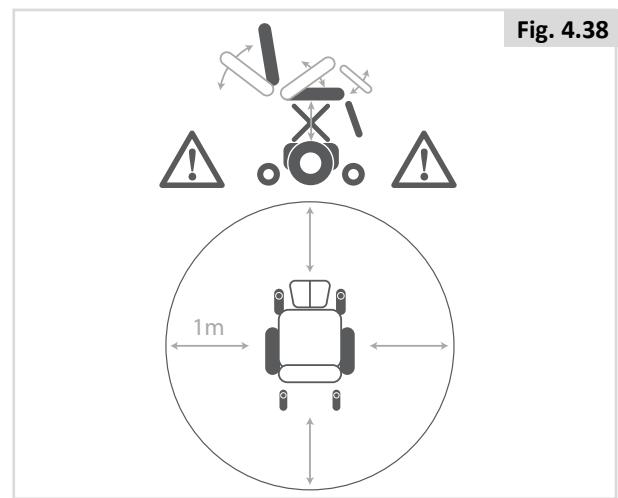


Fig. 4.39

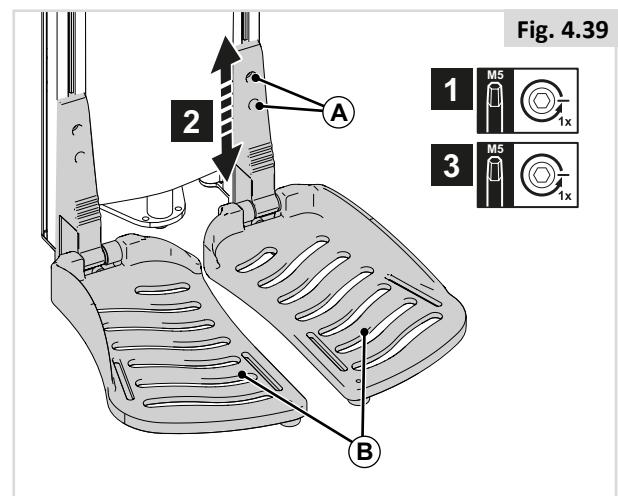


Fig. 4.40


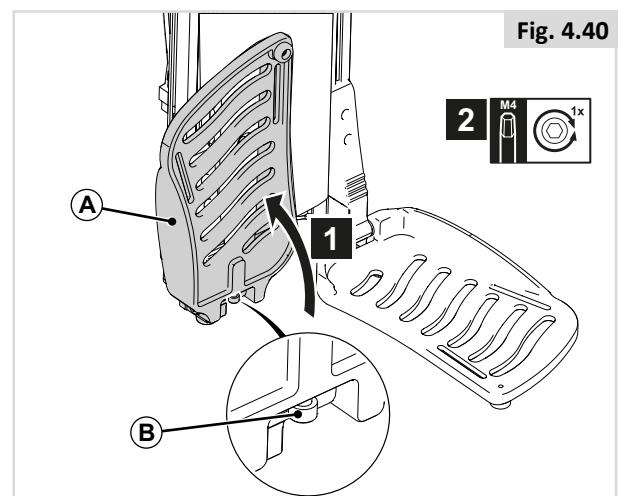


Fig. 4.41

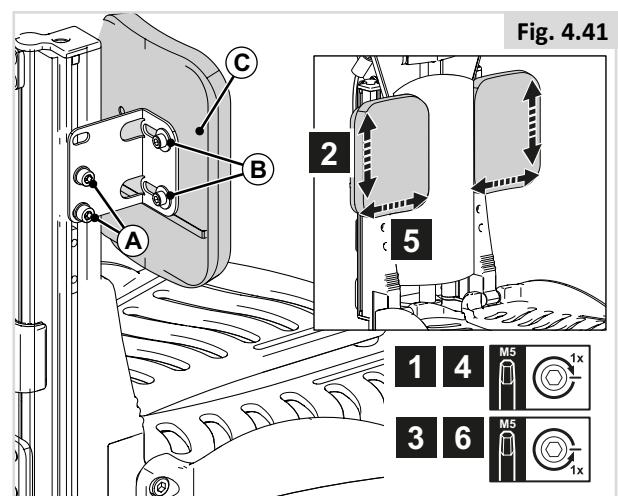

4.11 Förinställning av SEDEO LITE swing away-benstöd

Benstöd bredd (Fig. 4.42)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Underbenslängd (Fig. 4.43)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

- Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Vristvinkel (Fig. 4.42)

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

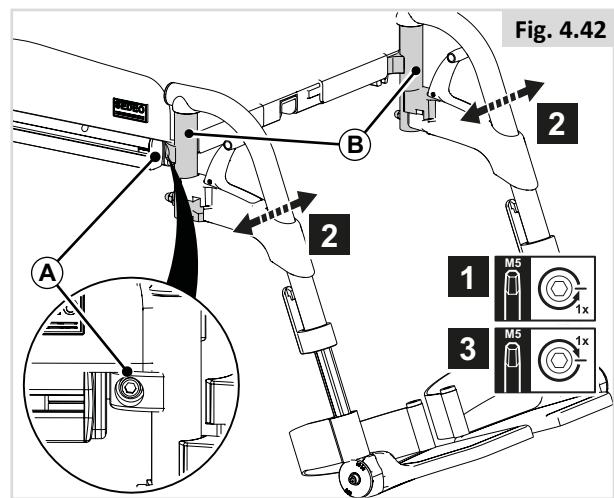


Fig. 4.42

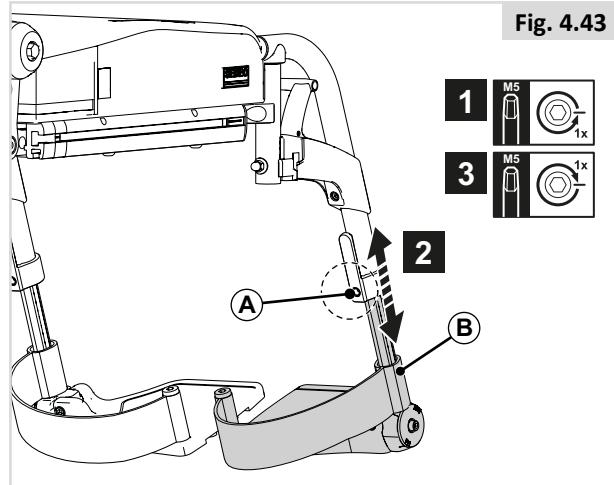


Fig. 4.43

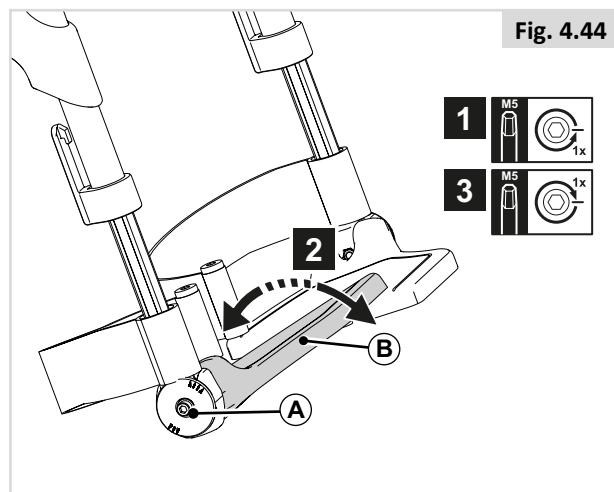


Fig. 4.44

4.12 Förinställning av UNI swing away-benstöd

Benstödsbredd, se fig 4.42.

Underbenslängd (Fig. 4.45)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

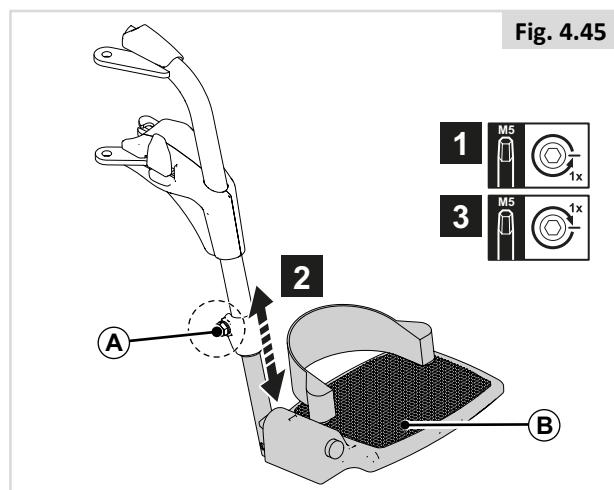


Fig. 4.45

4.13 Förinställning av swing-away benstöd

Benstöd bredd (Fig. 4.46)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Underbenslängd (Fig. 4.47)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

OBS/VIKTIGT!

Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme under (B) för rullstolen att köra över hinder.

Vristvinkel (Fig. 4.48)

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Knävinkel manuellt/eldrivet höjbart benstöd (Fig. 4.49)

Positionen för fotstöden kan ändras genom att justera knävinkeln.

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

FARA/VARNING!

- Risk för att du fastnar med fingrarna! När du för benstöden upp eller ner, sätt inte in fingrarna i den justerande mekanismen mellan benstödets rörliga delar.

OBS/VIKTIGT!

Om fotstödet når länkhjulen, ändra höjden eller knävinkeln.

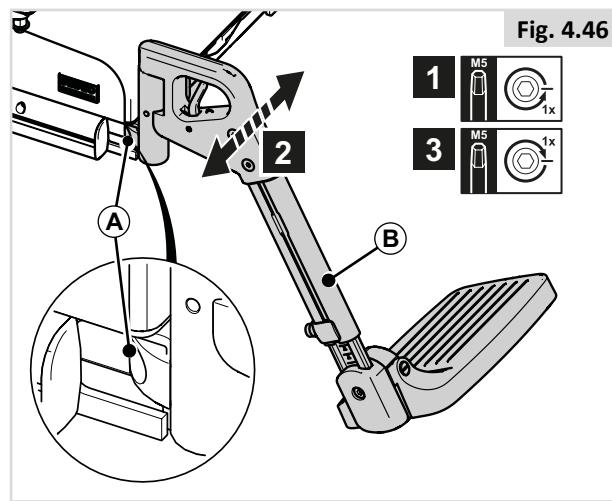


Fig. 4.46

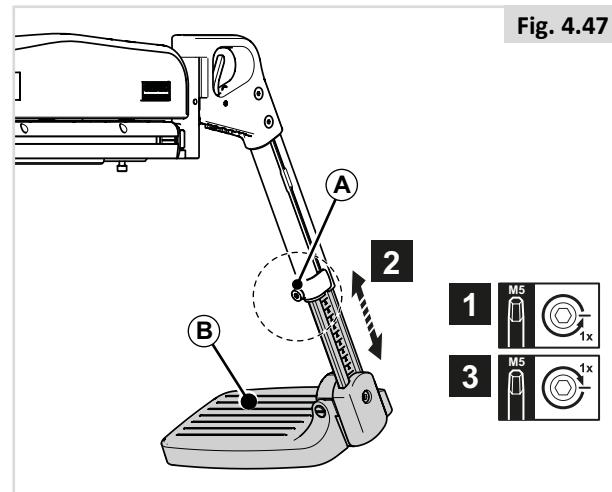


Fig. 4.47

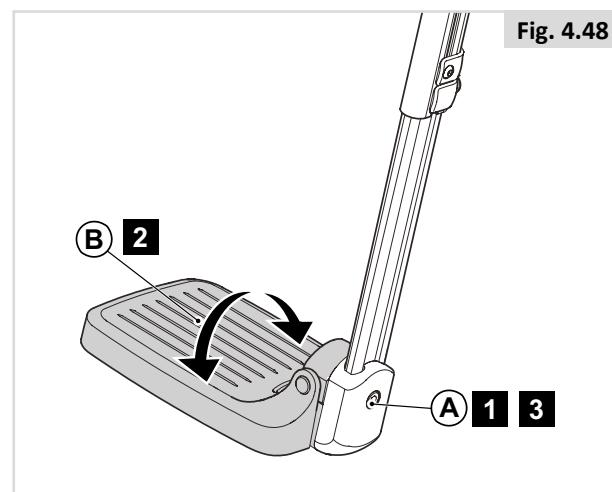


Fig. 4.48

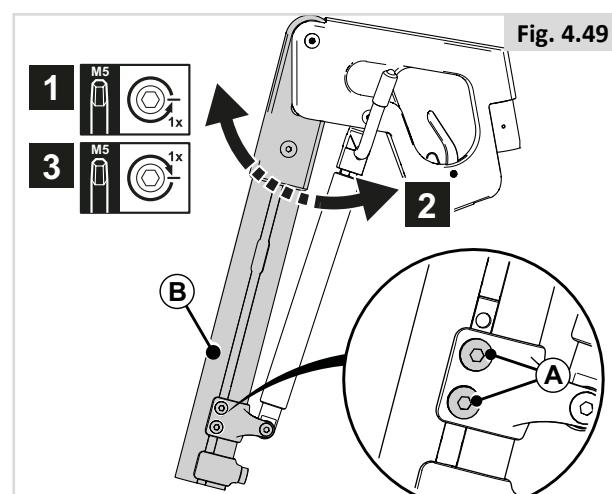


Fig. 4.49

Vadstöd höjd (Fig. 4.50)

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (D) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Vadstöd djup (Fig. 4.50)

4. Lossa (B) några varv.
5. Justera (D) till önskat läge.
6. Dra åt (B).

Vadstöd bredd (Fig. 4.50)

7. Lossa (C) på baksidan av (D) några varv.
8. Justera (D) till önskat läge.
9. Dra åt (C).

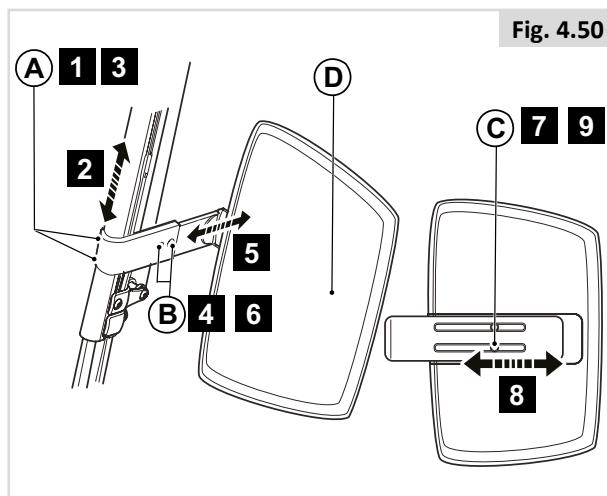


Fig. 4.50

4.14 Förinställning av nackstöd**⚠ FARA/VARNING!**

- Om ett nackstöd är ett av de tillval som valts för brukare/stol, kör aldrig stolen utan att nackstödet är monterat.
- Använd aldrig en stol utan ett nackstöd om en person transporteras stolen i ett fordon.

Nackstöd höjd (Fig. 4.51)

1. Lossa (A) några varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

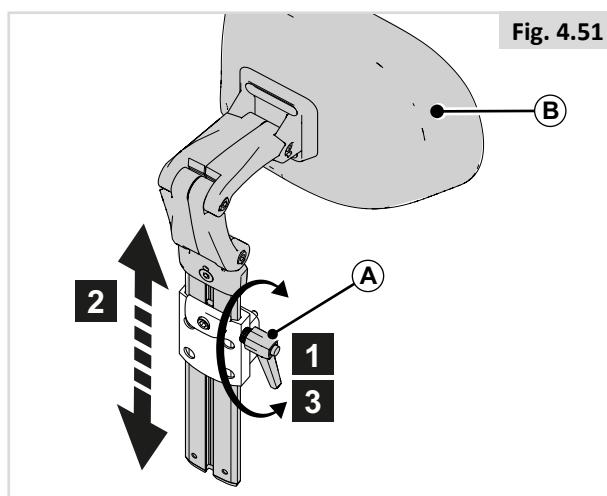


Fig. 4.51

Minnesinställning (Fig. 4.52)

1. Lossa (C) ett varv.
2. Skjut (D) så långt ner som möjligt.
3. Dra åt (C).

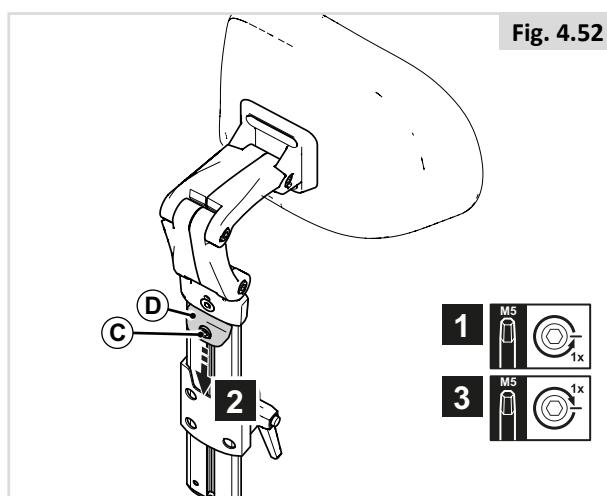


Fig. 4.52

Nackstöd läge (Fig. 4.53)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

⚠ OBS/VIKTIGT!

Korrigera nackstödets höjd och tilta nackstödets dyna enligt önskemål.

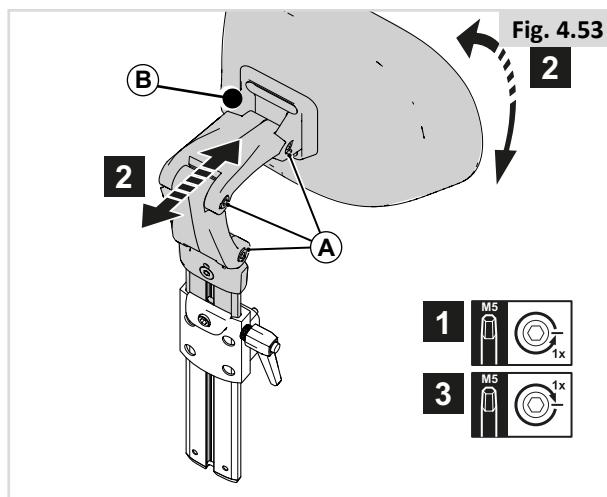


Fig. 4.53

Nackstödsdyna position i bredd (Fig. 4.54)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

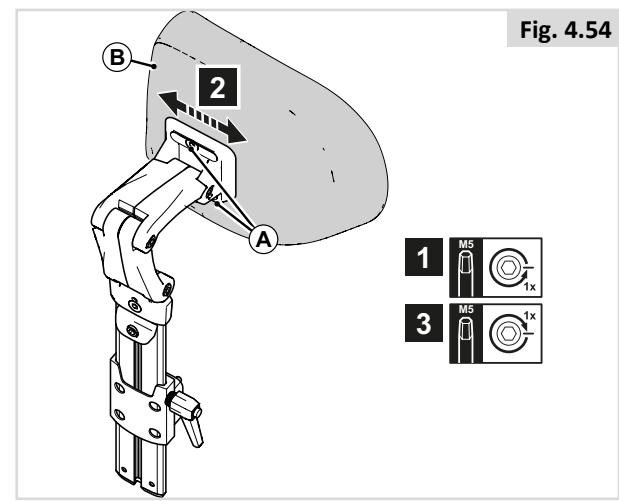


Fig. 4.54

4.15 Förinställning av fast/swing away fäste för styrenhet

Djup på styrenhet (Fig. 4.55)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (1) (Fig. 4.56)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

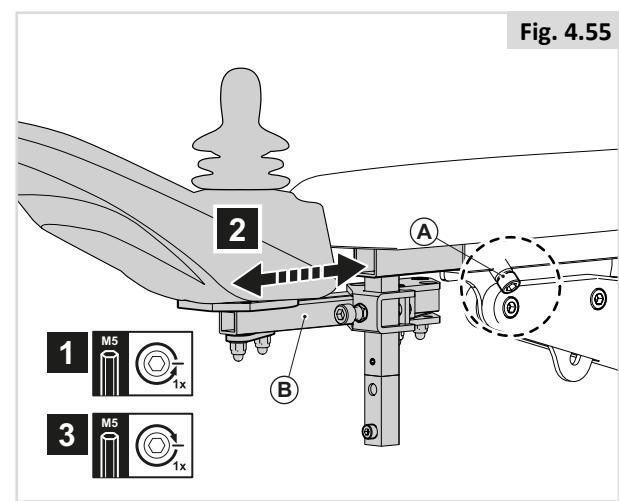


Fig. 4.55

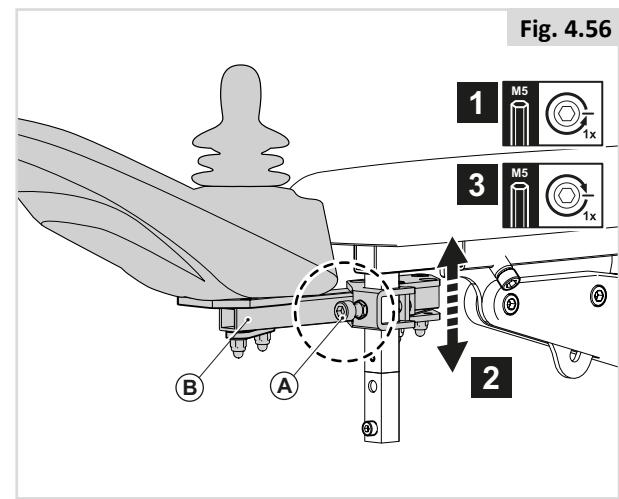


Fig. 4.56

4.16 Förinställning av inkapslad swing-away styrenhet

Fig. 4.57

Djup på styrenhet (Fig. 4.57)




1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (1) (Fig. 4.58)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Höjd på styrenhet (2) (Fig. 4.59)

1. Lossa (C) ett varv.
2. Justera (D) till önskat läge.
3. Dra åt (C).

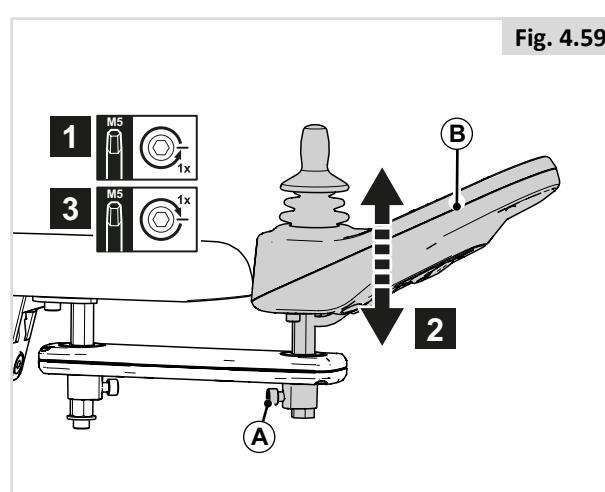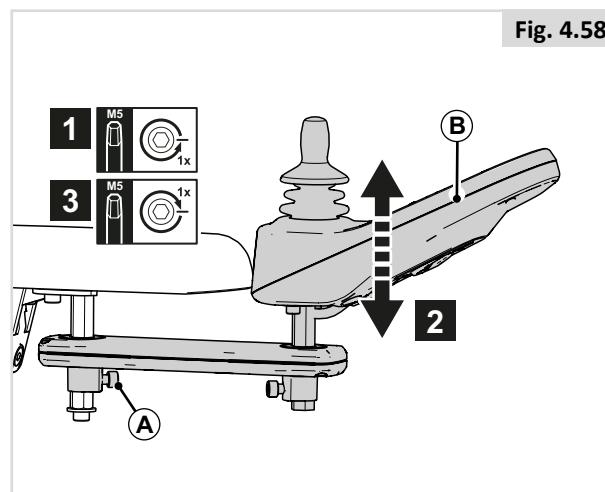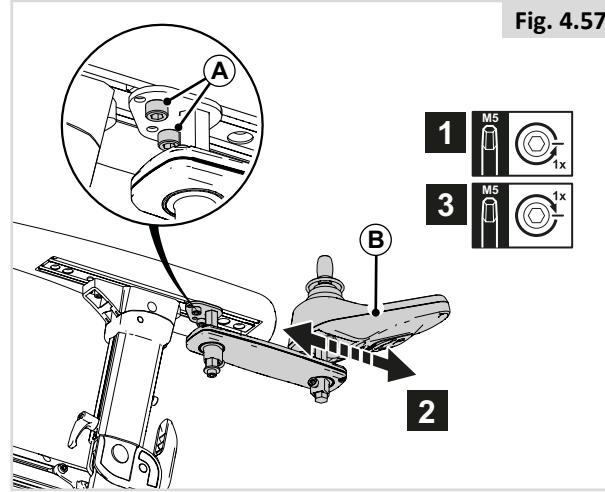

4.17 Förinställning av sidostöd

Sidostöd höjd (Fig. 4.60)




1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Sidostöd djup (Fig. 4.61)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).
4. Lossa (C) ett varv.
5. Justera (B) till önskat läge.
6. Dra åt (C).

Sidostöd vinkel (Fig. 4.62)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).
4. Lossa (C) ett varv.
5. Justera (B) till önskat läge.
6. Dra åt (C).

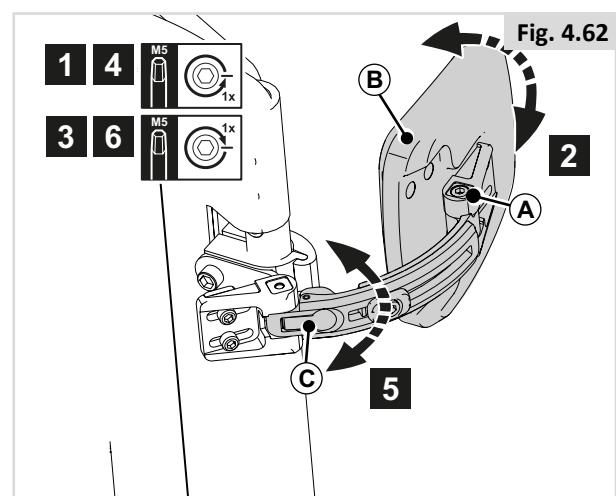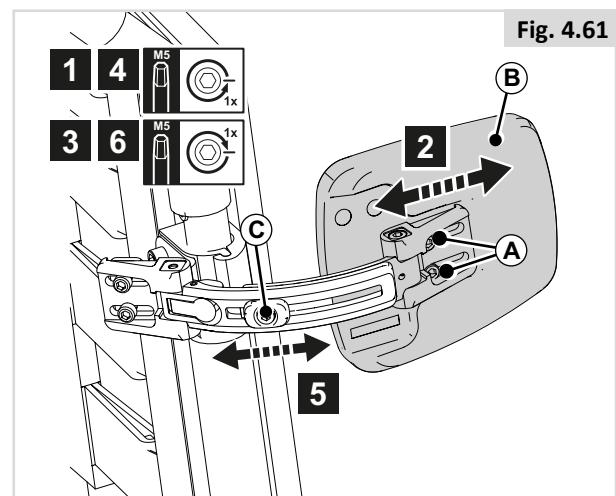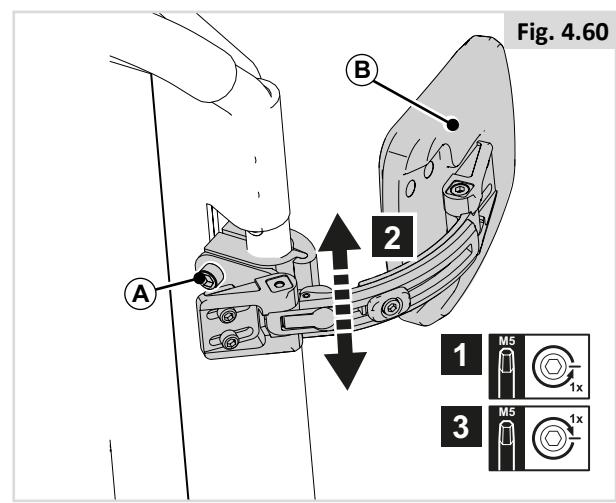

4.18 Förinställning av lateralt swing away-knästöd / lårstöd

Stödet kan monteras i två lägen som knästöd eller lårstöd (Fig. 4.63)

Lårstöd läge (Fig. 4.63 och 4.64)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

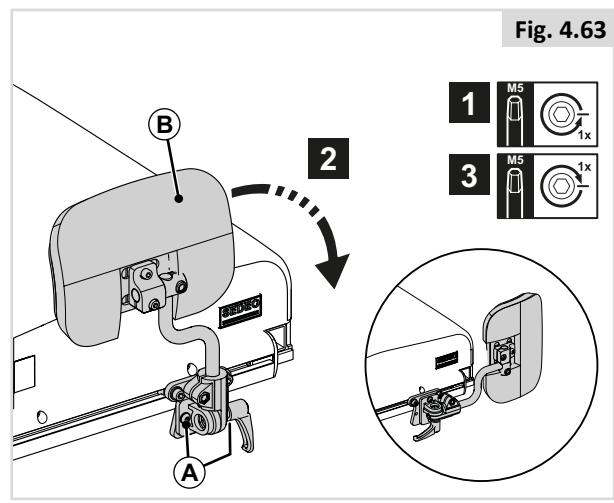


Fig. 4.63

4.19 Förinställning av abduktionsknapp

Abduktionsknapp höjd (Fig. 4.65)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

Abduktionsknapp djup (Fig. 4.66)

1. Lossa (A) ett varv.
2. Justera (B) till önskat läge.
3. Dra åt (A).

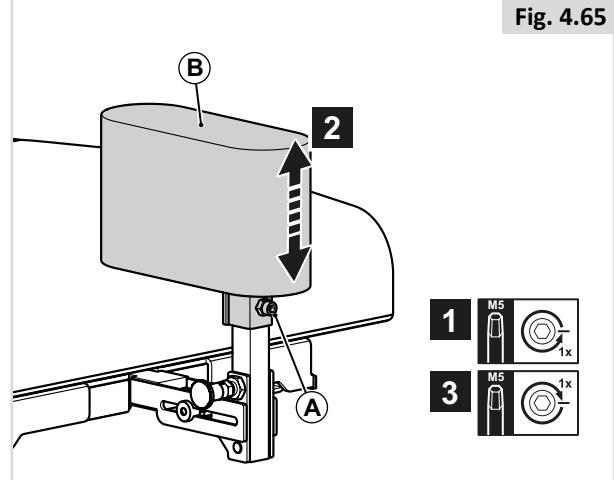


Fig. 4.65

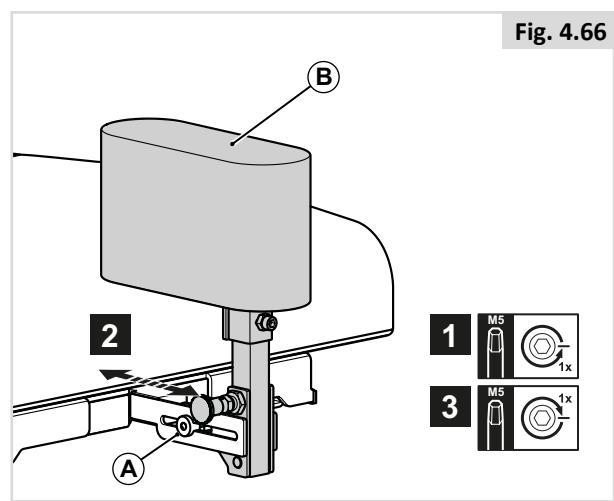


Fig. 4.66

4.20 Höftbälte/positioneringsbälte

Fig. 4.67

⚠ FARA/VARNING!

- Denna produkt används endast för att positionera en enskild person i en rullstol.
- Höftbälten är inte lämpliga för transportändamål, godkända fasthållningssystem måste användas.
- Om dessa varningar inte åtföljs kan det resultera i plötslig skada eller dödsfall.
- Se till att ledsagaren är utbildad i korrekt skötsel av bältena.
- Utbildade ledsagare kan leda till förseningar om en nödsituation uppstår.

Montering av höftbälte/positioneringsbälte

1. Anslut (A) till sitsens ram med hjälp av en skruv till vänster och till höger. (Fig. 4.68)

Positionera en person med ett höftbälte

- Justera inte höftbältet hårdare än att du får plats med en hand i mellanrummet (Fig. 4.69).
- Handens spelrum ska vara när höftbältet är normalspänt och inte medge större mellanrum eller öglor.
- Normalt ska höftbältet sitta i en vinkel av ca 45° (Fig. 4.70), och ska, när det sitter rätt, hindra användaren från att glida nedåt i sitsen.
- Lägg bältet löst över sitsen med spännets öppningsdel vänd åt höger för en vänsterhänt person och åt vänster för en högerhänt. För den andra änden av bandet genom öppningen mellan ryggstödets stolpar och ryggstöd.

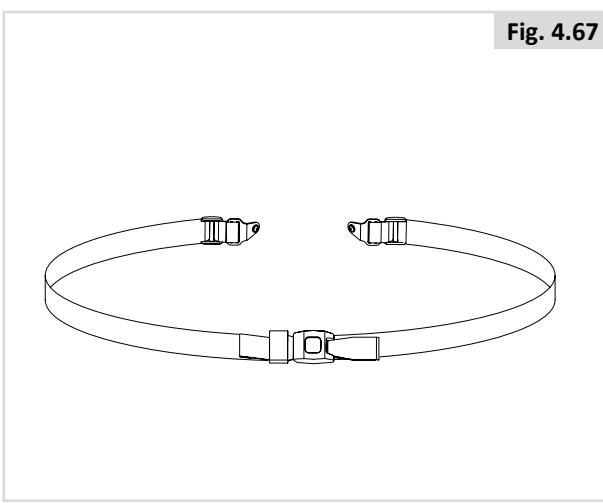


Fig. 4.67

⚠ FARA/VARNING!

- Kontrollera alltid att positioneringsbältet är korrekt säkrat och justerat innan du tar det i bruk.
- Om en rem är för lös kan det leda till att brukaren glider ned och detta kan orsaka allvarliga personskador.
- Kontrollera regelbundet om höftbälte eller fästdelar uppvisar tecken på slitage eller skador. Byt ut eventuella slitna delar.
- Kontrollera vid service att frigöringsspännet har korrekt funktion och om materialet eller plastfästen är slitna.
- Regelbundna kontroller/aktiviteter:
- Som med alla positioneringskomponenter finns det ett behov av korrigerande justeringar allt eftersom personen ändrar sin sittposition över tid.
- Kontrollera bältena regelbundet för korrekt installation för att säkerställa säkerhet och komfort för brukaren.

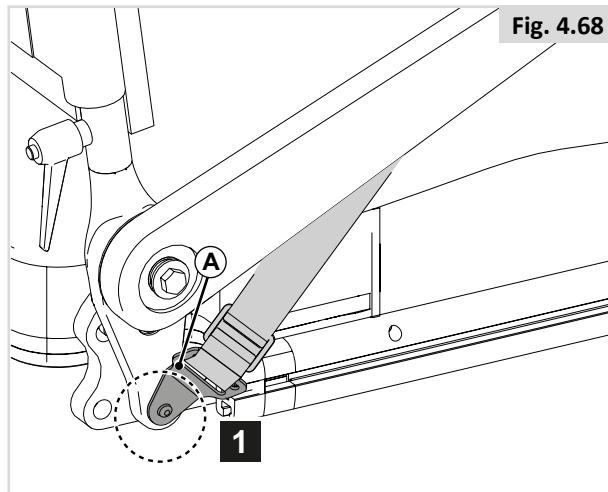


Fig. 4.68

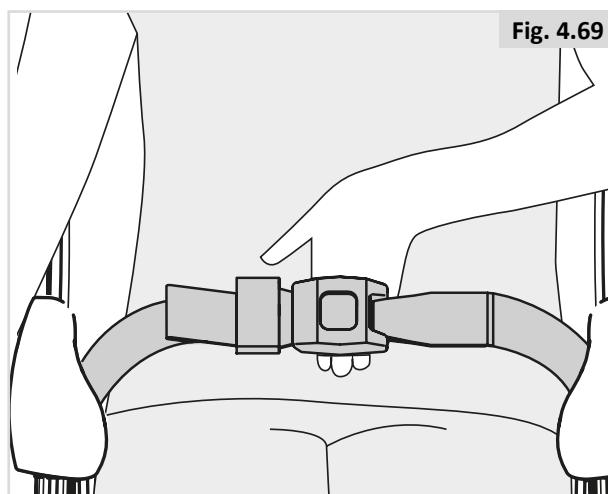


Fig. 4.69

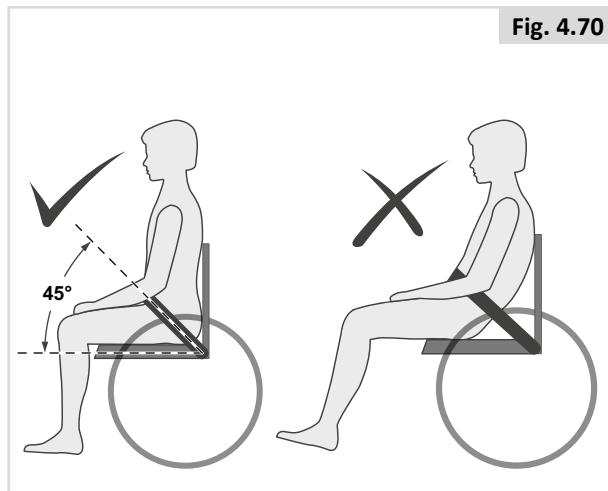


Fig. 4.70

5.0 Användning av sittsystemet

Fig. 5.1

5.1 Komma i och ur rullstolen (överförflyttning)

Sunrise Medical rekommenderar att du rådfrågar din förskrivare om teknik för att ta dig i och ur rullstolen, framifrån eller från sidan, som bäst passar dig och som ger minst risk för skador.

FARA/VARNING!

För att förebygga ett fall:

- Tillse att manöverboxen är avstånd vid överförflyttning till och från stolen, för att undvika att stolen oväntat flyttar sig. Om du inte gör det så kan du råka röra på styrspaken och orsaka systemet att flytta på sig när du inte förväntar dig det.
- Säkerställ att frikopplingsspaken har ställts in på "kör"-läge Allmän bruksanvisning.
- Vrid främre länkhjul så att de pekar framåt.
- Arbeta med din hälsovårdspersonal för att lära dig alla säkra metoder för överförflyttningar.
- Kontrollera att motorbromsen är aktiverad. Detta gör att systemet inte flyttar sig när du gör en överförflyttning.
- Det är farligt att göra en överförflyttning på egen hand. Det krävs god balans och smidighet. Var medveten om att det finns en punkt vid varje överförflyttning när rullstolens sits inte finns under dig.
- Lär dig hur du positionerar din kropp och hur du kan stödja dig under överförflyttningen.
- Se till att någon hjälper dig tills du är säker på att du kan göra en säker överförflyttning på egen hand.
- Stå inte på fotstödet. Att placera din fulla vikt på fotstödet kan leda till skador på rullstolen och farliga situationer, inklusive att rullstolen tippar över.
- Se till att din fot inte "hänger upp sig" eller fångas i utrymmet mellan fotstöden.


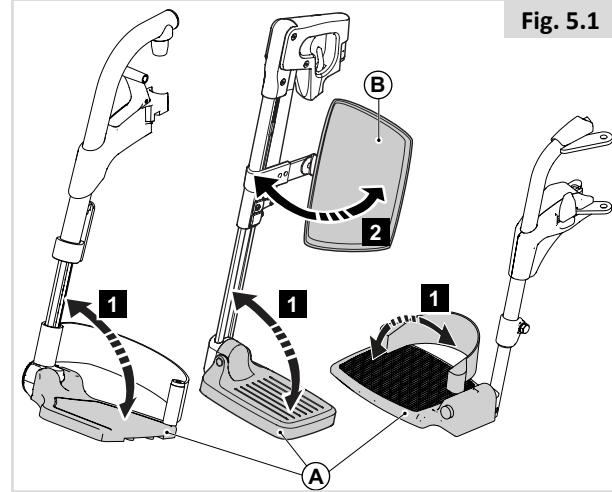


Fig. 5.2

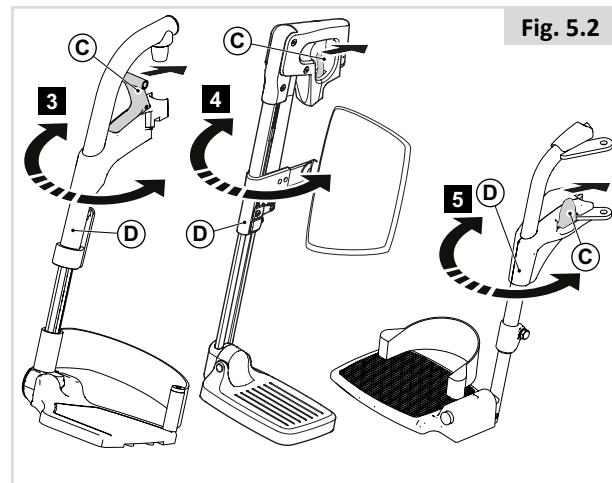


5.2 Förbereda sig för överförflyttning framåt

FARA/VARNING!

Flytta din rullstol så nära som möjligt till stolen du tänker överföra till.

Swing-away benstöd (Fig. 5.1 och 5.2)

1. Fäll upp fotstöd (A)
2. Sväng vadplattorna (B) till sidorna (om tillämpligt)
SEDEO LITE SWING AWAY-BENSTÖD
3. Om möjligt, tryck (C) bakåt och sväng benstöden (D) åt sidan
UNI SWING AWAY-BENSTÖD
4. Om möjligt, tryck (C) bakåt och sväng benstöden (D) åt sidan
SEDEO PRO SWING AWAY-BENSTÖD
5. Om möjligt, tryck (C) bakåt och sväng benstöden (D) åt sidan

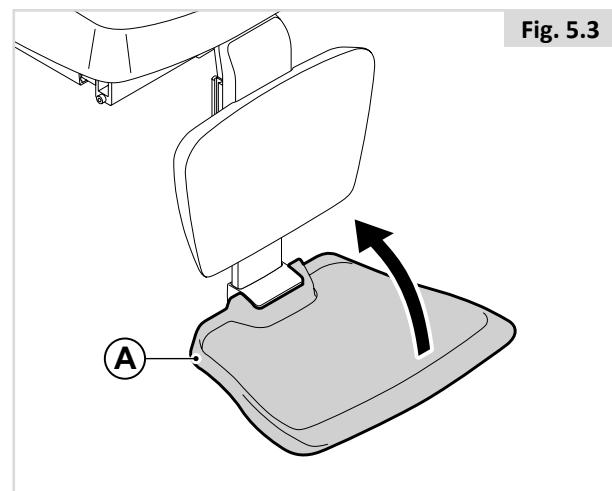

Centermonterat benstöd (Fig. 5.3)

1. Fäll upp (A).

Centralt installerat benstöd (Fig. 5.4)

1. Fäll upp (A) 2x.


5.3 Förbereda sig för sidaöverföring

⚠ FARA/VARNING!

- Flytta dig så nära du kan till sitsen du gör överförflyttning till.
Om möjligt, ta ytterligare hjälp för överförflyttning.
- Överför till så långt bakåt på sittytan som du kan. Detta reducerar risken att du missar sitsen eller faller.

⚠ OBS/VIKTIGT!

- Vissa versioner av styrenheten behöver svängas åt sidan.
- Avlägsna brickan innan du fäller tillbaka armstödet.
- Luta dig inte mot armstödet när det viks tillbaka.

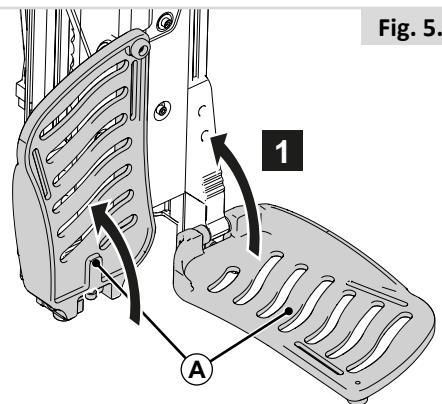

Ryggmonterat uppfällbart armstöd med recline-funktion (Fig. 5.5)

1. Fäll (A) bakåt.

Centermonterat avtagbart Sedeo Lite armstöd (Fig. 5.6)

1. Lossa A
2. Avlägsna B

Centermonterat fällbart armstöd (Fig. 5.7)

1. Tryck på (A).
2. Fäll (B) bakåt

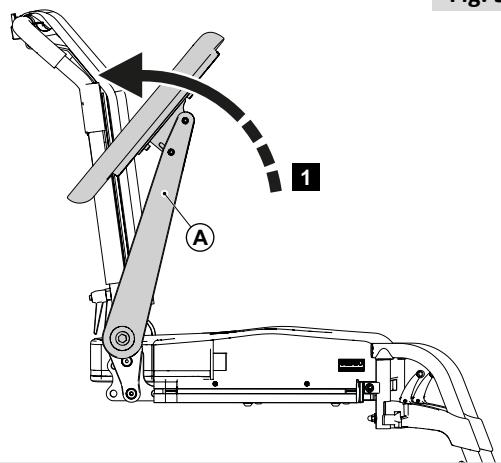


Fig. 5.5

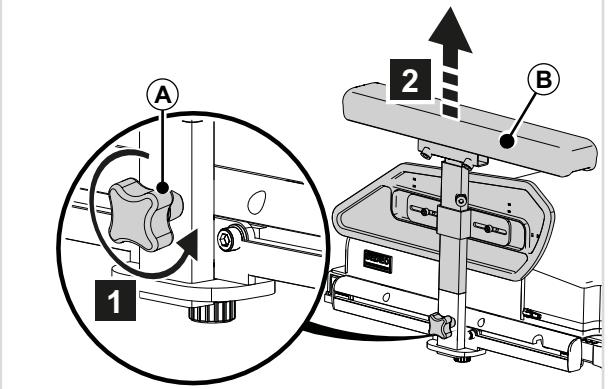


Fig. 5.6

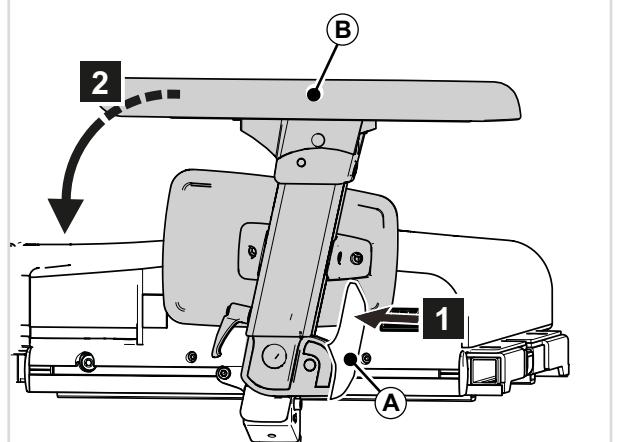


Fig. 5.7

5.4 Nackstöd

Avlägsnande/positionering av nackstödet (Fig. 5.8)

1. Lyft (A).
2. Skjut (B) ut från eller in till (C).
3. Tryck (A) neråt.

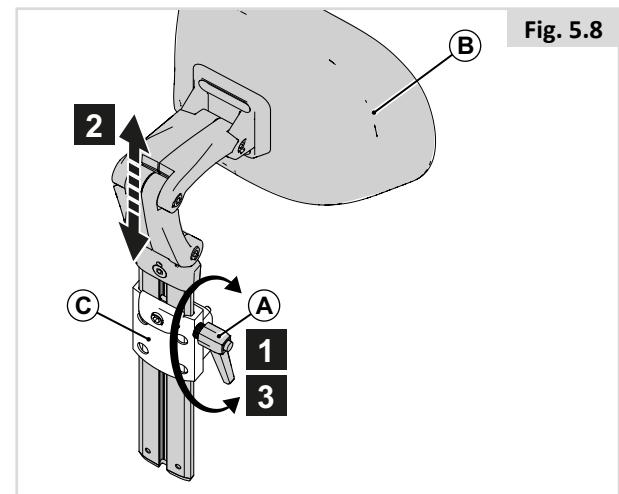


Fig. 5.8

5.5 Swing-away styrenhetsfäste

Swing-Away av inkapslat styrenhetsfäste (Fig. 5.9).

Styrspak installeras med en mekanism som tillåter styrspaken att låsas i två framåtlägen.

1. Tryck (A) utåt eller inåt.
2. För att återgå till framåtläge, tryck baksidan av styrspaken framåt tills den låses på plats.

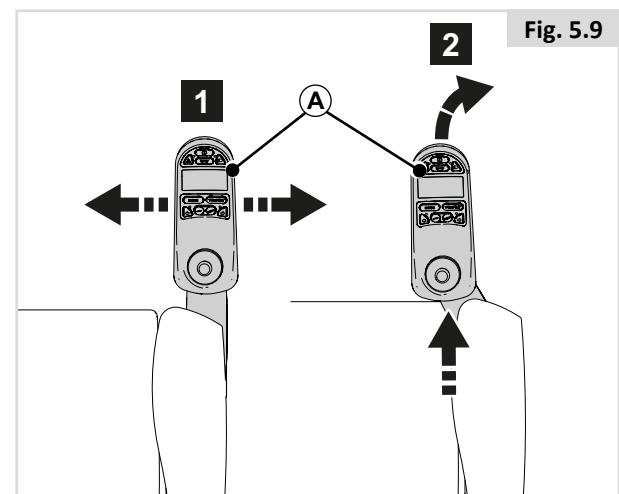


Fig. 5.9

Sväng styrenhetsfästet (Fig. 5.10).

1. Tryck (A) utåt.
2. För att återgå till framåtläge, tryck baksidan av styrspaken framåt tills den låses på plats.

⚠️ OBS/VIKTIGT!

När du svänger tillbaka styrspaksfästet kan du köra upp nära ett bord.
Full drift för styrenheten fortfarande möjlig

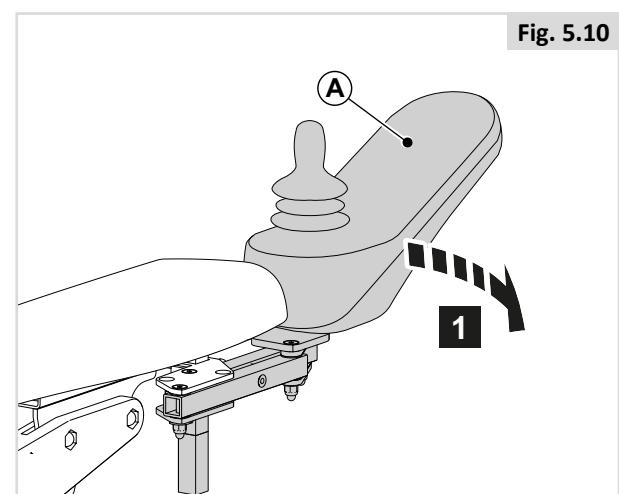


Fig. 5.10

5.6 Sidostöd (Fig. 5.11)

1. Tryck A för att svänga B

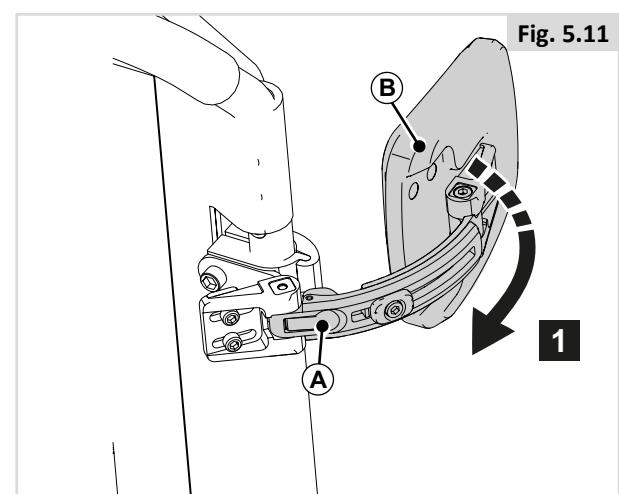


Fig. 5.11

5.7 Knästöd / Lårstöd (Fig. 5.12)

- Lossa A för att svänga B

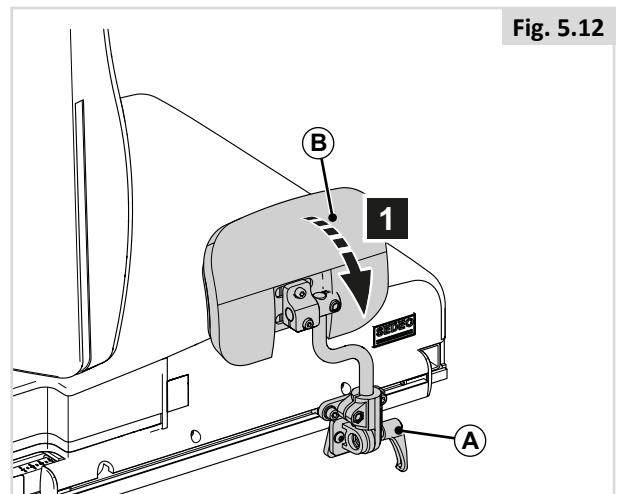


Fig. 5.12

5.8 Hemiplegi armstöd (Fig. 5.13)

- Dra (A) ut från det låsta läget och vrid (B) till önskat läge.

OBS/VIKTIGT!

Se till att (B) är ordentligt säkrat!

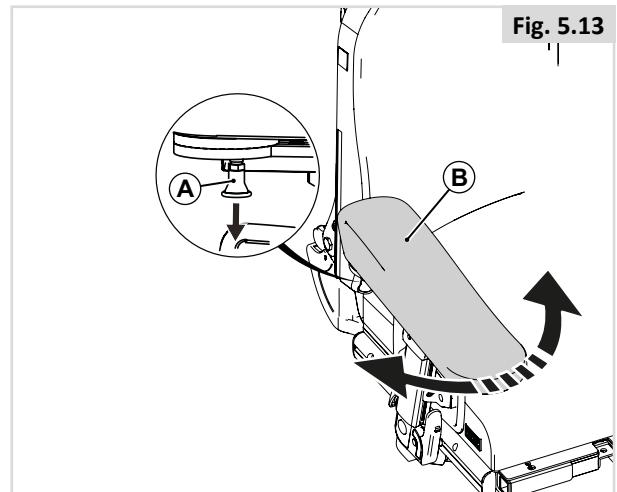


Fig. 5.13

5.9 Abduktionsknapp (Fig. 5.14)

Fäll ner abduktionsstödet

- Dra (A) ut från det låsta läget.
- Fäll ner (B)
- Frigör (A).

Fäll upp abduktionsstödet

- Dra (A) ut från det låsta läget.
- Fäll upp (B).
- Frigör (A) i det låsta läget.

OBS/VIKTIGT!

Se till att (B) är ordentligt säkrat!

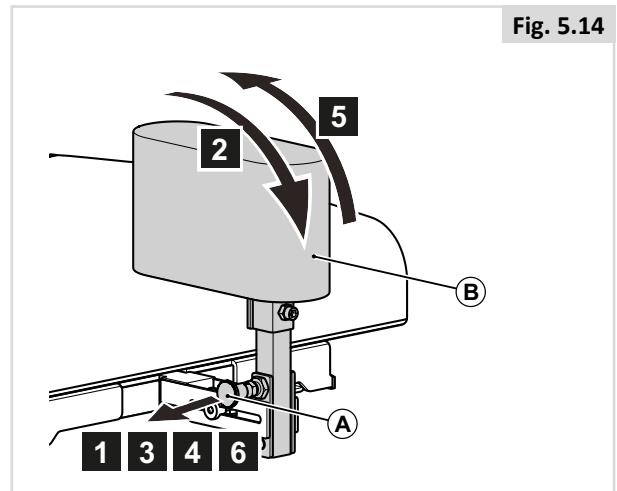


Fig. 5.14

6.0 Manuella och eldrivna tillval

6.1 Manuella sitstillval


Manuellt tillbakalutande ryggstöd (av ledsagare) (Fig. 6.1)

1. Kläm (A).
2. Dra framåt eller bakåt för att justera (B) till önskat läge.



Fortsätt klämma (A).

3. Frigör (A).

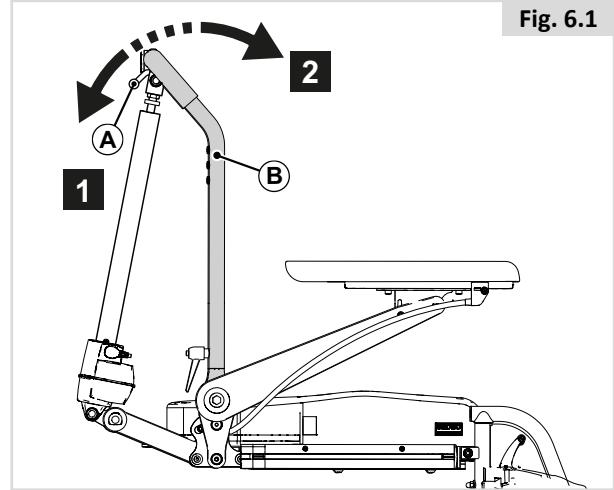


Sedeo lite Manuell höjning av benstödens knävinkel (fig 6.2)

Vinkeln på de bekväma benstöden kan justeras oberoende av varandra.

1. Vrid (A).
2. Lyft ditt ben.
3. Frigör handtaget när det är i önskat läge.



- Risk för att du fastnar med fingrarna! När du för benstöden upp eller ner, sätt inte in fingrarna i den justerande mekanismen mellan benstödets rörliga delar.

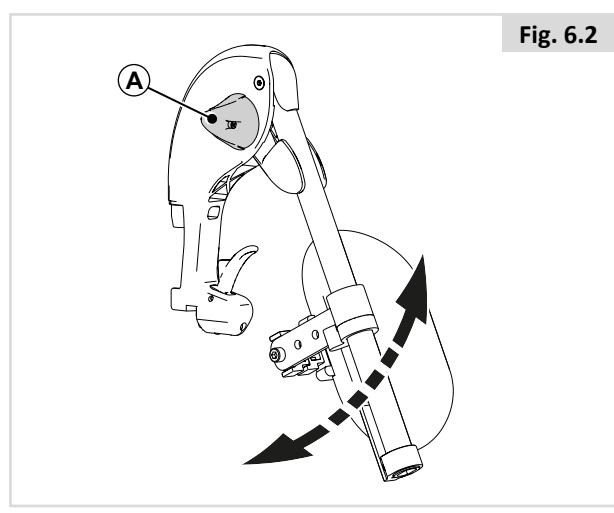


Manuell höjning av benstödets knävinkel (Fig. 6.3)

Vinkeln på de bekväma benstöden kan justeras oberoende av varandra.

1. Tryck handtag (A) framåt.
2. Lyft ditt ben.
3. Frigör handtaget när det är i önskat läge.



- Risk för att du fastnar med fingrarna! När du för benstöden upp eller ner, sätt inte in fingrarna i den justerande mekanismen mellan benstödets rörliga delar.

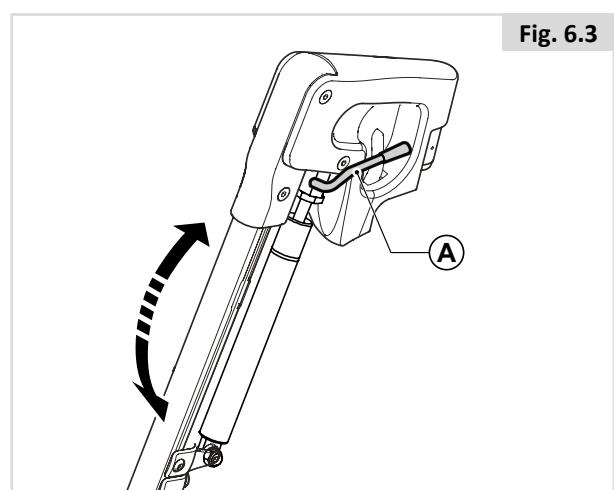

6.2 (El)sitstillval

Rullstolen kan utrustas med följande eldrivna tillval för att justera din sittposition. Dessa tillval kan manövreras av brukaren utan användning av verktyg.

Eljusterbara sitstillval (Fig. 6.4 - Fig. 6.6)

Hur du manövrerar dessa eldrivna sitstillval kan du läsa om i STYRENHET.

1. Eldriven tiltfunktion
2. Elsitslift
3. Eldrivet bakåtlutande ryggstöd
4. Eldrivet höjbart benstöd

FARA/VARNING!

- Användning av elektriska justerbara sitstillval kan påverka stabiliteten i rullstolen.
- Använd endast eldrivna justerbara sitstillval när rullstolen är på en plan yta! Försök inte att manövrera något elsitstillval vid positionering på en sluttning.
- Var vänlig håll dig borta från elställdon när komponenten är i rörelse. Elrullstolar från Sunrise Medical kan röra sig över stora områden. Brukare bör vara uppmärksamma på sin omgivning medan komponenter är i rörelse.
- Lakttag försiktighet vid körning av detta sittsystem i bakåtlutat, upprest eller i tiltat läge.
- Försök inte att manövrera något elsitstillval medan denna rullstol befinner sig i rörelse.
- Försök inte att manövrera uppresning eller tillval som eltilt när det finns barn i närheten.
- Genom programmering är det möjligt att vända riktning på alla eldrivna sittfunktioner. Se till att du vet i vilken riktning din sits kommer att röra sig före användning.
- Var medveten om att uppresningsmodulerna utgör en klämrisk. För att förhindra skador, se till att alla klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar inte är i vägen för uppresningsmodulen under drift.
- Kör inte över en ramp eller i en sluttning med tiltad/upplyft sits. Du bör återställa sits och ryggstöd till utgångsläge/upprätt läge innan du kör uppför eller nedför en sluttning.

Detta elsystem är utformat för att automatiskt minska den maximala körhastigheten till ett krypkörningsläge när vissa begränsningar uppnås. Beroende på stolens konfiguration kan det finnas flera olika kryphastigheter.



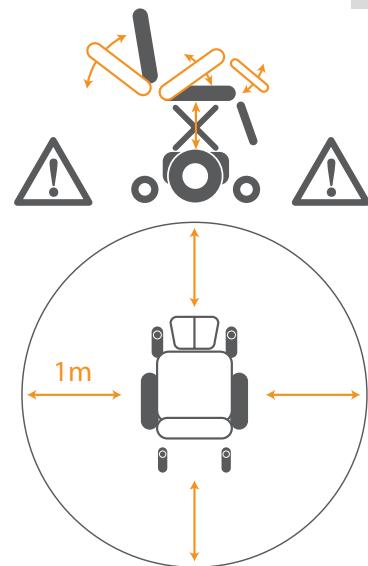


Fig. 6.5

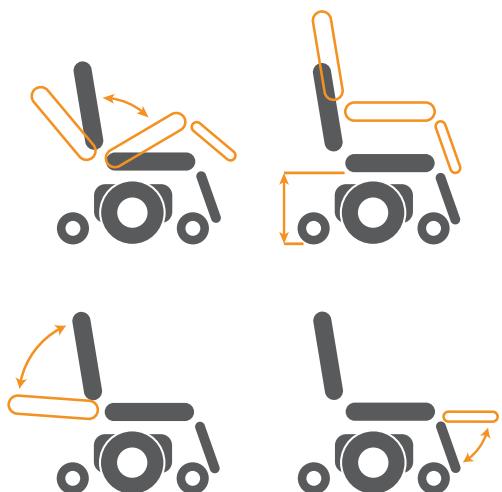

Eljusterbara sitstillval

Fig. 6.6

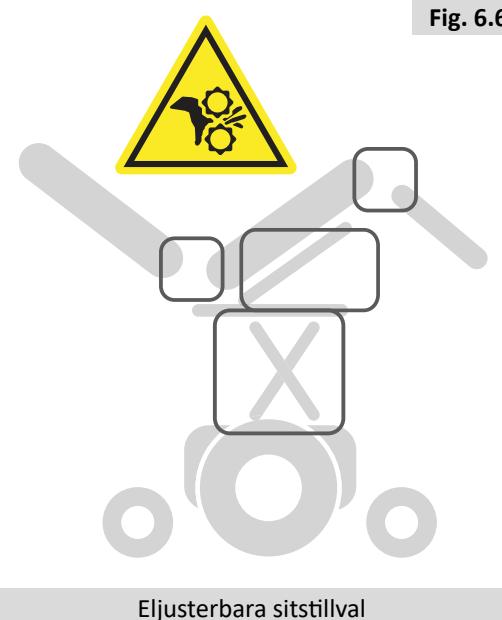

Eljusterbara sitstillval

7.0 Reducering av sittsystemets storlek för transportsyften

⚠ FARA/VARNING!

Rullstolen kan reduceras i storlek för transport utan passagerare. Alla komponenter till sittsystemet som kan lossas enkelt bör tas bort. Förvara dessa delar på ett säkert sätt så att de inte kan orsaka personskada eller annan skada eller själva bli skadade.

7.1 Sittdyna

Avlägsna sits (Fig. 7.1)

- Tryck (A) uppåt.

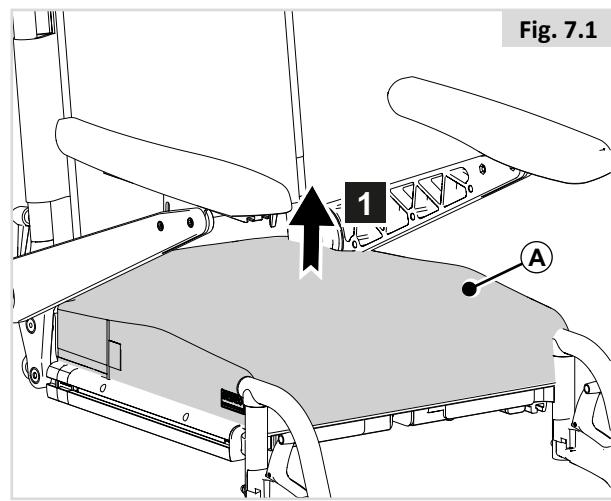


Fig. 7.1

Byte av sits (Fig. 7.2)

- Positionera (A) med hålen över bultarna

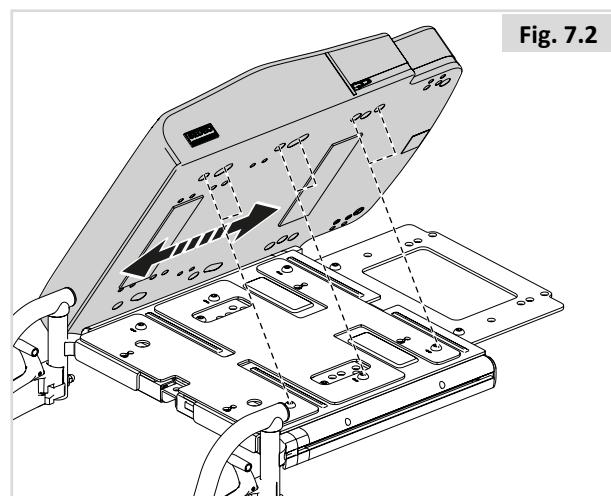


Fig. 7.2

7.2 Ryggstödsdyna

Avlägsnande av ryggdyna (Fig. 7.3)

- Tryck (A) framåt för att låsa upp.
- Lyft (B).

Positionera ryggdyna (Fig. 7.3.1)

- Vinkla upp (A).
- Tryck tillbaka på plats (B).

⚠ OBS/VIKTIGT!

Om korrekt isatt ”klickar” stiften in i det låsta läget.

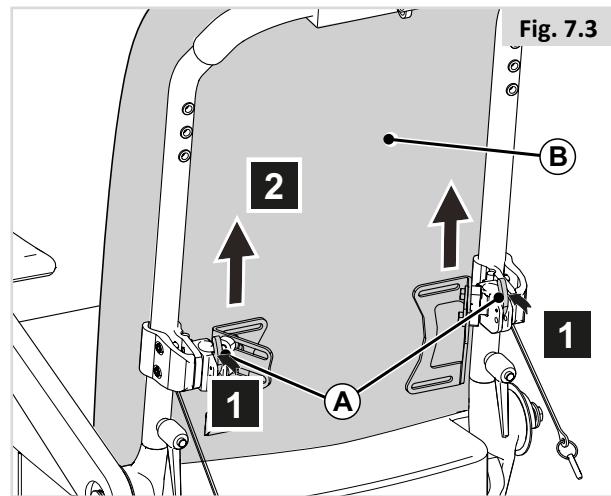


Fig. 7.3

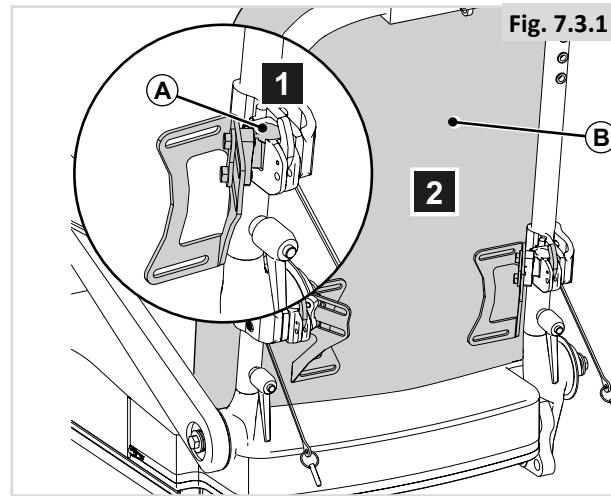


Fig. 7.3.1


7.3 Nedfällning av ryggstödet (Fig. 7.4)

1. Lossa (A).
2. Tryck (B) uppåt.
3. Fäll (B) framåt.

⚠️ OBS/VIKTIGT!

Vid behov, avlägsna först ryggdynan.

Se till att (A) är ordentligt säkrat!

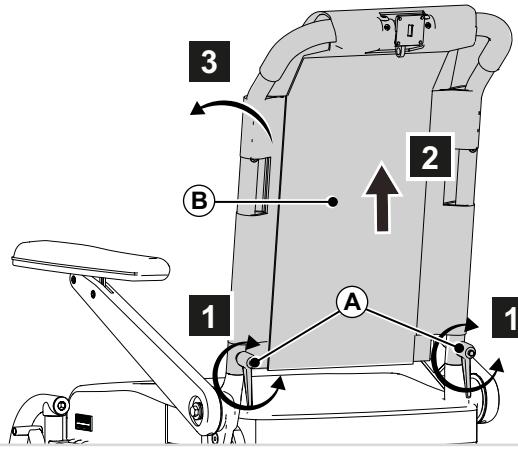


7.4 Nedfällning av bakåtlutande ryggstöd (Fig. 7.5)

1. Lossa (A).
2. Avlägsna (B)
3. Tryck (C) uppåt.
4. Fäll (C) framåt.

⚠️ OBS/VIKTIGT!

Vid behov, avlägsna först ryggdynan.

Se till att (A) och (B) är ordentligt säkrat.

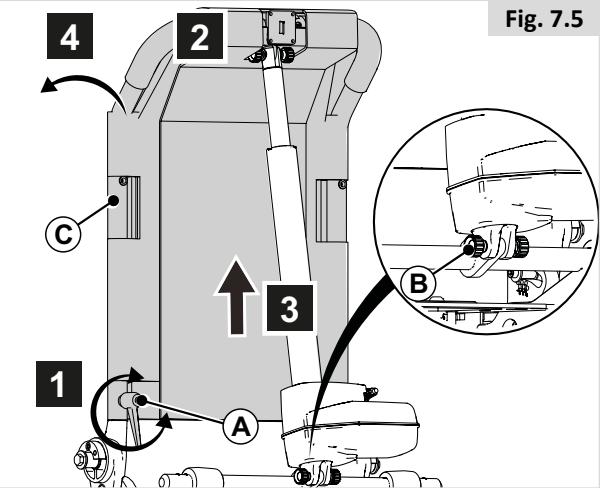

⚠️ OBS/VIKTIGT!

Ryggstödet bör greppas på ovansidan för att garantera enkel framåtfällning.

7.5 Swing-away-benstöd (Fig. 7.6)

Avlägsna ett swing-away benstöd

1. Lossa vadband.
2. Tryck haken (A) bakåt för att kunna låsa upp benstödet.
3. Sväng benstöden utåt.
4. Avlägsna benstödet (B) från dess fäste genom att lyfta.

Du bör höra ett klick när du sätter tillbaka benstödet. Detta indikerar att benstödet har låsts på plats.



Danger of finger entrapment (Fig.7.7)

⚠ Warning!

When the Manual Elevating swing away legrest is removed, carry the legrest at the handle intended for removing/carrying (A).

When carrying at B and at the same time releasing lever C there is a risk of finger trapping.

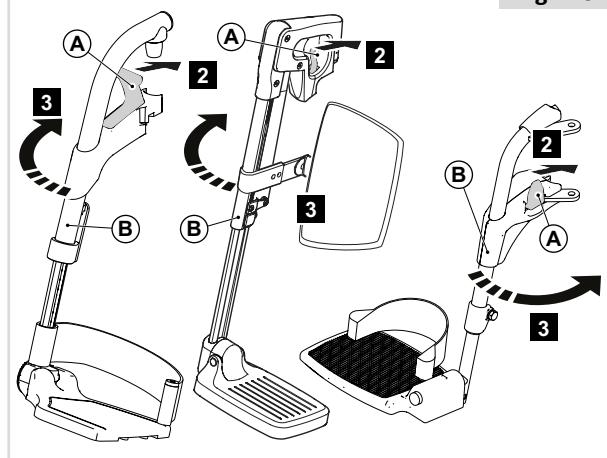


Fig. 7.6

7.6 Löstagbara armstöd.

Avlägsnande av armstödsenheten (Fig. 7.8)

1. Vrid (A) några varv.
2. Avlägsna (B).

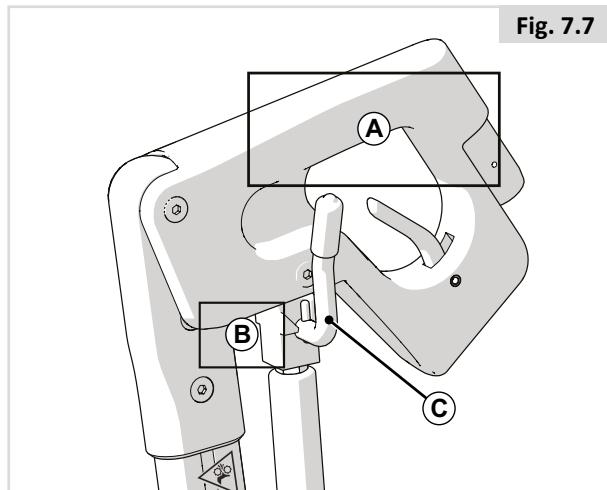


Fig. 7.7

Positionering av armstödsenheten (Fig. 7.9)

1. Skjut (A) på (B).
2. Vrid (C) några varv.

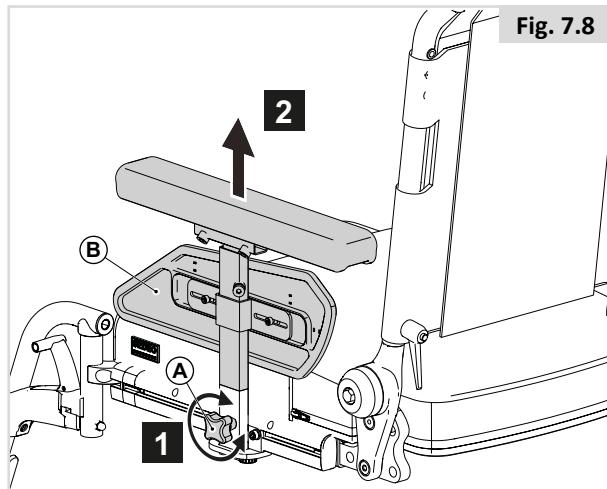


Fig. 7.8

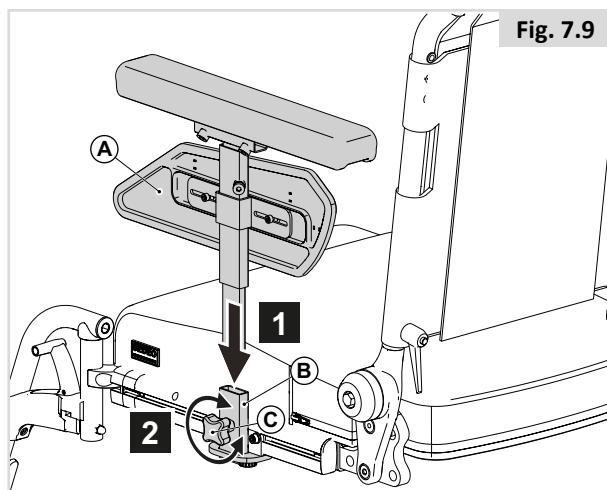


Fig. 7.9

8.0 Underhåll och rengöring

8.1 Allmänt underhåll

- Alla fästen bör kontrolleras månadsvis för slitage, såsom lösa bälten eller brustna komponenter.
 - Lösa infästningar ska dras åt enligt installationsanvisningarna.
- Se tabellen nedan för nödvändiga vridmoment.

Fästdonsdimensioner	Åtdragningsmoment (Nm)
M6-skruv/-bult	9 – 10

Obs: det kommer att bli nödvändigt att använda en momentnyckel.

- Kontrollera alla band varje månad för slitna remmar, sömmar eller andra indikationer på slitage. Använd ej produkten om den har en skada.
- Bröstremmar bör bytas ut vid första tecken på skada och/eller onormalt slitage.
- Om en brusten eller lös komponent har påträffats, sluta omedelbart att använda produkten och kontakta din hjälpmedicscentral eller auktoriserade Sunrise Medical-leverantör för byte.
- Kontrollera alla kardborrband för korrekt vidhäftning när dessa trycks samman.
- Se till att all kontaminering, såsom ludd eller hår avlägsnas från kardborrbanden. Sådan kontaminering kan påverka vidhäftningen.

8.2 Rengöring av sittsystemet

Rullstolen ska torkas ren en gång per vecka med en något fuktig, men inte blöt trasa och allt ludd eller damm som har samlats runt manöverdon bör blåsas eller dammas bort.

OBS/VIKTIGT!

Det är viktigt att du torkar alla delar på rullstolen som är våta eller fuktiga efter rengöring eller användning i regnigt eller fuktigt väder.

FARA/VARNING!

Om rullstolen ska används av fler än en person är det ur hygienspunkt viktigt att den rengörs noggrant.

8.2.2 Rengöring och inspektion av sitsen

FARA/VARNING!

Revor, bucklor, nötning och förlakning av klädseln, speciellt nära metalldelar, kan leda till dålig kroppshållning samt försämrad komfort och tryckavlastning.

Rengöringsanvisningar för sits:

Om det finns en tvättetikett på insidan av dynans överdrag kan du tvätta överdraget. Följ anvisningarna på tvättetiketten. Ta ut skuminläggen före tvätt, och stäng kardborrlåsen!

VARNING!

Använd inte organiska lösningsmedel som thinner, bensin eller lacknafta.

Kemtvätta inte klädseln. Stryk eller torktumla inte klädseln.

I de fall överdrag inte kan tas av bör dessa rengöras regelbundet. Rengör med en fuktig trasa med milt diskmedel. Utspädda desinfektionsmedel kan användas enligt tillverkarens instruktioner. Skölj noga alla ytor med rent vatten. Torka noga.

8.3 Hygienåtgärder för begagnade rullstolar:

Ska rullstolen användas som begagnad måste den först förberedas noga. Alla ytor som brukaren kommer i kontakt med måste behandlas med desinficeringsspray.

För att göra detta ska du använda ett lämpligt desinfektionsmedel för snabb alkoholbaserad desinfektion för medicinska produkter och medicinska enheter.

Var uppmärksam på tillverkarens instruktioner avseende det desinficeringsmedel du använder.

OBS/VIKTIGT!

- Använd ej lösningsmedel, blekmedel, polermedel, syntetiska tvättmedel, polervax eller spray.
- Utspädda desinfektionsmedel kan användas enligt tillverkarens instruktioner.
- Skölj noga alla ytor med rent vatten. Torka noga.

8.4 Allmänna rengöringsanvisningar:

OBS/VIKTIGT!

- Du bör avlägsna fläckar från sitsen så fort du kan.
- Efter en längre tids användning bör du rengöra sittöverdraget med vanligt skumrengöringsmedel.
- Du bör alltid rengöra hela ytan och inte bara enskilda fläckar, för då kan det uppstå fula märken. Ju längre du dröjer med att ta bort fläckar desto svårare blir de att avlägsna.
- Undvik att skrubba kraftigt med vatten. Då kan tyget ruggas upp.
- Smutsfläckar (t.ex. öl, blod, cola, rödvin etc) avlägsnas bäst med ett torrt skumrengöringsmedel eller med ett milt rengöringsmedel.
- Vänligen följ respektive användningsinstruktion vid behandling av överdraget.
- Överdraget bör få torka i åtminstone 48 timmar efter rengöring med skumrengöringsmedel.
- Fettfläckar (t.ex. kulspetspennor, läppstift, tuggummi etc). Använd fläckborttagare av ett välbekant och respekterat märke. Gnugga försiktigt den nedsmutsade ytan med en ren trasa som du impregnerar med fläckborttagningsmedel.
- Var restriktiv med fläckborttagningsmedlet – det behövs inte mycket.
- Testa först på ett litet och obemärkt ställe.
- Stopningen får inte vara för blöt, eftersom det då finns risk att fläckborttagningsmedlet förstör stopningen.
- Kraftfull gnuggning bör undvikas på de tryckta skalorna, t.ex. pilarna på sittplattan och måtpunkter på sittbreddjusteringen
- Använd ej en vattenslang eller högtrycksspruta på rullstolen.

FARA/VARNING!

- Läs alltid etiketten på alla rengöringsmedel.
- Följ alltid anvisningarna noga.

8.5 Rengöringstillbehör:

- Alla delar/tillbehör såsom svängbara bord rengörs med en fuktig trasa.
- Alla sidostöd, nackstöd, armstöd, sidoskydd, vaddynor, höftbälten och knädynor bör rengöras med en fuktig trasa.

8.6 Rengöra manöverboxen:

Om det har kommit smuts på manöverboxen kan du torka rent den med en fuktig trasa med lite desinfektionsmedel på.

FARA/VARNING!

- Följande instruktioner är särskilt viktiga ur hygienspunkt om stolen ska användas av fler än en person.
- Se till att paneler, styrspakar (alla varianter), huvudstyrningar och kontakter (alla varianter) av hygienskål rengörs med ett milt desinfektionsmedel. Efter att du tagit bort sug- och blåsmunstycket från stolen tvättar du av det för att det ska vara rent och funktionsmässigt.
- Se till att manöverboxen är avstängd innan du rengör.

8.7 Förvaring

Att hålla klädsel och andra delar av rullstol i gott skick, förvara i en torr miljö så nära rumstemperatur som möjligt.


FARA/VARNING!

- Låt aldrig stolen stå i direkt solljus, inte heller utomhus eller i fuktig miljö.
- Direkt solljus kan bleka klädsel/plastdelar och orsaka att metalldelar blir varma.

9.0 Avfallshantering

Symbolen nedan betyder att produkten ska kastas i enlighet med lokala lagar och förordningar samt skilt från hushållsavfall. När produkten är förbrukad ska den lämnas på en av lokala myndigheter anvisad avfallsstation. Tack vare att produktens delar då kan sorteras och återvinnas hjälper du till att bevara våra naturresurser, och du kan vara säker på att återvinningen sker på ett miljövänligt sätt.

Försäkra dig om att du är den juridiske ägaren av produkten innan du kasserar den enligt ovan nämnda rekommendationer och nationella bestämmelser.

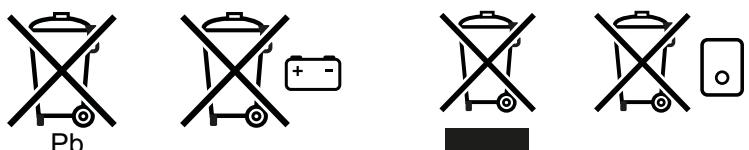

I följande avsnitt finns en beskrivning av materialen i rullstolen och dess förpackning, med avseende på en eventuell kassering eller återvinning av rullstolen med förpackning.

För bortskaffande eller återvinning av sittsystemet, var vänlig se handbok för Sedeo Lite (📖 Sittsystem).

Det kan också finnas speciella lokala bestämmelser beträffande kassering eller återvinning, dessa måste tas i beaktande vid kassering av din rullstol. (Dessa lagar reglerar eventuellt även hur stolen ska rengöras eller saneras före kasseringen.)

Aluminium: Länkhjulsgafflar, hjul, sidoskydd för chassin.

Stål: Förankringspunkter, Quick-release axlar

Plast: Handtag, rörpluggar, länkhjul och hjul/däck

Förpackningsmaterial: Plastpåsar av mjuk polyeten, kartong

Avfallshantering eller återvinning bör göras genom en licensierad agent eller auktoriserad plats för avfallshantering. Alternativt kan din rullstol returneras till din återförsäljare för avfallshantering.



10.0 Tekniska specifikationer:

10.1 Tillämpliga normer/standarder

EN-ISO10993-5: 2009	Biologisk utvärdering av medicinsk utrustning.
EN 1021 1&2	Utvärdering av antändlighet för stoppade möbler. Tändkälla: Glödande cigarett;brinnande tändsticka

10.2 Tekniska specifikationer:

Sittsystem Sedeo Lite

SVENSKA

	Metriska systemvärden		Brittiska systemvärden och alternativ	
	Minst	Högst	Minst	Högst
Sittvinkeljusteringar				
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	0° - 30°		-5° - 25°	
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	-5° - 25°		0° - 30°	
Elektrisk tilt med tyngdpunktsjustering tillval	0° - 50°		0° - 50°	
Effektivt sittdjup	410 mm	560 mm	16,1"	22,0"
Effektiv sittbredd	385 mm	510 mm	15,2"	22,1"
Sits till golvhöjd				
Fyllnadsmodul (Ingen eltilt i utrymme, ingen sitslift)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	415 mm		16,3"	
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	440 mm		17,3"	
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	465 mm		18,3"	
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	490 mm		19,3"	
Eltilt och sitsliftar (300 mm)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	465 mm	765 mm	18,3"	30,1"
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sittvinkel	490 mm	790 mm	19,3"	31,1"
Ryggstödsvinkel				
Verktygsvinkel justerbar bakåt	86°,90°,94°,98°,102°,106°		86°,90°,94°,98°,102°,106°	
Eldrivet bakåtlutande ryggstöd	85° - 120°		85° - 120°	
Ryggstödshöjd (sittplatta till överst på ryggdyna)	460 mm	510 mm	18,1"	20,1"
Uppfällbart armstöd				
Armstödsdyna höjd (sittplatta till överst på armdyna)	190 mm	320 mm	7,5"	12,6"
Armstödsdyna djup (på armstödsprofil)	100 mm		3,9"	
Armstödsdyna vinkel (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Centermonterat armstöd				
Armstödsdyna höjd (sittplatta till överst på armdyna)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Armstödsbredd (på sitsram)	-20 mm	+20 mm	-0,79"	+0,79"
Armstödsdyna bredd (på armstödsprofil)	-20 mm		-0,79"	
Armstödsdjup (på sitsram)	250 mm		9,8"	
Armstödsdyna djup (på armstödsprofil)	140 mm		5,5"	
Armstödsdyna vinkel (vertikal)	0° - 15°		0° - 15°	
Centermonterat benstöd				
Underbenslängd (från sitsplatta)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Knävinkel	70° - 120°		70° - 120°	
Vristvinkel	+20° - -40°		+20° - -40°	
Centermonterad elektriskt benstöd				
Underbenslängd (från sitsplatta)	210 mm	470 mm	8,3"	18,5"
Knävinkel	90° - 180°		90° - 180°	
Max längdkompensation	180 mm		7,1"	
Vristvinkel	+35° - -15°		+35° - -15°	
Swing away SEDEO LITE benstöd				
Underbenslängd (från sitsplatta)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knävinkel	70°		70°	
Vristvinkel	0° - 180°		0° - 180°	

	Metriska systemvärden		Brittiska systemvärden och alternativ	
	Minst	Högst	Minst	Högst
Swing away SEDEO LITE benstöd, manuellt höjbart/eldrivet höjbart				
Underbenslängd (från sitsplatta)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knävinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Vristvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Swing away UNI benstöd				
Underbenslängd (från sitsplatta)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knävinkel	70°		70°	
Vristvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Swing away SEDEO PRO benstöd				
Underbenslängd (från sitsplatta)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knävinkel	70°		70°	
Vristvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
Swing away SEDEO PRO benstöd, manuellt höjbart/eldrivet höjbart				
Underbenslängd (från sitsplatta)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knävinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Vristvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
SEDEO Multi-Position nackstöd				
Nackstöd höjd justeringsintervall	170 mm		6,7"	
Nackstöd djup justeringsintervall	200 mm		7,9"	
Nackstöd vinkel (vertikal)	-45° - +45°		-45° - +45°	
Nackstöd bredd	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Sidostöd				
Sidostöd bredd justeringsintervall	90 mm		3,5"	
Sidostöd höjd justeringsintervall	170 mm		6,7"	
Sidostöd djup justeringsintervall	45 mm		1,8"	
Abduktionsknapp				
Abduktionsknapp höjd (från sittplatta till överst på dyna)	170 mm	250 mm	6,7"	9,8"
Abduktionsknapp djup justeringsintervall	65 mm		2,5"	

11.0 Garanti

DENNA GARANTI PÅVERKAR INTE DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER I NÅGOT AVSEENDE.

Sunrise Medical* erbjuder en garanti, enligt garantivillkoren för rullstolar till sina kunder som täcker följande.

Garantivillkor:

1. Skulle någon eller några av rullstolens delar behöva repareras eller bytas ut som resultat av ett tillverknings- och/eller materialfel inom 24 månader (5 år för ram och tvärstag) efter leverans till kunden, kan defekta delar repareras eller bytas ut utan kostnad. Garantitiden täcker endast tillverkningsfel.
2. För att använda garantin, kontakta din Hjälpmedelscentral eller återförsäljare som godkänts av Sunrise Medical med exakt beskrivning av problemet.
Om stolen, då ett problem uppstår, skulle finna sig alltför långt bort från det anvisade Sunrise Medical-serviceombudet, kan reparationer eller utbyte servas av en annan serviceverkstad som är utsedd av tillverkaren. Rullstolen måste repareras av ett godkänt Sunrise Medical-serviceombud, (återförsäljare).
3. För delar som har reparerats eller bytts ut inom ramen för denna garanti, erbjuder vi en garanti i enlighet med dessa garantivillkor för den återstående garantiperioden för rullstolen enligt med punkt 1).
4. Originala reservdelar som har monterats genom kundens försorg, kommer att ha en 12 månaders garanti, (efter montering), enligt dessa garantivillkor.
5. Vi ansvarar inte för reparationer eller utbyte av en rullstol eller del i följande fall:

- a. Normalt slitage, vilket inkluderar batterier, armstödsdynor, sittklädsel, däck, brombsbackar osv.
- b. Eventuell överbelastning av produkten, var vänlig kontrollera EU-märkning för max brukarvikt.
- c. Produkten eller delen har inte underhållits eller servats enligt tillverkarens rekommendationer i användar- och/ eller servicehandboken.
- d. Tillbehör som inte kan anses vara originaldelar har använts.
- e. Rullstolen eller del därav har skadats på grund av slarv, olycka eller olämpligt användningssätt.
- f. Ändringar/modifikationer av rullstolen eller dess delar som ej utförts enligt tillverkarens anvisningar.
- g. Reparationer har utförts innan serviceombudet konsulterats.

6. Denna garanti gäller enligt lagen i det land där denna produkt inköptes från Sunrise Medical.*

* Innebär Sunrise Medical-firman där produkten inhandlades.

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af dit siddesystem, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din lokale, autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt du ikke har adgang til en autoriseret forhandler i dit lokalområde, eller hvis du har nogle andre spørgsmål, bedes du ringe eller skrive til:

Sunrise Medical ApS

Mårkærvej 5-9

2630 Taastrup

Denmark

+45 70 22 43 49

info@sunrisemedical.dk

www.Sunrisemedical.dk



ISO 7010-M002

**Brugermanualen/Dette hæfte
skal læses! (Blåt ikon)**

Sunrise Medical ApS underskrift og stempel

Indholdsfortegnelse

1.0 Oplysninger til brugeren	46
1.1 Denne brugermanual	46
1.2 For yderligere information	46
1.3 Symboler anvendt i denne manual	46
2.0 Sikkerhed	47
2.1 Sæderelaterede symboler og etiketter anvendt på produktet	47
2.2 Sikkerhed: Temperatur	47
2.3 Sikkerhed: Bevægelige dele	47
2.4 Sikkerhed: Kvælningsfare	47
2.5 Sikkerhed: Borde	48
3.0 Generel beskrivelse	48
4.0 Opsætning af siddesystemet	49
4.1 Forudindstillet sædedybde	49
4.2 Forudindstillet sædebredde	50
4.3 Forudindstil ryglæn (denne justering må kun udføres af en uddannet fagperson)	51
4.4 Forudindstil flip-back-armlæn	53
4.5 Forudindstillede single-post armlæn	54
4.6 Forudindstillede single-post flip-back armlæn	54
4.7 Sidestykke	57
4.8 Forudindstillet, midtermonteret benstøtte	58
4.9 Forudindstil den faste, midtermonterede benstøtte	59
4.10 Forudindstillet, midtermonteret, elektrisk benstøtte	60
4.11 Forudindstillede SEDEO LITE svingbare benstøtter	61
4.12 Forudindstillet UNI svingbar benstøtte	61
4.13 Forudindstillede svingbare benstøtter	62
4.14 Forudindstillet hovedstøtte	63
4.15 Forudindstillet fast beslag/svingbart beslag til betjeningsenhed	64
4.16 Forudindstillet svingbart beslag til betjeningsenhed	65
4.17 Forudindstillet sidestøttetilbehør	66
4.18 Forudindstillet lateral svingbar knæ-/lårstøtte	67
4.19 Forudindstillet abduktionskile (pommel)	67
4.20 Hoftesele / siddepositioneringssele	68
5.0 Anvendelse af siddesystemet	69
5.1 Sådan kommer du ind og ud af kørestolen (Forflytning)	69
5.2 Sådan gør du dig klar til en fremadrettet forflytning	69
5.3 Sådan gør du dig klar til en sidelæns forflytning	70
5.4 Hovedstøtte	71
5.5 Betjeningsenhedens svingbeslag	71
5.6 Sidestøtte (Fig. 5.11)	71
5.7 Knæstøtte/Lårstøtte (Fig. 5.12)	72
5.8 Hemiplegi-armlæn (Fig. 5.13)	72
5.9 Abduktionskile (Fig. 5.14)	72
6.0 Manuelle og elektriske sædefunktioner	73
6.1 Manuelle sædefunktioner	73
6.2 (Elektriske) sædefunktioner	74
7.0 Reduktion af sædesystemets størrelse ved transport	75
7.1 Siddepude	75
7.2 Rygpude	75
7.3 Slå ryglænet ned (Fig. 7.4)	76
7.4 Sådan slås det tilbagelænende ryglæn ned (Fig. 7.5)	76
7.5 Svingbare benstøtter (Fig. 7.6)	77
7.6 Aftageligt single-post armlæn	77
8.0 Vedligeholdelse og rengøring	78
8.1 Generel vedligeholdelse	78
8.2 Rengøring af siddesystemet	78
8.3 Hygiejneprocesser ved genanvendelse:	78
8.4 Generelle rengøringsanvisninger:	79
8.5 Rengøringstilbehør:	79
8.6 Rengøring af betjeningsenheden:	79
8.7 Opbevaring	79
9.0 Bortskaffelse	80
10.0 Tekniske specifikationer:	81
10.1 Gældende normer/standarder	81
10.2 Tekniske specifikationer: Sedeo Lite siddesystem	82
11.0 Garanti	84

1.0 Oplysninger til brugeren

Tak, fordi du har valgt en Sunrise Medical-kørestol. Sunrise Medicals produkter er af høj kvalitet og er designet til at forbedre din uafhængighed og gøre din hverdag nemmere.

1.1 Denne brugermanual

Denne brugermanual vil hjælpe dig med at anvende og vedligeholde sædesystemet på sikker vis. Denne sædemanual er et supplement til Sunrise Medicals generelle brugermanual til kørestolen:

- Den generelle brugermanual til kørestolen
- Brugermanualen til siddesystemet (dette hæfte)
- Brugermanualen til betjeningsenheden.

Når det er nødvendigt, henviser denne brugermanual til sædesystemet til andre manueler som vist nedenfor:

- | | |
|---|---|
|  Generel manual: | Henviser til den generelle brugermanual til kørestolen. |
|  Betjeningsenhed: | Henviser til brugermanualen for betjeningsenheden. |
|  Batteriplader: | Henviser til brugermanualen for batteripladeren. |

Du må ikke bruge kørestolen, før du har læst og forstået hele denne manual (og alle andre hæfter)!

Hvis en af brugermanualerne ikke er vedlagt din kørestol, bedes du straks kontakte din forhandler. Ud over denne brugermanual, findes der også en servicemanual til kvalificerede specialister.

1.2 For yderligere information

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af din kørestol, vedligeholdelse eller sikkerhed, bedes du kontakte din lokale, autoriserede Sunrise Medical-forhandler. Såfremt den lokale forhandler ikke kan hjælpe, eller hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til Sunrise Medical ApS.

For information om produktsikkerhedsbemærkninger eller produkttilbagekaldelser, fortsæt til www.SunriseMedical.dk

1.3 Symboler anvendt i denne manual



Mulig risiko for skade, alvorlig skade eller død




Mulig beskadigelse af udstyr.


Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det resultere i personskade, beskadigelse af produktet eller skade på miljøet.

Bemærkning til brugeren og/eller patienten: Alvorlige hændelser, der opstår i relation til enheden, skal indberettes til producenten og den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren og/eller patienten bor.

Fig. 1.1

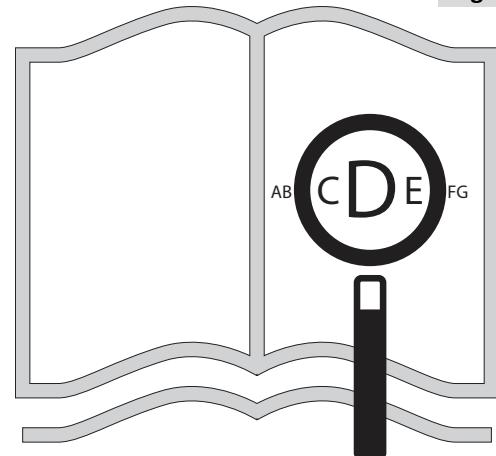

Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på
www.SunriseMedical.dk

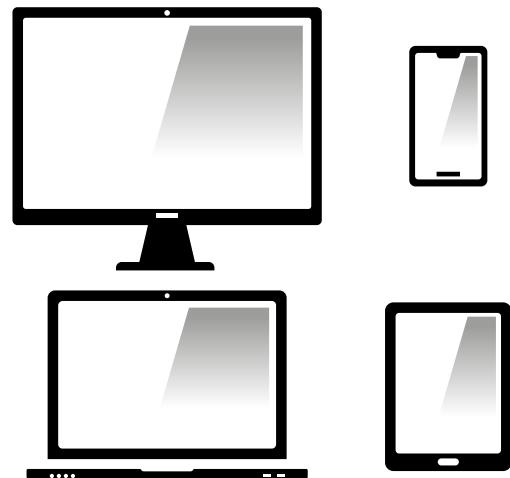

eller alternativt kan det stilles til rådighed i stor tekst.



2.0 Sikkerhed

Følg altid anvisningerne ved siden af disse advarselssymboler nøje! Hvis disse anvisninger ikke følges nøje, kan det resultere i personskade, beskadigelse af kørestolen eller skade på miljøet. Når det er muligt, er der medtaget sikkerhedsinformation i det relevante kapitel.

2.1 Sæderelaterede symboler og etiketter anvendt på produktet

Skilte, symboler og anvisninger, der er fastgjort til kørestolen, udgør en del af sikkerhedsoplysningerne. De må aldrig tildækkes eller fjernes. De skal være til stede og let læselige i hele kørestolens levetid.

Udskift eller reparér straks alle ulæselige eller beskadigede skilte, symboler og anvisninger. Kontakt din forhandler for at få assistance.

Fig. 2.1: Advarsel – Risiko for, at fingrene kommer i klemme.

Fig. 2.2: Advarsel – Sørg for, at quick-release-skruen til sædets samleflademodul er spændt forsvarligt fast, inden kørestolen tages i brug, især ved kørsel på skråninger

Fig. 2.3: Advarsel – Kørestolen må ikke køre på skråninger, mens den har tilbagelænet ryglæn og/eller sædet i ståtilstand

2.2 Sikkerhed: Temperatur

RISIKO/ADVARSEL!

- Hvis du ikke anvender kørestolen, skal du sikre dig, at den ikke står, hvor den er utsat for direkte sollys i en længere periode. Visse dele af kørestolen, såsom sæde, ryg- og armlæn, kan blive varme, hvis de har været utsat for fuldt sollys for længe. Dette kan forårsage forbrændinger eller allergiske reaktioner på huden.

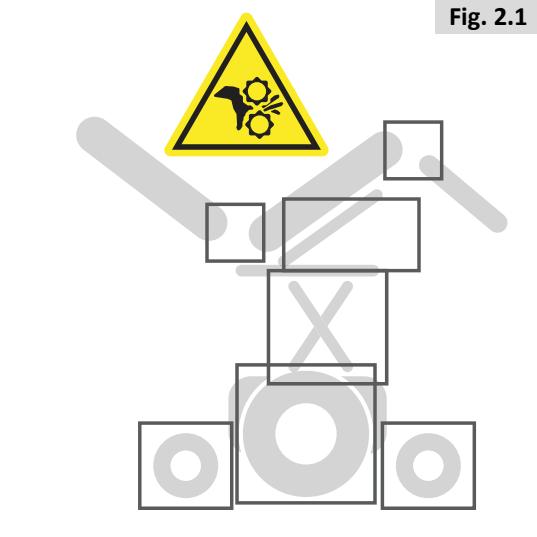


Fig. 2.2



2.3 Sikkerhed: Bevægelige dele

RISIKO/ADVARSEL!

En kørestol har bevægelige og roterende dele. Kontakt med bevægelige dele kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af kørestolen. Kontakt med kørestolens bevægelige dele bør undgås.

- Motoriseret justering af hældning
- Motoriseret sædeløft (valgfrit)
- Motoriseret justering af rygvinkel
- Betjeningsenhedens svingbeslag

2.4 Sikkerhed: Kvælningsfare

RISIKO/ADVARSEL!

Dette mobilitetshjælpemiddel bruger små dele, som under visse omstændigheder kan udgøre en kvælningsrisiko for små børn.



2.5 Sikkerhed: Borde

Sikkerhed: Ventilationsplade

⚠️ RISIKO/ADVARSEL!

Brug af ventilationsplade påvirker kørestolens stabilitet og samlede vægt.

- Sørg for, at batterierne og ventilatoren sidder forsvarligt fast på pladen inden i brugtagning.
- For at undgå risikoen for sammenstød bør du øve dig, så du vænner dig til kørestolens udvidede omfang, inden du kører med ventilationspladen monteret.
- Sørg for, at området omkring ventilationspladen er frit, når du læner ryglænet tilbage.
- Bemærk, at der er en risiko for at få fingrene i klemme i samlingen til ventilationspladen, når ryglænet er tilbagelænet.
- Ventilationspladen er ikke beregnet til at bære andet end ventilationsenheden og de tilhørende batterier. Pladen er ikke konstrueret til at bære iltflasker o.l. Ved brug af sådanne genstande er der risiko for, at kørestolen bliver ustabil.
- Ventilationspladen skal monteres og vedligeholdes af en af tekniker autoriseret af Sunrise Medical.

Sikkerhed: Kørestolsbord med sidedrejning:

⚠️ RISIKO/ADVARSEL!

- Bordpladen kan maksimalt tåle en samlet vægt på 2,5 kg.
- Pas på ikke at overbelaste bordpladen, da dette medfører risiko for, at bordpladen revner, eller at kørestolen bliver ustabil.
- Undgå at placere tændte cigaretter eller andre varmekilder på bordpladen, da den derved kan komme ud af facon eller få grimme mærker.
- Sørg for, at hænder, fødder, tøj osv. er væk fra bordet, når det indstilles til brug.

3.0 Generel beskrivelse

Denne kørestol er udstyret med et Sedeo Lite-siddesystem. Sedeo Lite-siddesystemet giver fremragende støtte for hoved, torso, arme og ben. Optimal kropsstøtte sikrer maksimal uafhængighed for kørestolsbrugeren.

Kørestolen skal justeres af en kvalificeret specialist. Forkerte indstillinger kan have uheldige konsekvenser for siddestillingen.

Hovedkomponenter (Fig. 3.1):

1. Hovedstøtte
2. Joystick
3. Armlæn
4. Siddepude
5. Benstøtte
6. Ryglæn

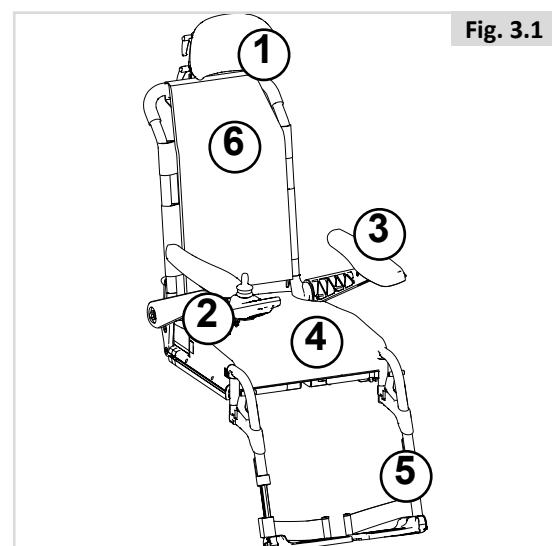


Fig. 3.1

4.0 Opsætning af sædesystemet

Den gennemsnitlige kørestolsbruger findes ikke. Af denne grund kan Sunrise Medical-kørestole forudindstilles i forhold til brugerens specifikke behov.

Indstillingerne udføres én gang, nemlig inden kørestolen anvendes første gang. De skal udføres af en kvalificeret specialist, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Værktøj og kalibreringsmærker

Der skal anvendes en M5-unbrakonøgle af en faglært tekniker til justering af alle sædesystemets indstillinger.



BEMÆRK/VIGTIGT!

Der er kalibreringsmærker på forskellige dele af sædesystemet. Fabriksindstillerne er angivet.

4.1 Forudindstillet sædedybde

Ryglænsrammens dybde (Fig. 4.1): 1. Løsn (A) én omgang i begge sider. 2. Justér (B) til den ønskede position. 3. Spænd (A). BEMÆRK/VIGTIGT! Ved sædedybder på 535 og 560 skal du tage (A) helt ud og justere dem i den næste åbning. BEMÆRK/VIGTIGT! - Når en større sædedybde er påkrævet, skal du sikre, at kablerne er blevet forlænget, inden mekanisk justering finder sted. Sædehyndens dybde (Fig. 4.2) For placering af sædepuden (for sædepuder med indbygget sædeplade) anvendes hullerne i Fig. 4.2. Puden kan anbringes et trin ekstra mod fronten for at skabe ekstra sædedybde. Sedeo Lite Rev. H 49

4.2 Forudindstillet sædebredde

Juster sæderammens bredde ved at justere sædeplade- og rygstøttebredden samtidigt. Se Fig. 4.3, 4.4 og 4.5 for at få en nem forklaring.

Sæderammebredde (Fig. 4.3)

Løft siddepuden fra Velcro®-båndene for at få adgang til sædepladerne.

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

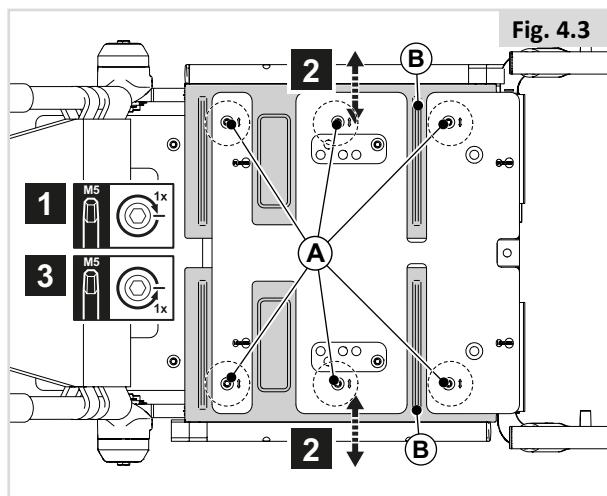


Fig. 4.3

Rygstøttebredde (Fig. 4.4)

1. Åbn betrækket
2. Tag (A) helt ud.
3. Justér (B) til den ønskede position.
4. Montér (A).
5. Luk betrækket



Rygstøttebredden kan justeres i to størrelser. En på 385-485 mm og en på 460-510 mm.

Rygstøttebredde for elektrisk tilbagelæning (Fig. 4.5)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

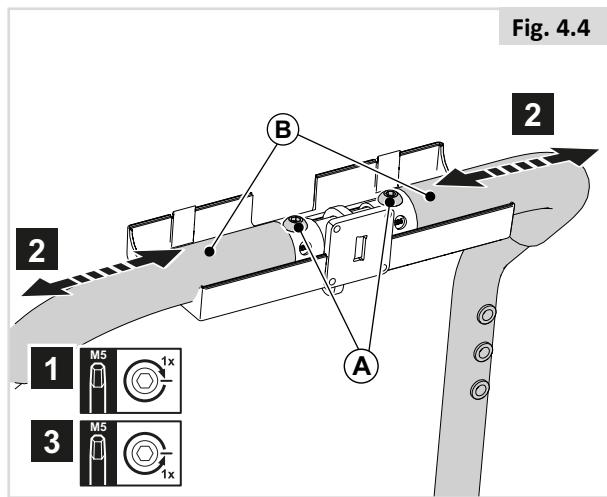


Fig. 4.4

Bredde på single-post flip-back armlæn med enkelt stang (Ekstraudstyr) (Fig. 4.6)

Der kan kun foretages finjusteringer af armlænene.

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).



Du bedes tjekke, at den nye placering af armlænene ikke intervernerer med sædets placering.

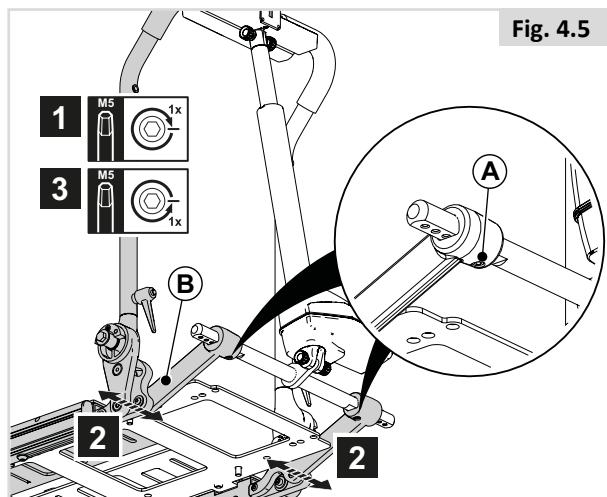


Fig. 4.5

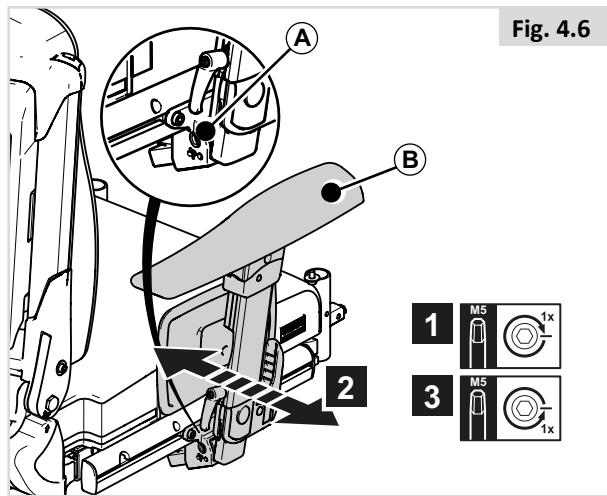


Fig. 4.6

4.3 Forudindstil ryglæn (denne justering må kun udføres af en uddannet fagperson).

Ryglænsvinkel (Fig. 4.7)

1. Løsn (A), indtil (B) er fri
2. Justér (B) til den ønskede position for at kunne justere (C).
Rotér (B) med 180° for at opnå -4°, 4°, 12°.
3. Spænd (A)

BEMÆRK: Stifterne skal være indeni huller, og pladen (B) skal fastgøres, så den flugter med overfladen.

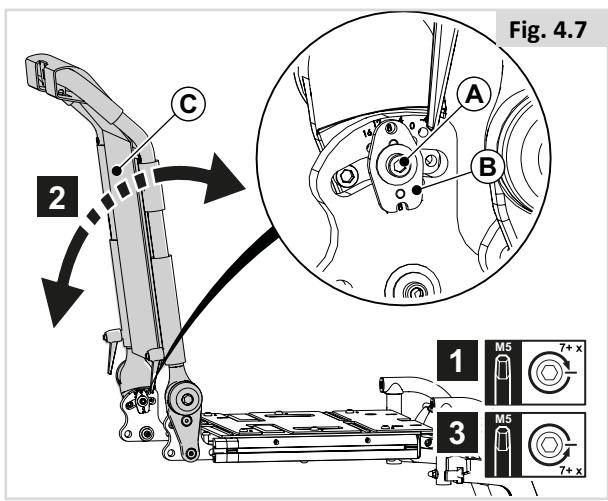


Fig. 4.7

Ryglænshøjde for stropryg (Fig. 4.8)

1. Fjern (A) ved at åbne (B).
2. Tag (C) helt ud.
3. Justér (D) til den ønskede position.
4. Spænd (C).
5. Sæt (A) på plads.

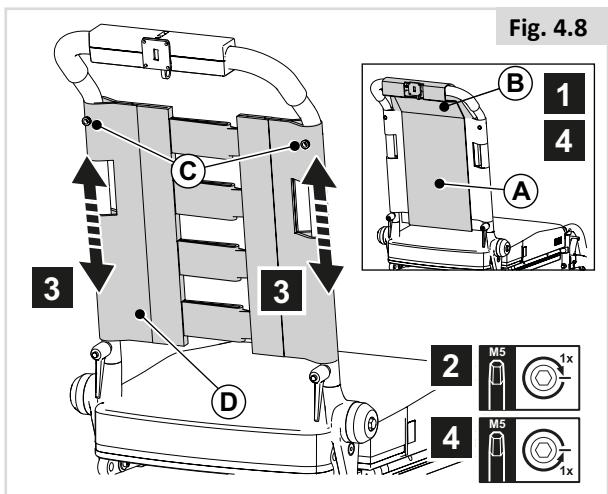


Fig. 4.8

Ryglænshøjde for SEDEO LITE's rygpude (Fig. 4.9)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

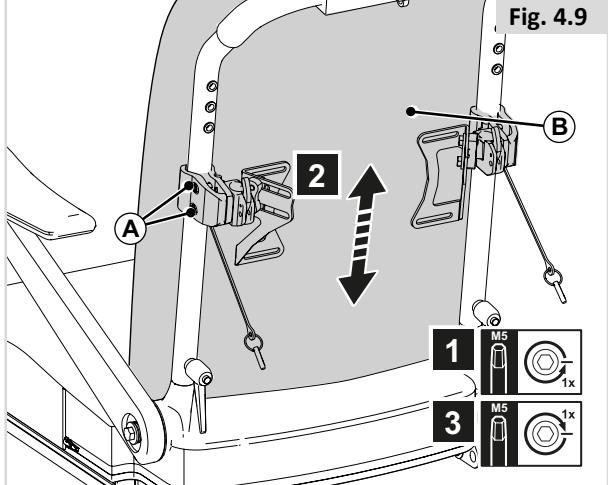


Fig. 4.9

Stropryg med justerbare remme (Fig. 4.10)

Kørestolen har et ryglæn med stropper, der kan justeres til ryggens krumning for at opnå en komfortabel siddestilling og god stabilitet. Bruger kan sidde i kørestolen, når der bliver foretaget justeringer af ryglænets krumning.

1. Slå (A) ned.
2. Løsn eller stram (B) med velcrobånd.

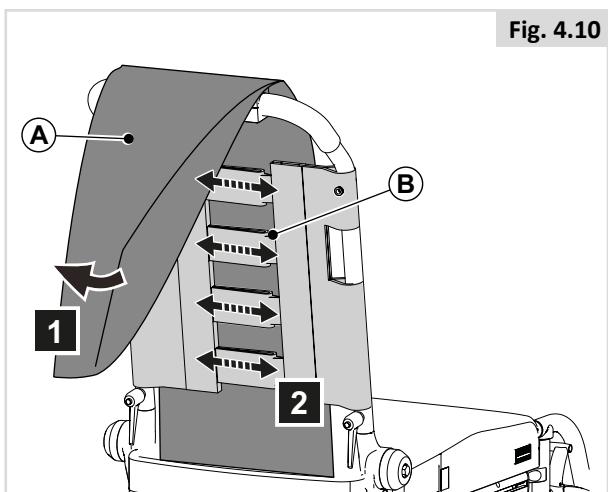


Fig. 4.10

! BEMÆRK/VIGTIGT

Den følgende handling må kun udføres af en professionel tekniker, der er uddannet hos Sunrise Medical.

Hvis du har et ryglæn, der kan lænes tilbage, og stropperne er for løse, kan du utilsigtet komme til at berøre aktuatoren. Hvis det er tilfældet, kan du dreje aktuatoren 180° og på denne måde få mere plads (Fig. 4.11).

1. Fjern (A)
2. Drej (B).
3. Spænd til igen (A).

! BEMÆRK/VIGTIGT

Kabelløkken skal muligvis omjusteres.

Ryglæn med fleksibel lateral støttevinkel (Fig 4.12)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Ryglæn med fleksibel krumning (Fig 4.13)

Kørestolen har et polstret ryglæn, der kan justeres til ryggens krumming for at opnå en komfortabel siddestilling og god stabilitet. Brugeren kan sidde i kørestolen, når der bliver foretaget justeringer af ryglænets krumning.

1. Åbn lynlås
2. Tryk på A for at løsne remmen
3. Løsn eller stram hver rem individuelt
4. Giv slip på A for at bevare remmens indstilling

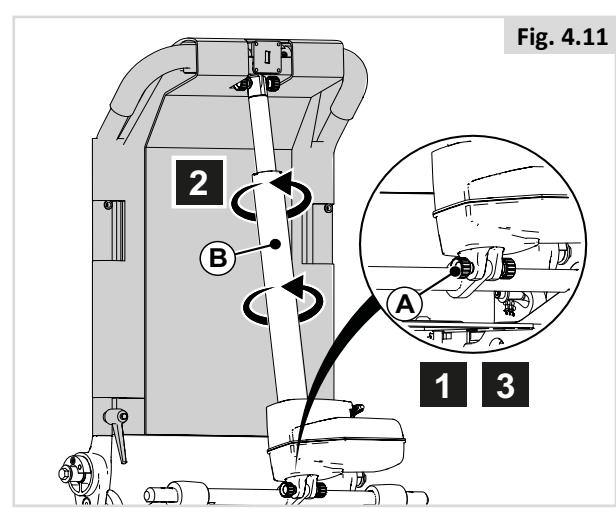


Fig. 4.11

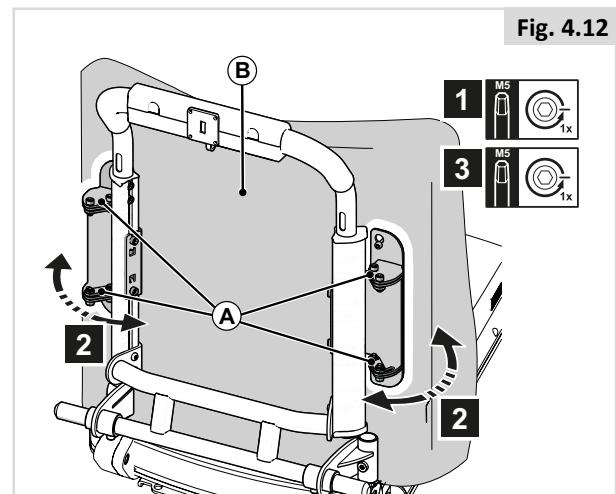


Fig. 4.12

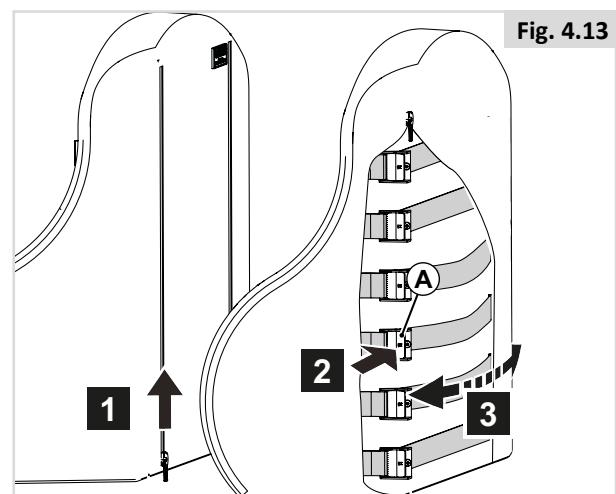


Fig. 4.13

J3 Ryg, (Fig. 4.14)

BEMÆRK: Jay 3-ryglænet kan anvendes sammen med Sedeo Lite-siddesystemet. Se brugermanualen til J3-ryglænet vedrørende montering og justering.

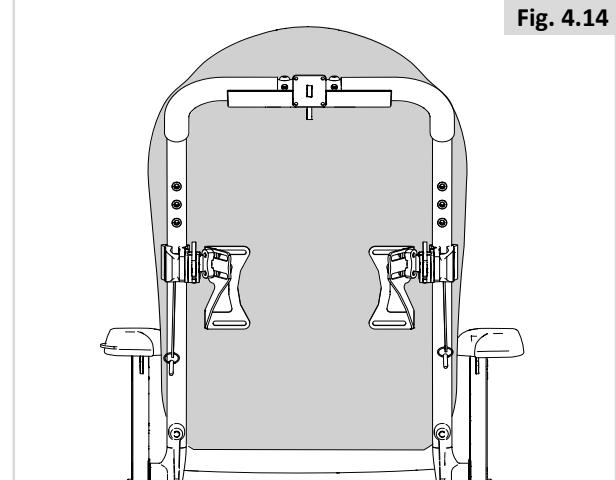


Fig. 4.14

4.4 Forudindstil flip-back-armlæn

Armlænshøjde

Fin- eller grovjustering er en totrinsproces:

TRIN 1 (Fig. 4.15)

- Drej (A) for at justere (B).

TRIN 2 (Fig. 4.16)

- Løsn (A) ved at dreje én omgang.
- Justér (B) til den ønskede position.
- Spænd (A).

Armlænspudens dybde (Fig. 4.17)

- Løsn (A) ved at dreje én omgang.
- Justér (B) til den ønskede position.
- Spænd (A).

BEMÆRK

For at kunne nå den bageste skrue ved lave armlænshøjder, skal du først løsne skruerne (A) i Fig. 4.16 og justere pudens vinkel.

RISIKO/ADVARSEL!

Det skal regelmæssigt kontrolleres, at alle skruer er ordentligt strammet. En løs armlænspude kan glide ned, når der trykkes på den.

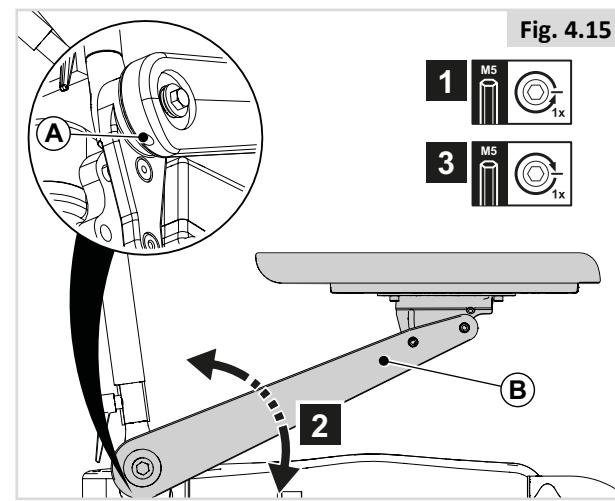


Fig. 4.15

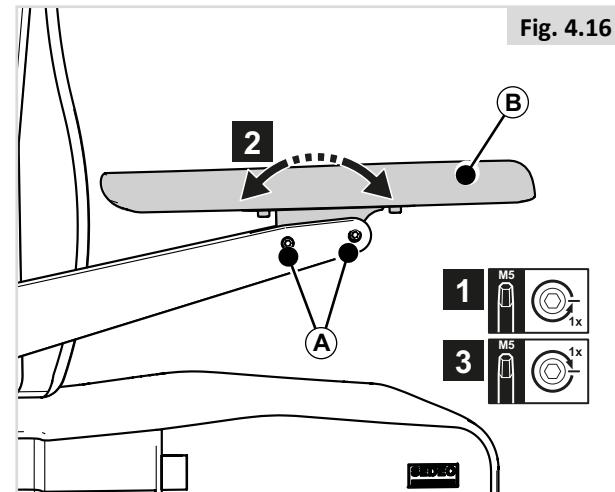


Fig. 4.16

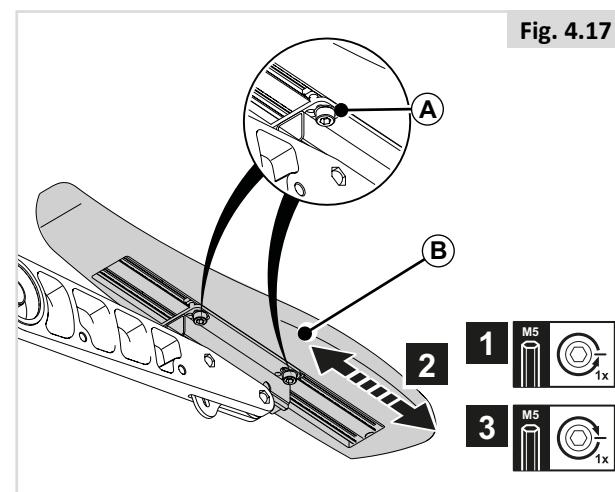


Fig. 4.17

4.5 Forudindstillede single-post armlæn

Armlænshøjde (Fig. 4.18)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Armlænsdybde (Fig. 4.19)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Løsn (B).
3. Justér (C) til den ønskede position.
4. Spænd (A) og (B).

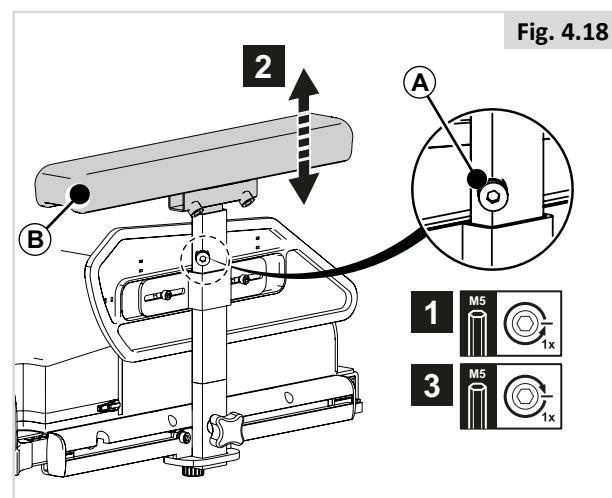


Fig. 4.18

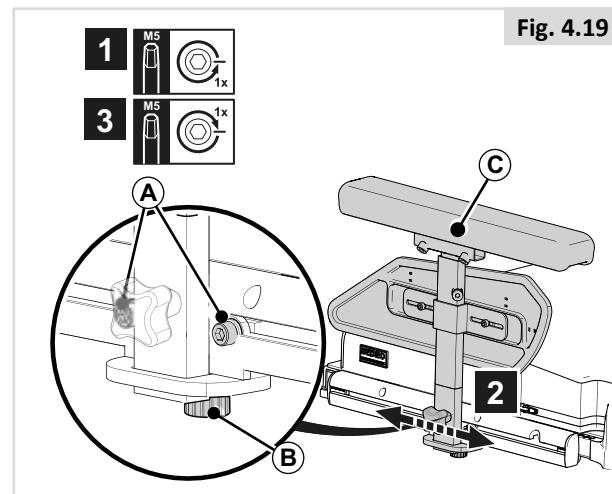


Fig. 4.19

4.6 Forudindstillede single-post flip-back armlæn

Armlænshøjde (Fig. 4.20)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Sørg for, at armene understøttes godt, uden at skuldrene bliver skubbet opad.

Armlænsdybde (Fig. 4.21)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Anbring flip-back armlænet længere tilbage for at få mere plads til sidelæns forflytninger. Anbring armlænet længere fremme for at få mere støtte til fremadrettede forflytninger.

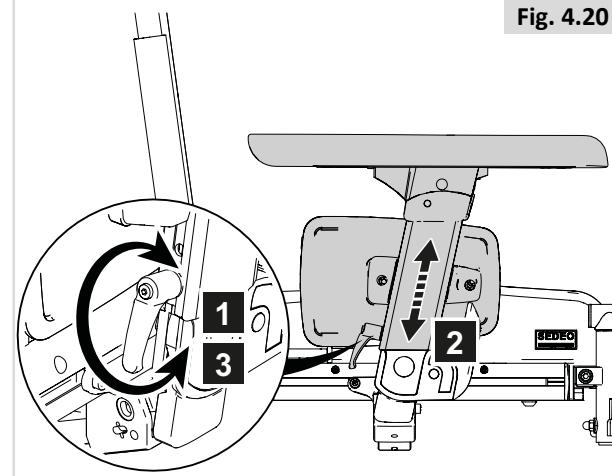


Fig. 4.20

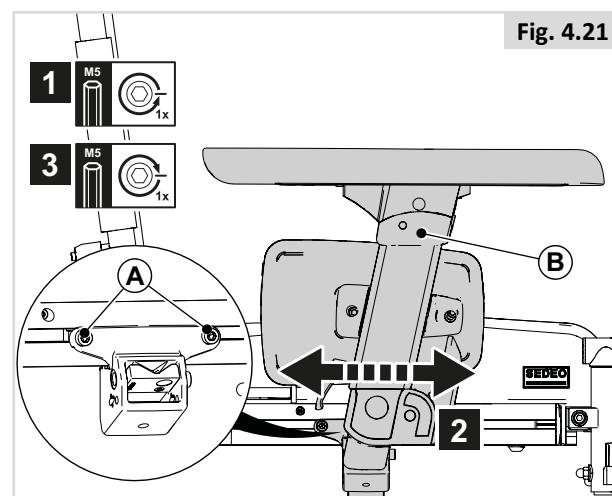




Fig. 4.21

Armlænsvinkel (Fig. 4.22)


1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Sideafskærmmningshøjde (Fig. 4.23)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

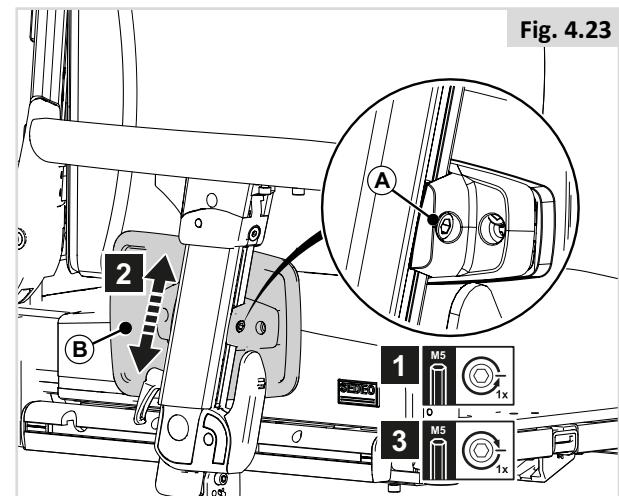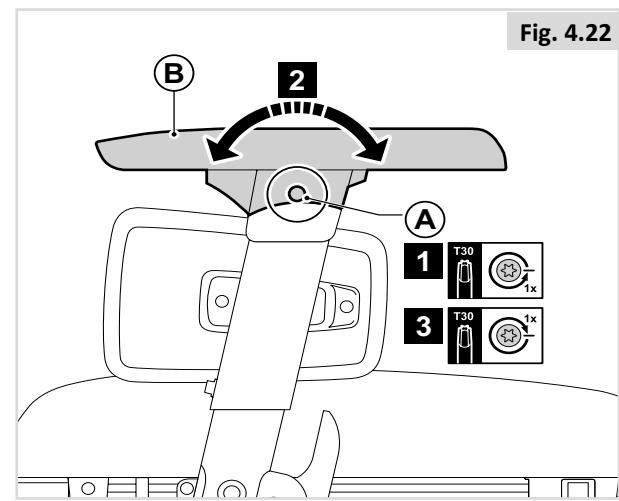**Armlænspudens dybde (Fig. 4.24)**

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

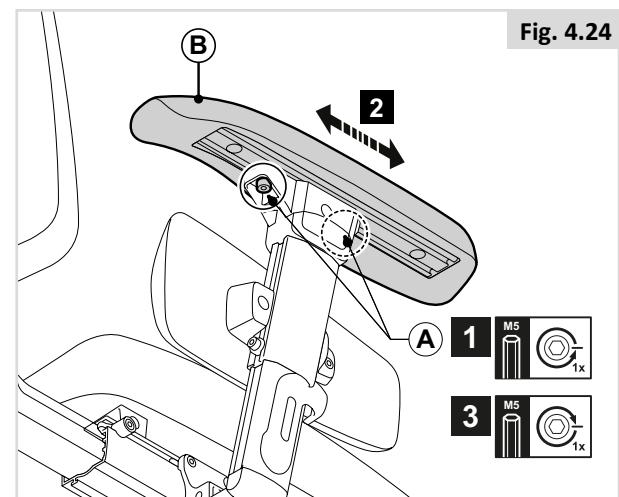

Armlænspudens bredde (Fig. 4.25-4.28)**Fig. 4.25****For at fjerne:**

1. Løsn (A).
2. Fjern (B).
3. Løsn (E) ved at dreje én omgang.
4. Fjern (F).





Placering:

1. Skub (A) sammen med B eller C over på D



Sørg for, at kanten på klemrækken falder ind i åbningen

1. Justér dybden af (A), og stram (E).
2. Anbring kontrolenhedens holder.
3. Anbring armlænet.

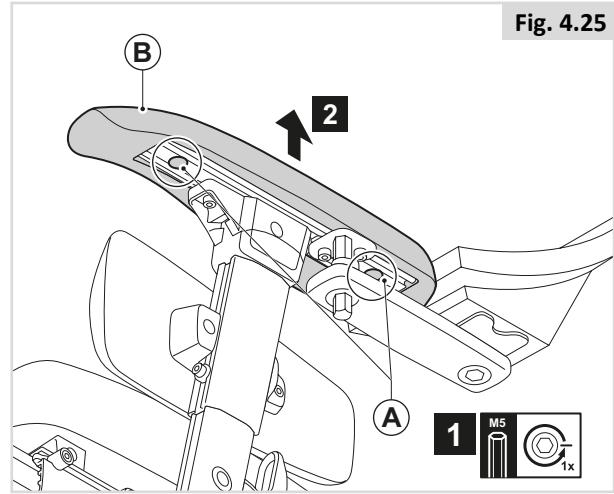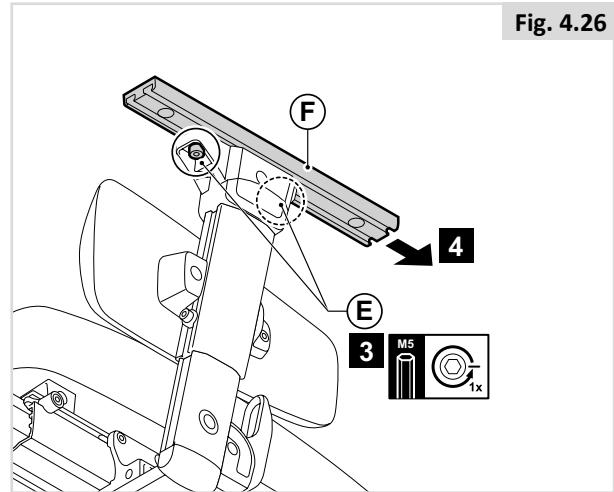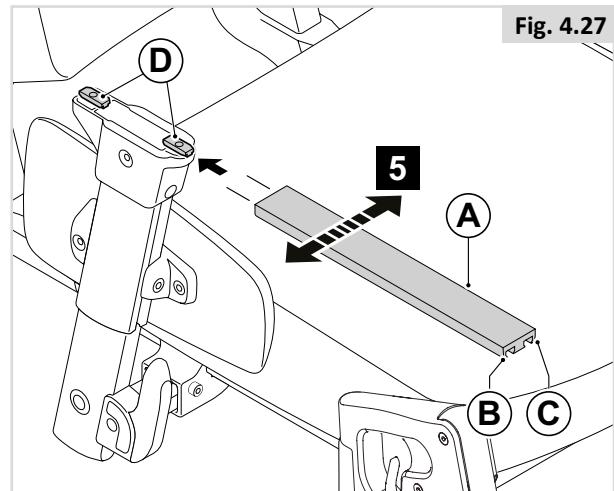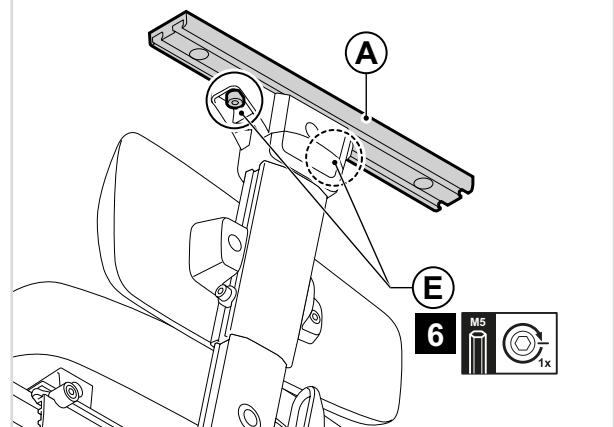**Fig. 4.26****Fig. 4.27****Fig. 4.28**



4.7 Sidestykke

Sideafskærmningshøjde (Fig. 4.29)

1. Skrue (A) af.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Sideafskærmningsdybde (Fig. 4.30)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

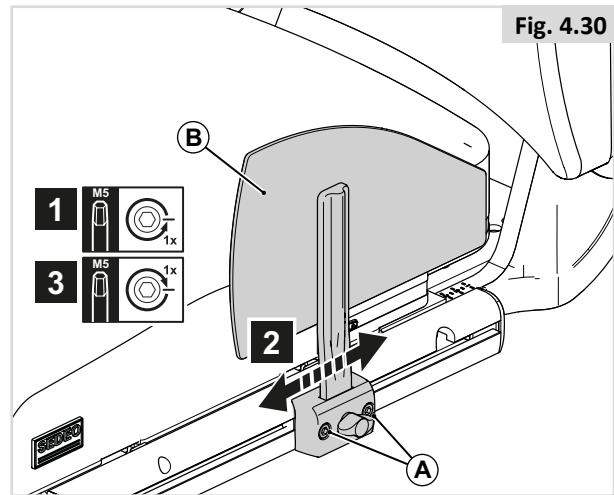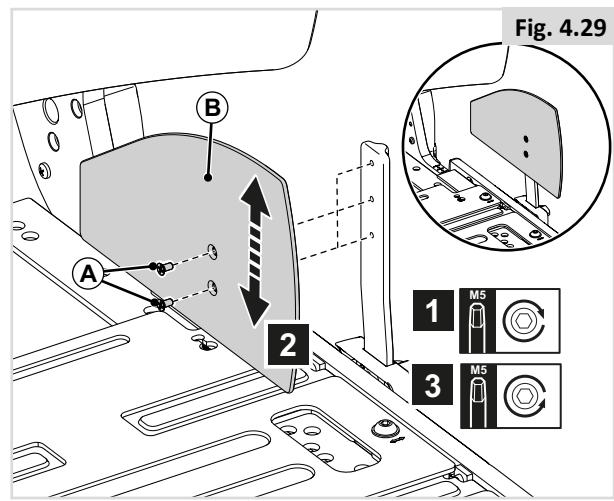

4.8 Forudindstillet, midtermonteret benstøtte

Fig. 4.31

Underbenslængde (Fig. 4.31)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

! BEMÆRK/VIGTIGT!

Sørg for, at der er nok plads under (B) til, at kørestolen kan køre over forhindringer.

Knævinkel (Fig. 4.32)

1. Løsn (A) ved at dreje to omgange.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

! BEMÆRK/VIGTIGT!





Højden eller knævinklen ændres, hvis fodpladen berører svinghjulene.

Ankelvinkel (Fig. 4.33)

1. Slå (A) op.
2. Drej (B) for at justere ankelvinklen som ønsket.
3. Slå (A) ned.

Midterstillet lægstøttehøjde (Fig. 4.34)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

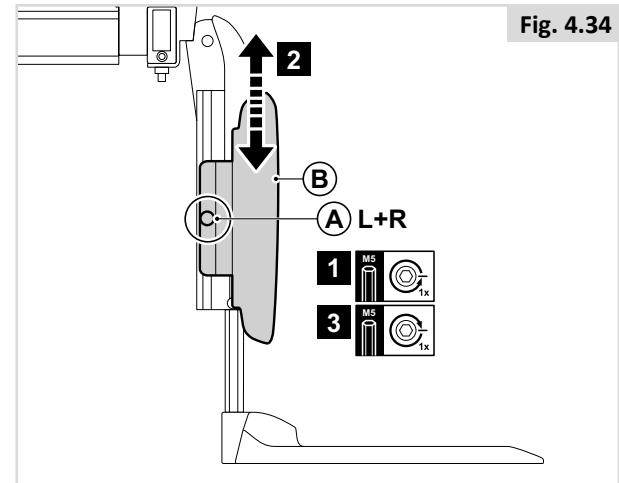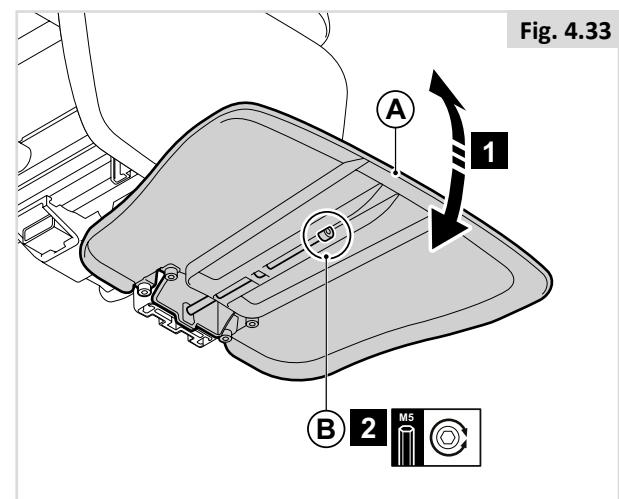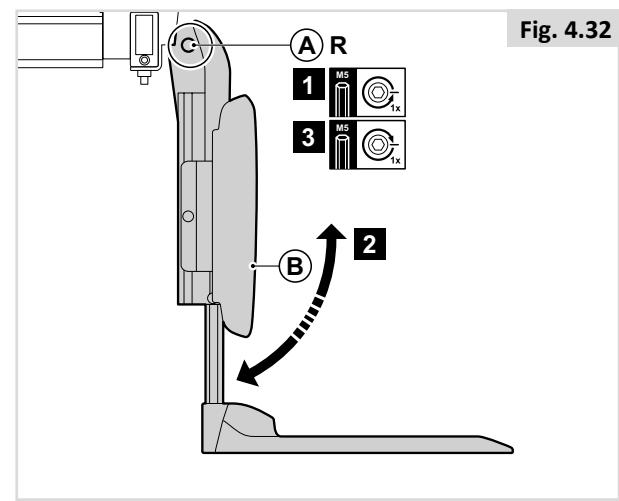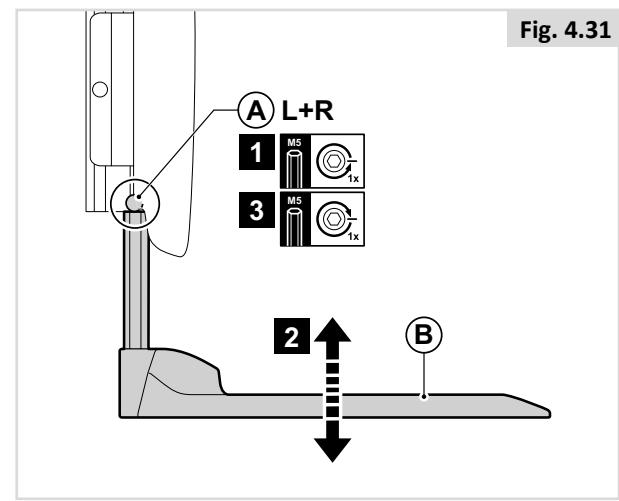

4.9 Forudindstil den faste, midtermonterede benstøtte

Underbenslængde (Fig. 4.35)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A)
4. Gentag denne procedure for den anden side.

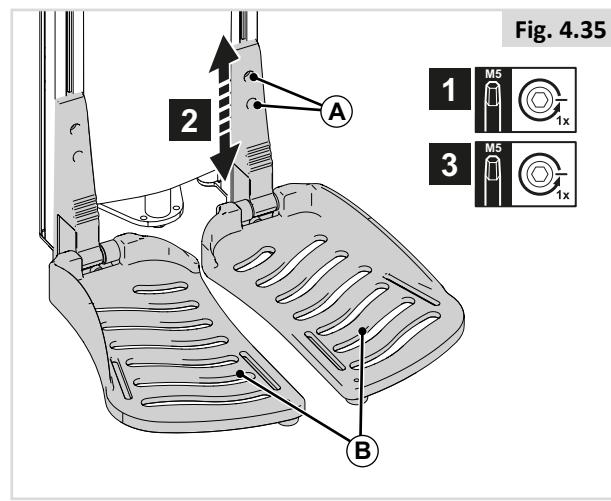


Fig. 4.35

Ankelvinkel (Fig. 4.36)

1. Slå (A) op.
2. Drej (B) for at justere ankelvinklen som ønsket (4 mm unbrakonøgle)
3. Slå (A) ned.

⚠ RISIKO/ADVARSEL!

- Efter justering og med sædet i dets normale køreposition: Sørg for, at der til enhver tid er et mellemrum på >25 mm mellem gulvet og fodpladen.
- Udfør denne test med brugeren siddende i stolen med vægt på benstøtten
- Hvis benstøtten er indstillet for lavt, kan anvendelse af kørestolen føre til personskade eller beskadigelse af kørestolen og dens omgivelser.

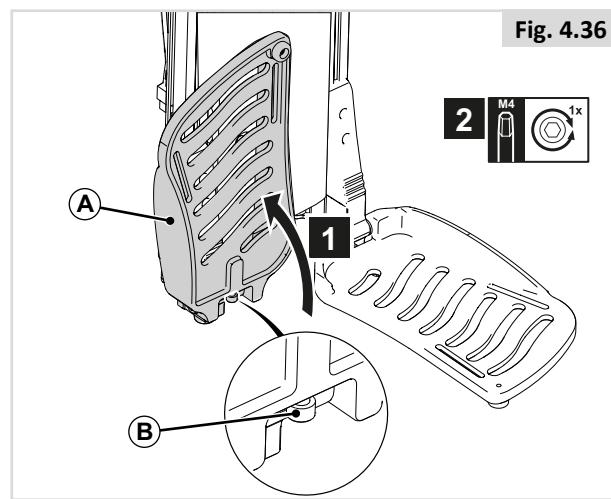


Fig. 4.36

Lægpudehøjde (Fig. 4.37)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (C) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Lægpudebredde (Fig. 4.37)

4. Løsn (B) ved at dreje én omgang.
5. Justér (C) til den ønskede position.
6. Spænd (B).

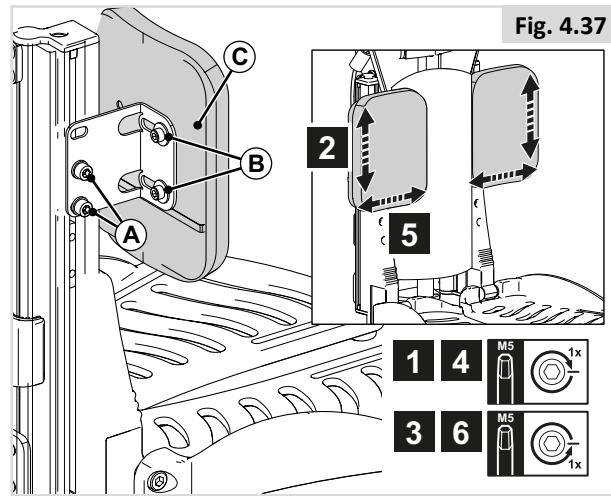


Fig. 4.37

4.10 Forudindstillet, midtermonteret, elektrisk benstøtte

RISIKO/ADVARSEL!

- Vær særligt opmærksom på dine omgivelser, så dine ben ikke kommer til skade, når benstøtterne er forlænget.
- Sørg altid for, at benstøtter eller fodplader ikke kan komme i kontakt med svinghjulene, før du begynder at køre med kørestolen.
- Fodstøtterne må under ingen omstændigheder bruges til at løfte eller bære kørestolen.
- Som med alle bevægelige dele, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, (Fig. 4.40).

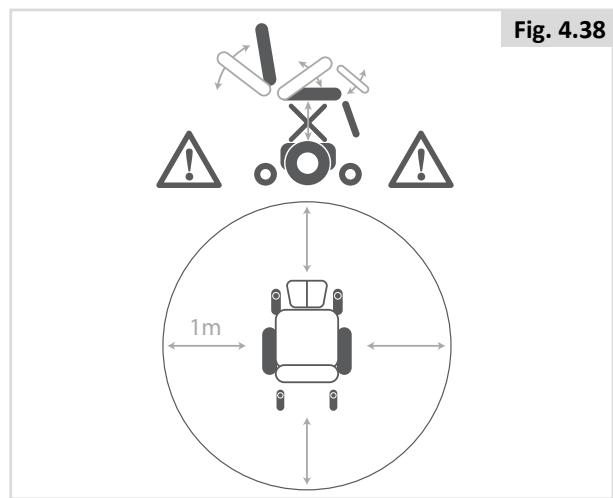


Fig. 4.38

Underbenslængde (Fig. 4.39)

Den midtermonterede, elektriske benstøtte kan justeres i en vinkel fra 90° til 180° i forhold til jorden og har en 180 mm elektrisk forlængelsesdel.

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).
4. Gentag denne procedure for den anden side.

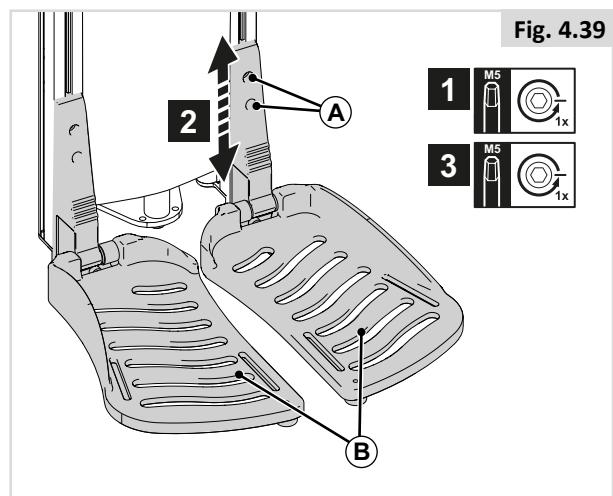


Fig. 4.39

Ankelvinkel (Fig. 4.40)

1. Slå (A) op.
2. Drej (B) for at justere ankelvinklen som ønsket (4 mm unbrakonøgle)
3. Slå (A) ned.

RISIKO/ADVARSEL!

- Efter justering og med sædet i dets normale køreposition: Sørg for, at der til enhver tid er et mellemrum på >25 mm mellem gulvet og fodpladen.
- Udfør denne test med brugeren sidende i stolen med vægt på benstøtten
- Hvis benstøtten er indstillet for lavt, kan anvendelse af kørestolen føre til personskade eller beskadigelse af kørestolen og dens omgivelser.

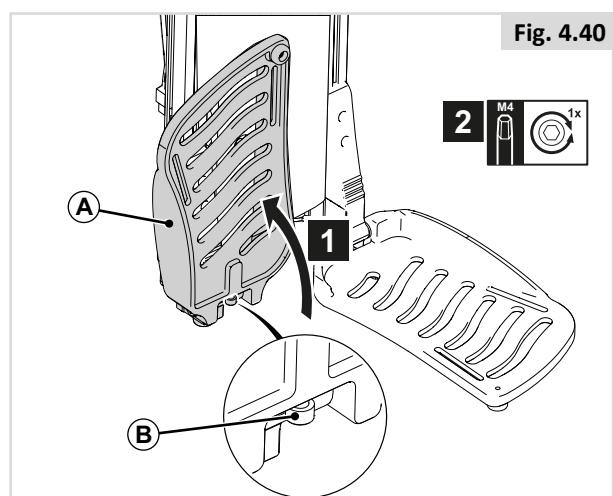


Fig. 4.40

Lægpudehøjde (Fig. 4.41)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (C) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Lægpudebredde (Fig. 4.41)

4. Løsn (B) ved at dreje én omgang.
5. Justér (C) til den ønskede position.
6. Spænd (B).

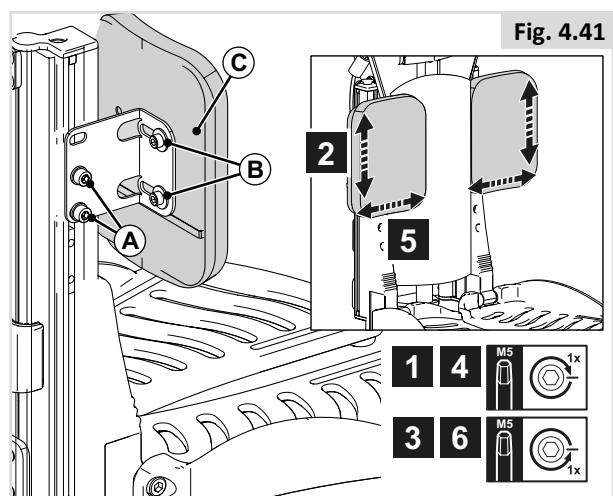


Fig. 4.41

4.11 Forudindstillede SEDEO LITE svingbare benstøtter

Benstøttebrede (Fig. 4.42)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Underbenslængde (Fig. 4.43)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

BEMÆRK/VIGTIGT!

- Sørg for, at der er nok plads under (B) til, at kørestolen kan køre over forhindringer.

Ankelvinkel (Fig. 4.44)

1. Løsn (A) nogle få omgange.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

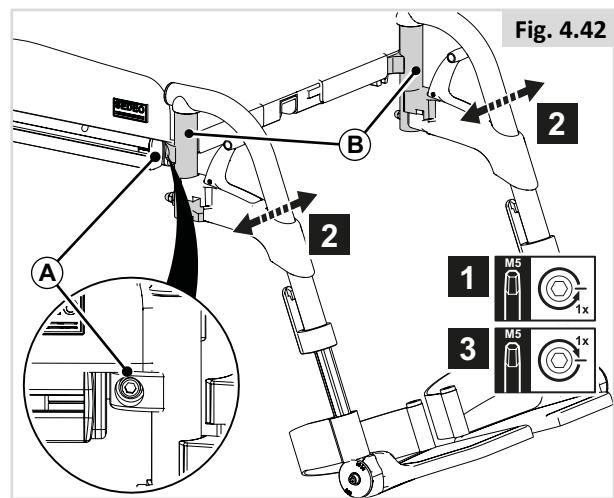


Fig. 4.42

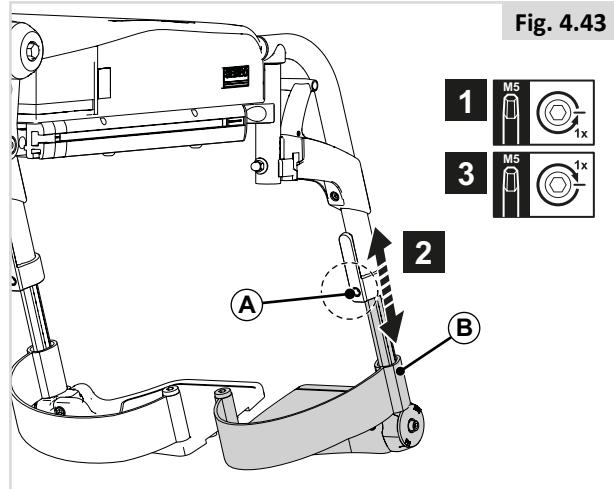


Fig. 4.43

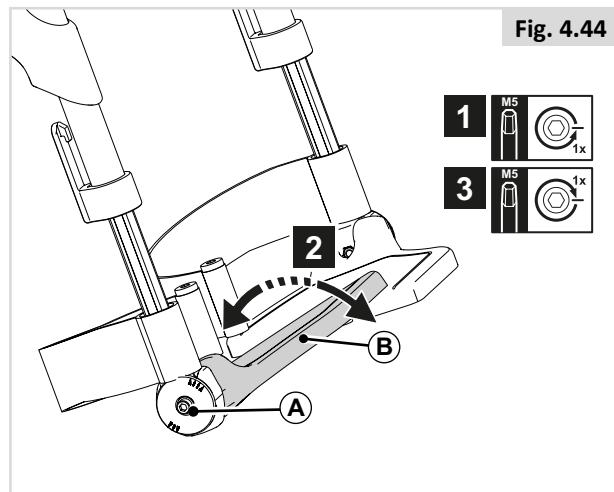


Fig. 4.44

4.12 Forudindstillet UNI svingbar benstøtte

Benstøttebrede (Fig. 4.42)

Underbenslængde (Fig. 4.45)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

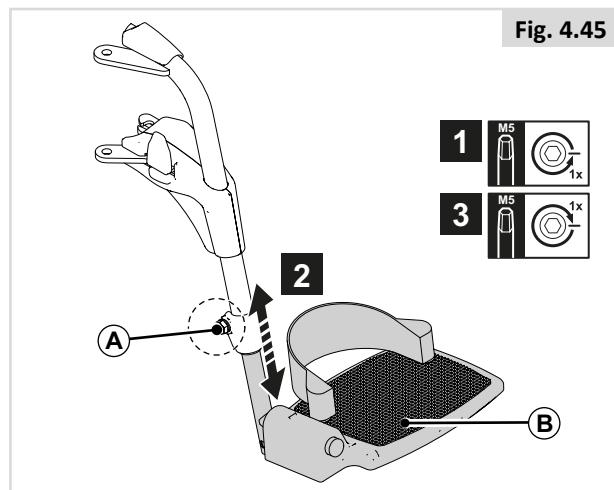


Fig. 4.45

4.13 Forudindstillede svingbare benstøtter

Benstøttebrede (Fig. 4.46)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Underbenslængde (Fig. 4.47)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

⚠ BEMÆRK/VIGTIGT!

Sørg for, at der er nok plads under (B) til, at kørestolen kan køre over forhindringer.

Ankelvinkel (Fig. 4.48)

1. Løsn (A) nogle få omgange.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Manuel/elektrisk eleverbar benstøtte vha. knævinkel (Fig. 4.49)

Fodpladernes position kan ændres vha. knævinklen

1. Løsn (A) nogle få omgange.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

⚠ RISIKO/ADVARSEL!

- Pas på fingrene! Når benstøtten flyttes op eller ned, skal hænderne holdes fri af justeringsmekanismen mellem fodstøttens bevægelige dele.

⚠ BEMÆRK/VIGTIGT!

Højden eller knævinklen ændres, hvis fodpladen berører svinghjulene.

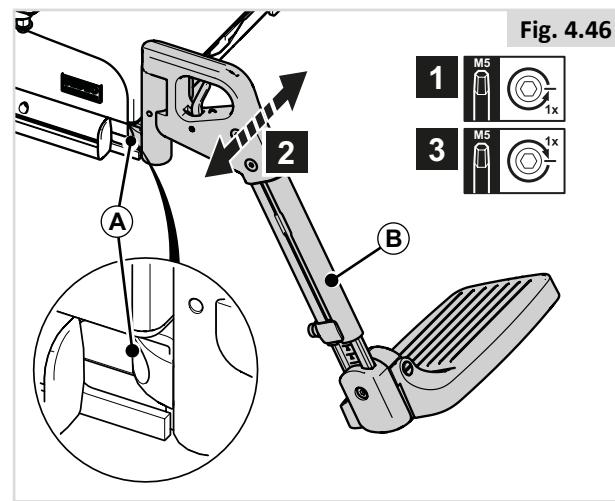


Fig. 4.46

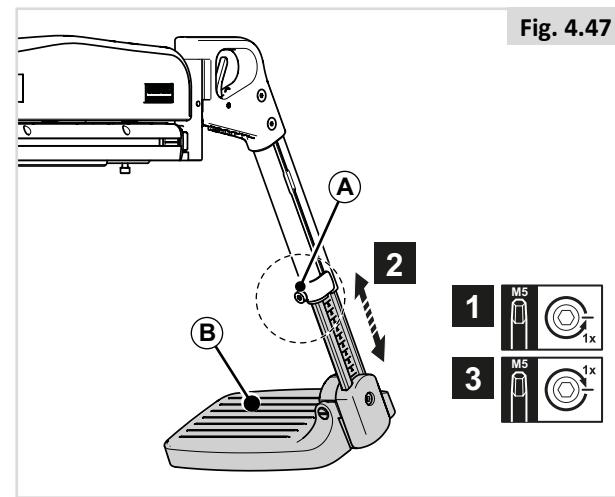


Fig. 4.47

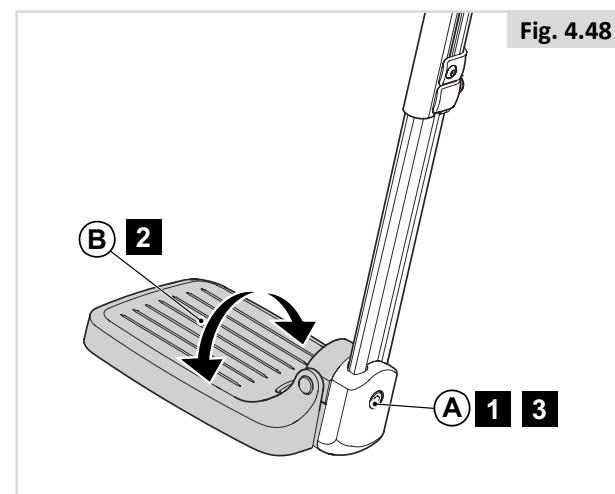


Fig. 4.48

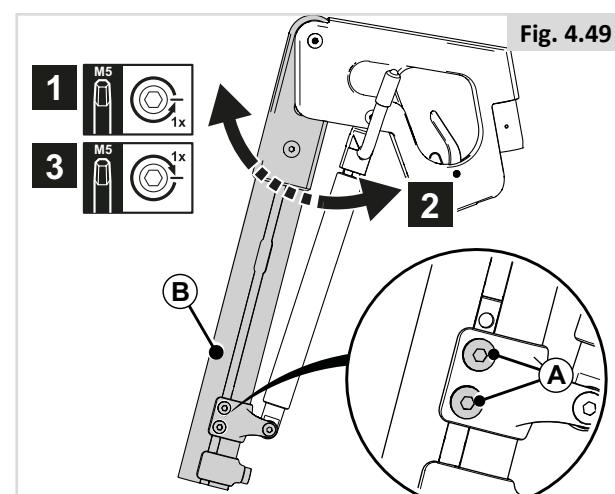


Fig. 4.49

Lægpudehøjde (Fig. 4.50)


1. Løsn (A) nøgle få omgange.
2. Justér (D) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Lægpudedybde (Fig. 4.50)

4. Løsn (B) nøgle få omgange
5. Justér (D) til den ønskede position.
6. Spænd (B).

Lægpudebredde (Fig. 4.50)

7. Løsn (C) bag på (D) nøgle få omgange.
8. Justér (D) til den ønskede position.
9. Spænd (C).

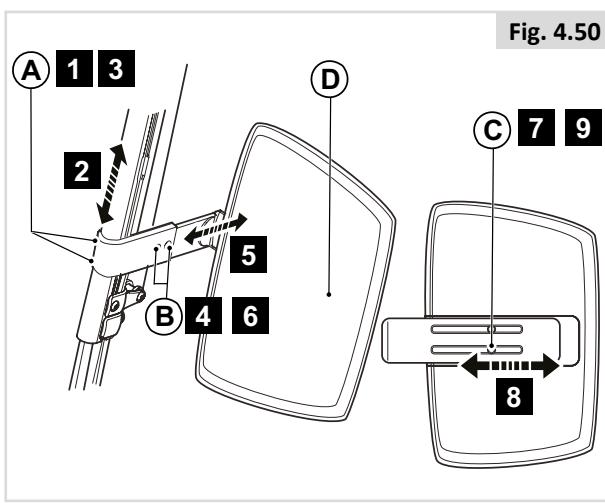


4.14 Forudindstillet hovedstøtte

⚠️ RISIKO/ADVARSEL!

- Hvis en hovedstøtte er en del af en påkrævet specifik konfiguration til brugeren/stolen, må stolen aldrig køres uden en monteret hovedstøtte.
- Stolen må aldrig bruges uden en hovedstøtte, hvis en person bliver transporteret med stolen i et køretøj.


Hovedstøttehøjde (Fig. 4.51)

1. Løsn (A) nøgle få omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

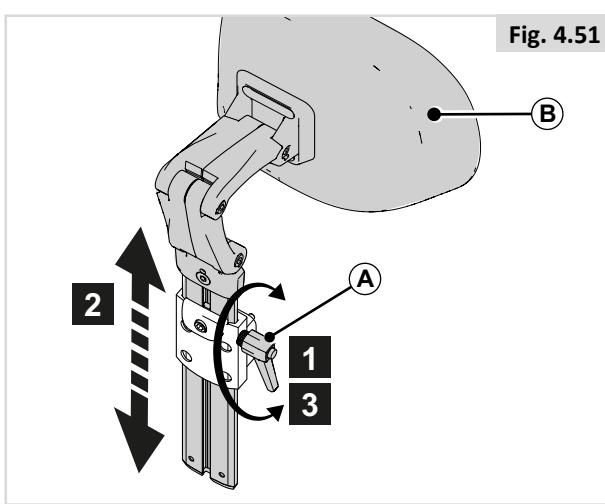

Hukommelsesindstilling (Fig. 4.52)

1. Løsn (C) ved at dreje én omgang.
2. Skub (D) så langt ned som muligt.
3. Spænd (C).

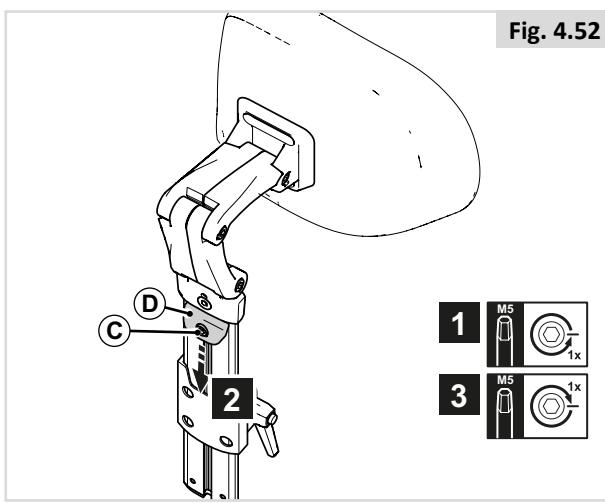


Hovedstøtteposition (Fig. 4.53)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

⚠️ BEMÆRK/VIGTIGT!

Ret hovedstøttehøjden, og vip hovedstøttepuden efter behov.

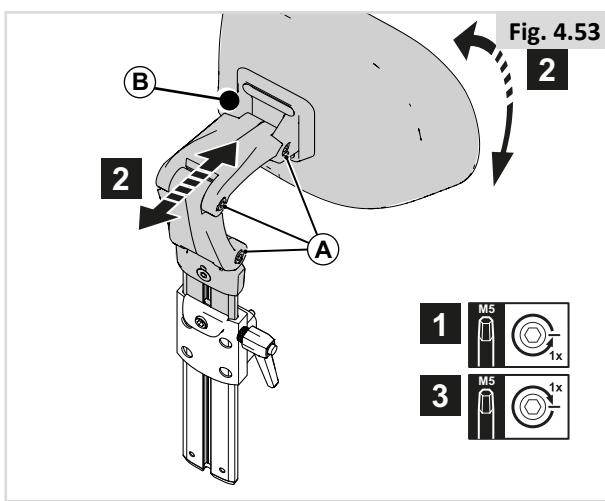

Hovedstøttens pudebreddeposition (Fig. 4.54)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

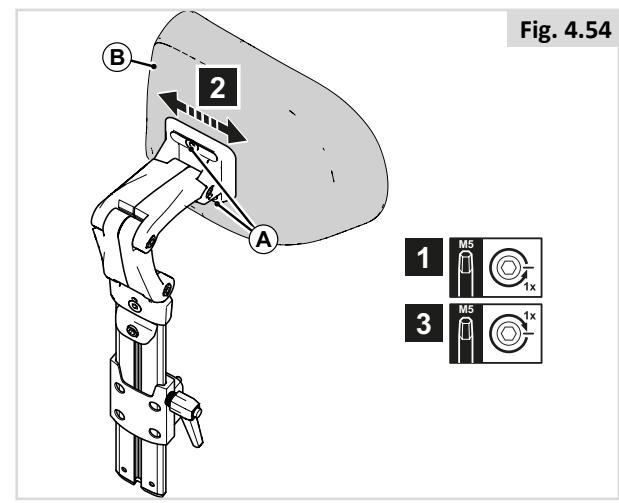


Fig. 4.54

4.15 Forudindstillet fast beslag/svingbart beslag til betjeningsenhed**Dybde på betjeningsenhed (Fig. 4.55)**

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Højde på betjeningsenhed (1) (Fig. 4.56)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

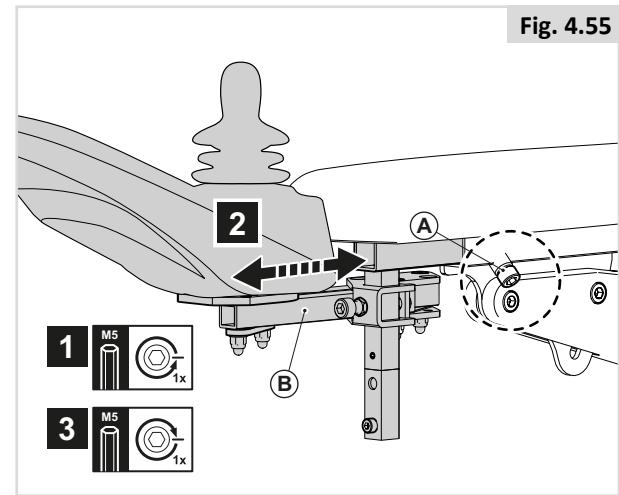


Fig. 4.55

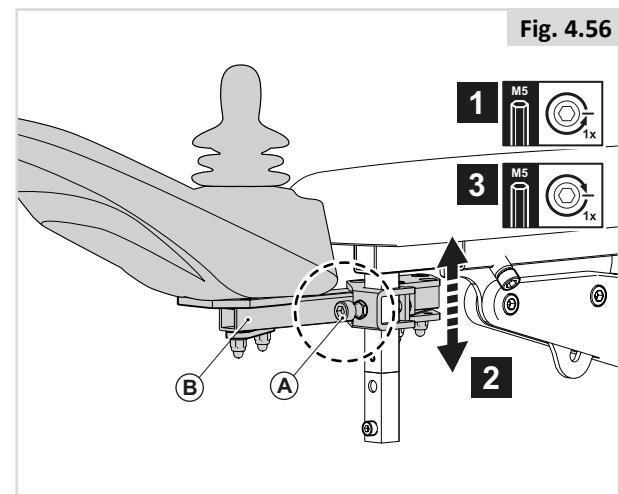


Fig. 4.56

4.16 Forudindstillet svingbart beslag til betjeningsenhed

Fig. 4.57

Dybde på betjeningsenhed (Fig. 4.57)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Højde på betjeningsenhed (1) (Fig. 4.58)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Højde på betjeningsenhed (2) (Fig. 4.59)

1. Løsn (C) ved at dreje én omgang.
2. Justér (D) til den ønskede position.
3. Spænd (C).

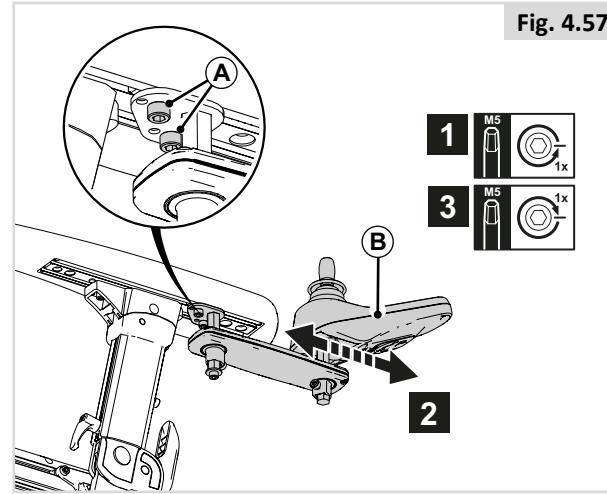


Fig. 4.58


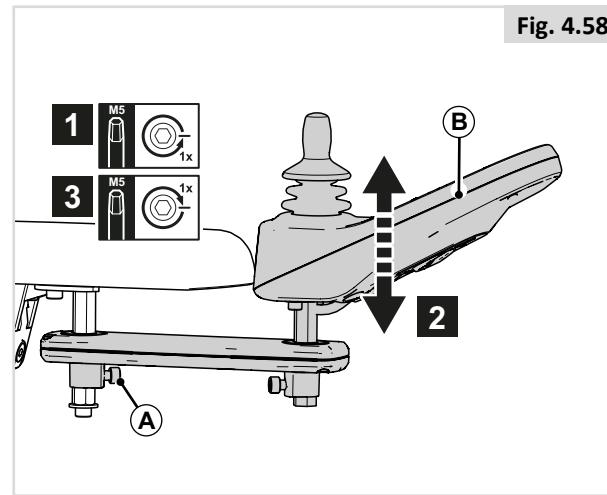


Fig. 4.59

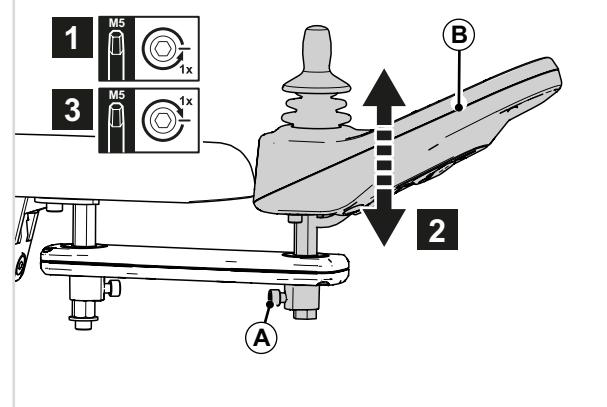

4.17 Forudindstillet sidestøtte tilbehør

Sidestøtte højde (Fig. 4.60)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Sidestøtte bredde (Fig. 4.61)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).
4. Løsn (C) ved at dreje én omgang
5. Justér (B) til den ønskede position.
6. Spænd (C).

Sidestøtte vinkel (Fig. 4.62)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).
4. Løsn (C) ved at dreje én omgang
5. Justér (B) til den ønskede position.
6. Spænd (C).

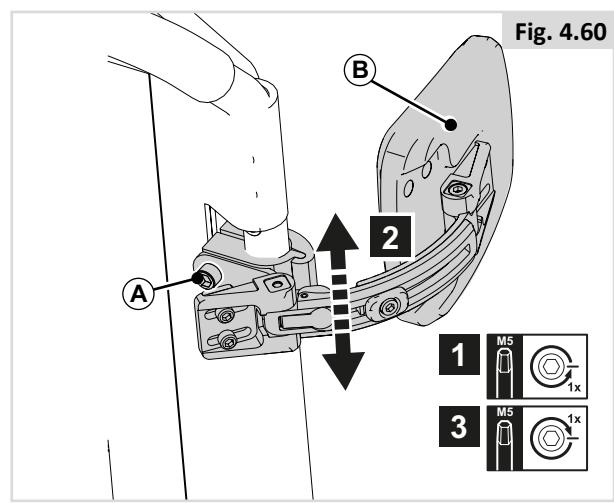


Fig. 4.60

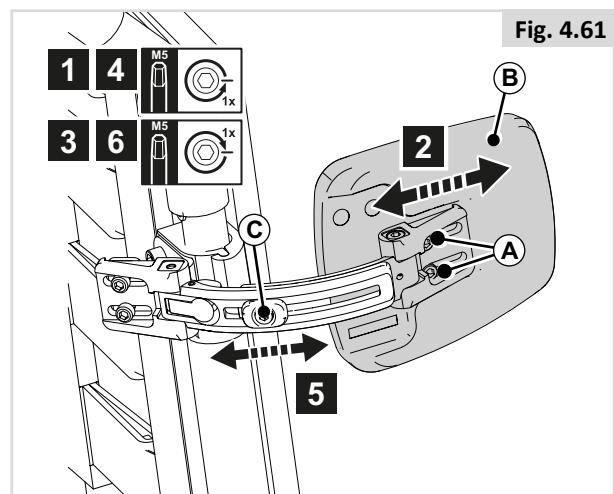


Fig. 4.61

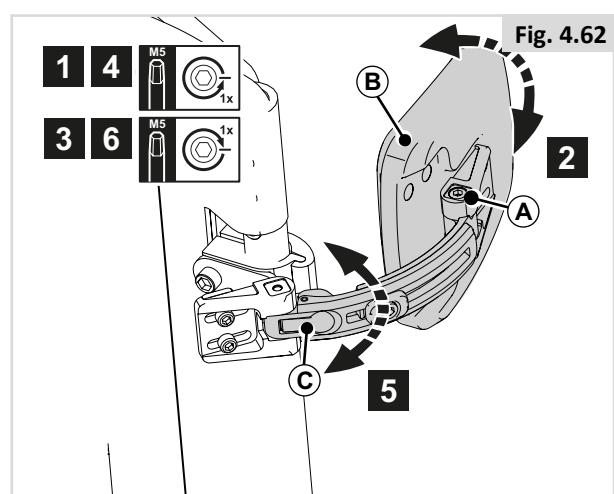


Fig. 4.62

4.18 Forudindstillet lateral svingbar knæ-/lårstøtte

Støtten kan monteres i to positioner, som knæstøtte eller som lårstøtte (Fig. 4.63)

Lårstøtteposition (Fig. 4.63 og 4.64)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

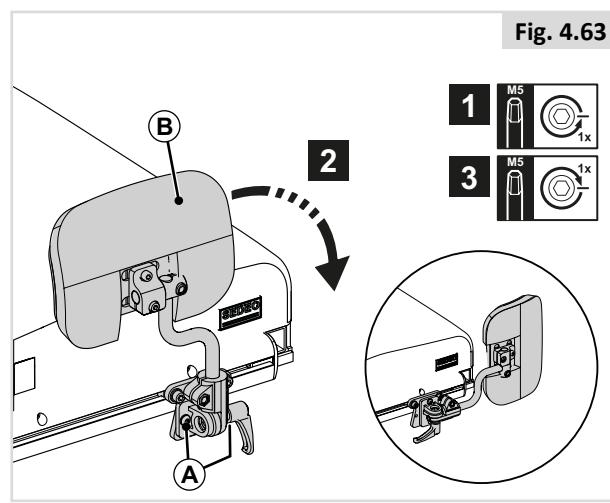


Fig. 4.63

4.19 Forudindstillet abduktionskile (pommel)

Abduktionskile højde (Fig. 4.65)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

Abduktionskile dybde (Fig. 4.66)

1. Løsn (A) ved at dreje én omgang.
2. Justér (B) til den ønskede position.
3. Spænd (A).

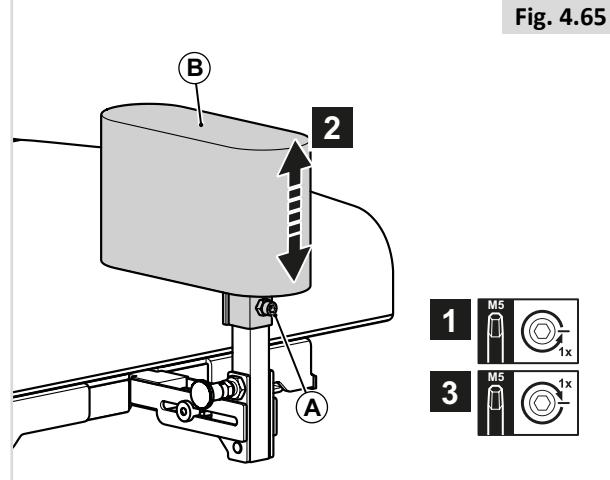


Fig. 4.65

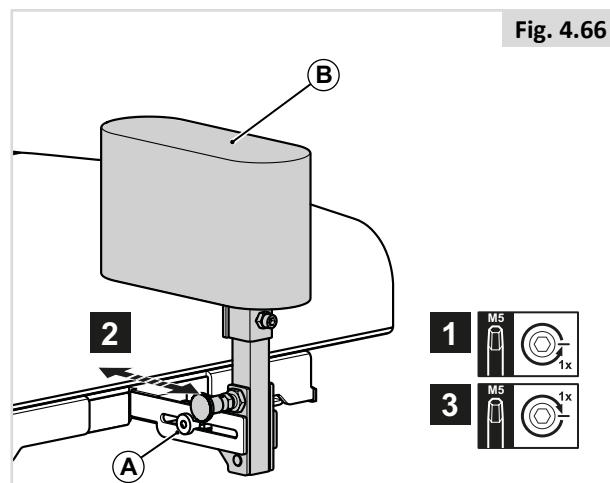


Fig. 4.66

4.20 Hoftesele / siddepositioneringssele

Fig. 4.67

! RISIKO/ADVARSEL!

- Dette produkt må kun bruges til at positionere en enkelt person i en kørestol.
- Hofteseler egner sig ikke til transportformål, og der skal anvendes godkendte passagerfastspændingssystemer.
- Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige skader eller død.
- Sørg for, at plejeren eller ledsageren er trænet i korrekt betjening af selerne.
- Plejere eller ledsagere uden korrekt træning kan medføre forsinkelser, hvis der opstår en nødsituation.

Montering af en hoftesele/siddepositioneringssele

1. Fastgør (A) til sæderammen med en skrue på hver side. (Fig. 4.68)

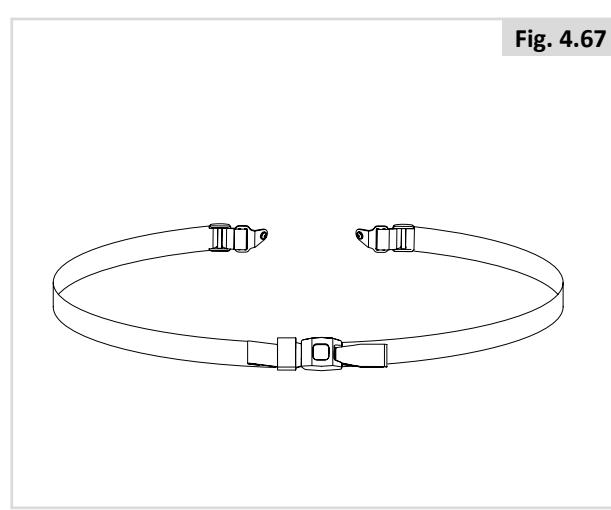


Fig. 4.67

Positionering af en person med hoftesele

- Hofteselen justeres efter behov, men for at opnå maksimal komfort og sikkerhed må der højst være plads til at føre en flad hånd ind mellem selen og kroppen, (Fig. 4.69).
- Håndens frihøjde skal være med hofteselen under den normale spænding, og der må ikke være store afstande eller løkker.
- Generelt bør hofteselen være monteret sådan, at remmene sidder i en vinkel på ca. 45° i forhold til sædet (Fig. 4.70), og når selen er justeret korrekt, bør det ikke være muligt for brugeren at glide ned i sædet.
- Selen lægges løst hen over sædet, så spændets åbningsdel vender mod højre, hvis brugeren er højrehåndet, og mod venstre, hvis brugeren er venstrehåndet. Før selens andre ender gennem åbningen mellem ryglænets rør og ryglænet.

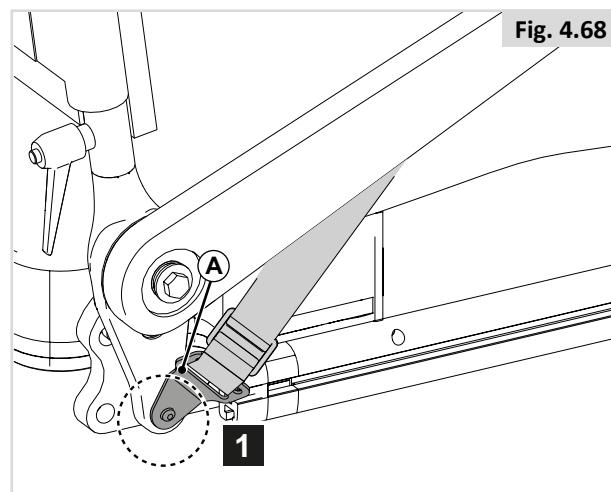


Fig. 4.68

! RISIKO/ADVARSEL!

- Sørg altid for, at hofteselen er forsvarligt fastspændt og justeret korrekt inden brug.
- Hvis selen er for løs, kan det få brugeren til at glide ned, og dette kan forårsage alvorlige personskader.
- Hofteselen og fastspændingsanordningerne skal efterset grundigt med jævne mellemrum for tegn på slid eller skader. Udskift i givet fald de slidte eller beskadigede dele.
- Ved serviceeftersyn skal det kontrolleres, om spændet kan åbnes og lukkes korrekt, og stof samt plastbeslag skal efterset grundigt for tegn på slitage.
- Regelmæssige kontroller/aktiviteter:
- Som med alle placéringskomponenter er der behov for korrigende justeringer, efterhånden som brugeren ændrer sin siddeposition.
- Kontroller selerne regelmæssigt for korrekt montering for at sikre brugerens sikkerhed og bekvemmelighed.

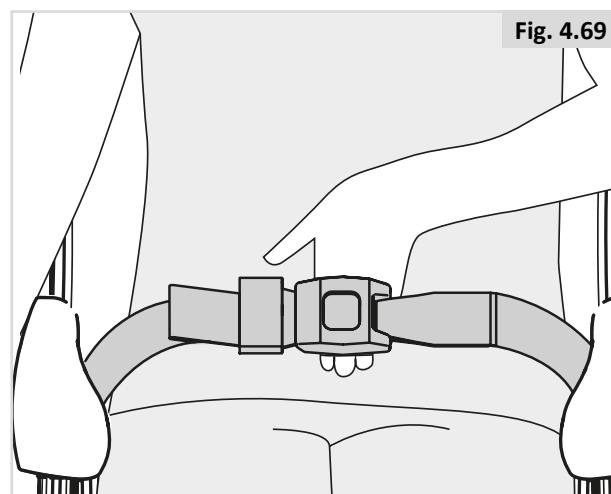


Fig. 4.69

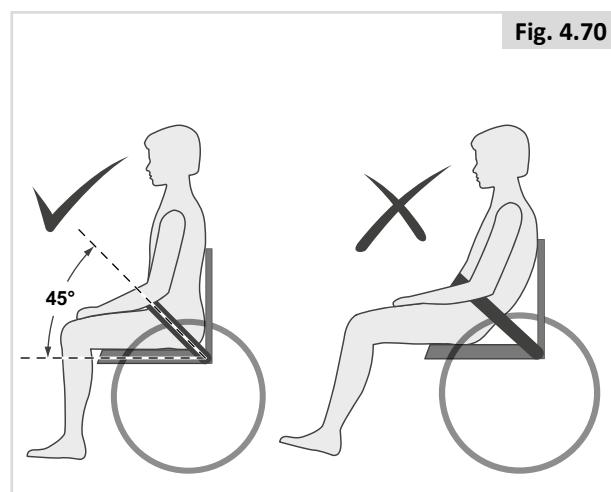


Fig. 4.70

5.0 Anvendelse af siddesystemet

5.1 Sådan kommer du ind og ud af kørestolen (Forflytning)

Sunrise Medical anbefaler, at du kontakter din behandler for at få vejledning i, hvordan du kan stige forlæns og sidelæns ind og ud af kørestolen på en måde, der passer bedst til dine behov, så du undgår risiko for personskader.

RISIKO/ADVARSEL!

Sådan undgår du fald:

- Sørg for, at betjeningsenheden er slået fra ved forflytninger til og fra kørestolen for at forhindre, at kørestolen begynder at køre, inden du er klar. Hvis ikke det er gjort, kan du komme til at røre ved joysticket og få dit system til at flytte sig, når du mindst venter det.
- Sørg for, at frihulsknappen er blevet indstillet til 'kørsel' Generel manual.
- Drej de forreste svinghjul, således at de peger fremad.
- Arbejd sammen med sundhedspersonalet for at lære om alle de sikre måder at foretage forflytninger på.
- Sørg for, at motorbremserne er aktiverede. Dette forhindrer systemet i at bevæge sig i forbindelse med forflytning.
- Det er farligt at foretage forflytninger på egen hånd. Det kræver god balance og smidighed. Vær opmærksom på, at der er et tidspunkt under forflytningen, hvor sædet ikke er under dig.
- Lær, hvordan du anbringer din krop, og hvordan du støtter dig selv under en forflytning.
- Få nogen til at hjælpe dig, indtil du er sikker på, at du selv kan foretage en sikker forflytning.
- Stå ikke på fodstøtten. Hvis du anbringer din fulde vægt på fodstøtten, kan det beskadige kørestolen eller resultere i farlige situationer, herunder at kørestolen vipper.
- Sørg for, at dine fødder ikke sætter sig fast i området mellem fodstøtterne.

5.2 Sådan gør du dig klar til en fremadrettet forflytning

RISIKO/ADVARSEL!

Flyt din kørestol så tæt som muligt på det sæde, du har til hensigt at flytte hen på.

Svingbare benstøtter (Fig. 5.1 og 5.2)

1. Slå fodstøtterne op (A)
 2. Sving lægpladerne (B) til siden (hvis relevant)
- SEDEO LITE SVINGBARE BENSTØTTER
3. Om muligt skubbes (C) bagud og svingbenstøtterne (D) til siden
- UNI SVINGBARE BENSTØTTER
4. Om muligt skubbes (C) bagud og svingbenstøtterne (D) til siden
- SEDEO PRO SVINGBARE BENSTØTTER
5. Om muligt skubbes (C) bagud og svingbenstøtterne (D) til siden

Midtermonteret benstøtte (Fig. 5.3)

1. Slå (A) op.

Elektrisk, midtermonteret benstøtte (Fig. 5.4)

1. Slå (A) op 2x.

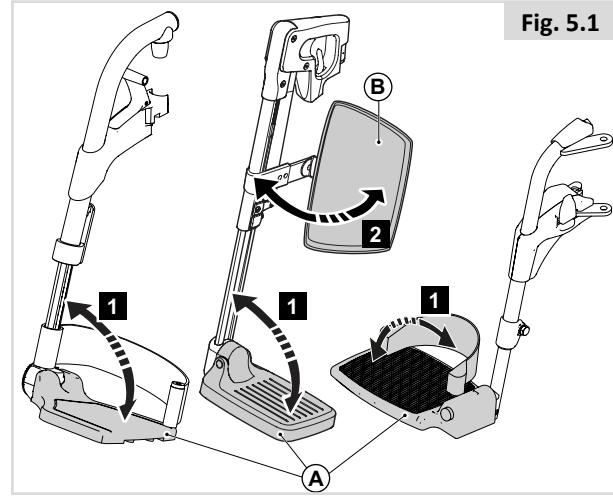


Fig. 5.1

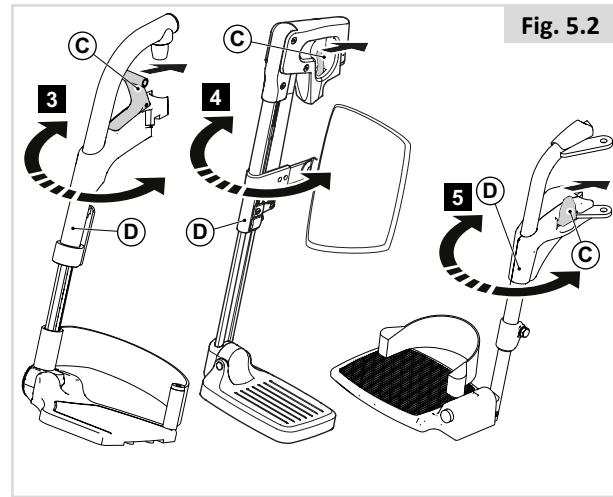


Fig. 5.2

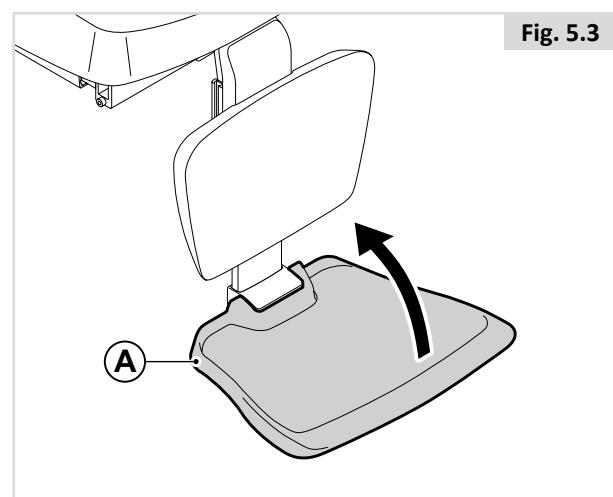


Fig. 5.3

5.3 Sådan gør du dig klar til en sidelæns forflytning


RISIKO/ADVARSEL!

- Flyt systemet så tæt du kan til det sæde, du forflytter til. Om muligt kan du anvende et transferbræt.
- Flyt dig så langt tilbage på sædet, som du kan. Dette vil reducere risikoen for, at du ikke kommer over på sædet og/eller falder.

BEMÆRK/VIGTIGT!

- Visse versioner af kontrollenheden skal svinges til side.
- Fjern bakken, før du slår armlænet op.
- Du må ikke læne dig på armlænet, når det er klappet bagud.

Fig. 5.4

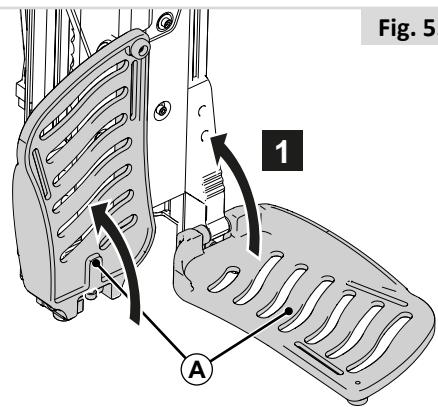

Slå armlænet op (Fig. 5.5)

- Slå (A) bagud.

Sedeo Lite single-post armlæn (Fig. 5.6)

- Løsn A.
- Fjern B

Single-post flip-back armlæn (Fig. 5.7)

- Tryk på (A).
- Slå (B) bagud.

Fig. 5.5

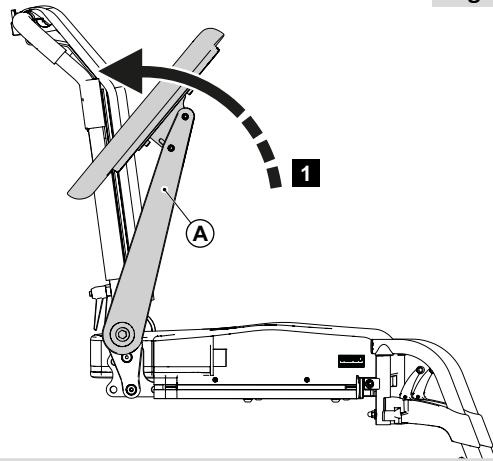


Fig. 5.6


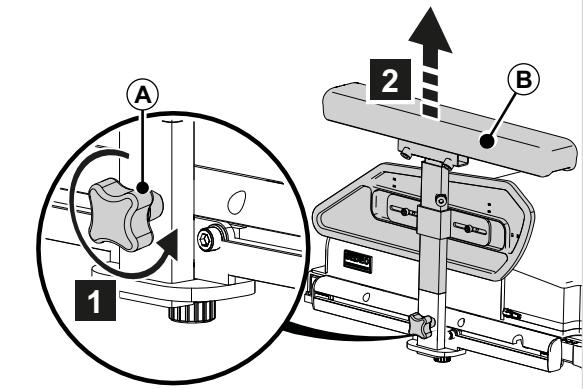


Fig. 5.7

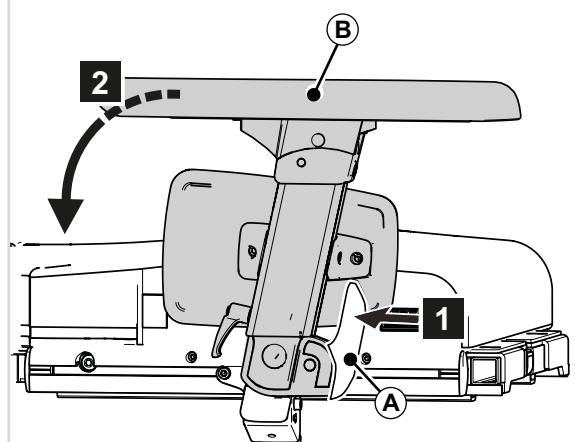

5.4 Hovedstøtte

Aftagning/placering af hovedstøtten (Fig. 5.8)

1. Løft (A).
2. Skub (B) ud af eller ind i (C).
3. Skub (A) ned.

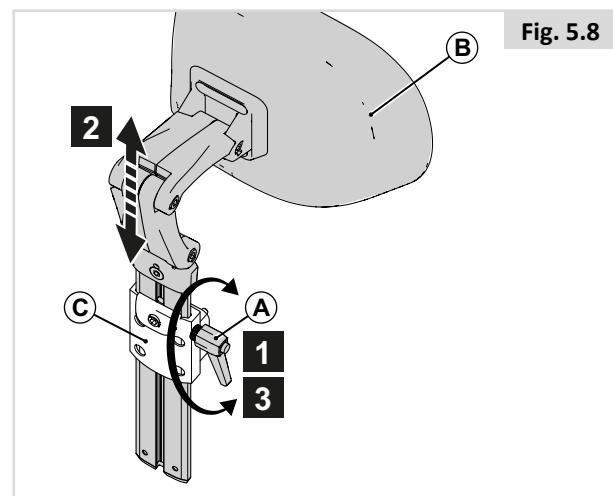


Fig. 5.8

5.5 Betjeningsenhedens svingbeslag

Sving betjeningsenhedens beslag væk (Fig. 5.9).

Joysticket er monteret med en mekanisme, der gør det muligt at låse det i to fremadrettede positioner.

1. Skub (A) udad eller indad.
2. Joysticket føres tilbage i den fremadrettede position ved at skubbe det bagfra og fremad, indtil det låser på plads (klik)

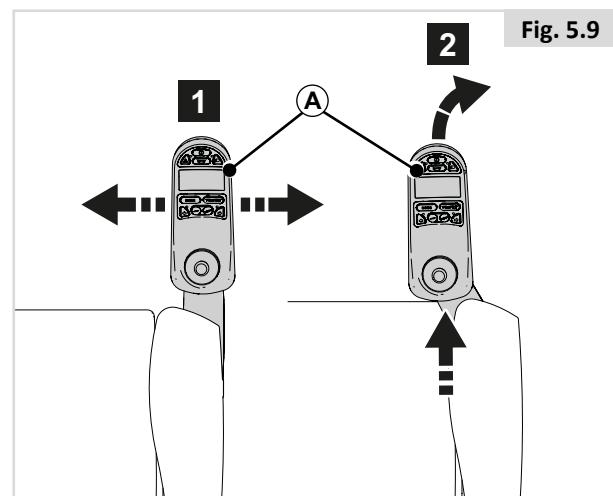


Fig. 5.9

Swing betjeningsenhedens beslag væk (Fig. 5.10).

1. Skub (A) udad.
2. Joysticket føres tilbage i den fremadrettede position ved at skubbe det bagfra og fremad, indtil det låser på plads (klik)

! BEMÆRK/VIGTIGT!

Når betjeningsenhedens beslag svinges bagud, vil du kunne køre helt ind til et bord. Det er stadig muligt at betjene betjeningsenheden fuldt ud.

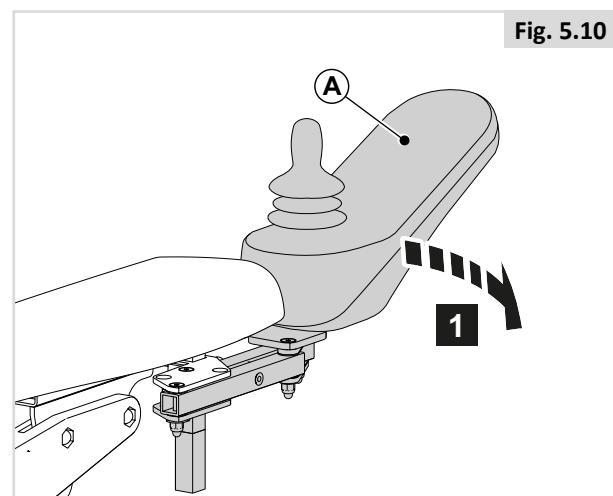


Fig. 5.10

5.6 Sidestøtte (Fig. 5.11)

1. Tryk på A for at svinge B væk

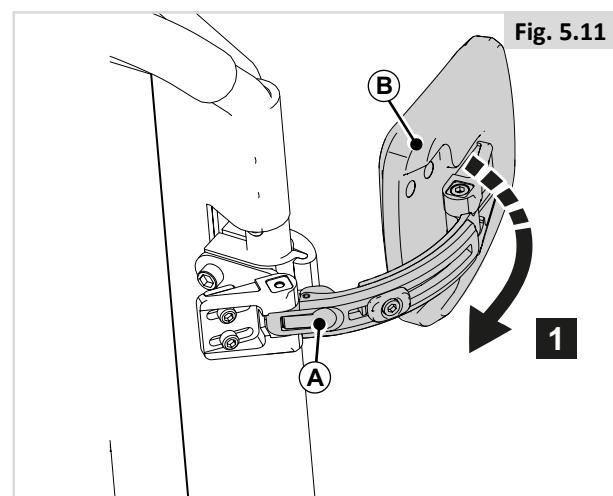


Fig. 5.11

5.7 Knæstøtte/Lårstøtte (Fig. 5.12)

1. Løsn A for at svinge B væk

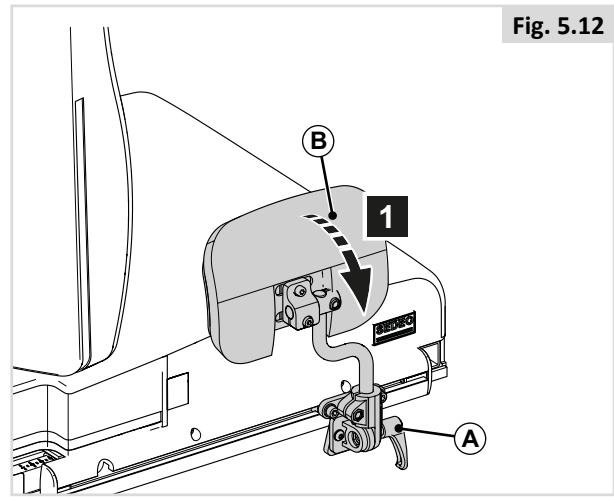


Fig. 5.12

5.8 Hemiplegi-armlæn (Fig. 5.13)

1. Træk (A) ud af den låste position, og drej (B) til den ønskede position.



Sørg for, at (B) sidder forsvarligt fast!

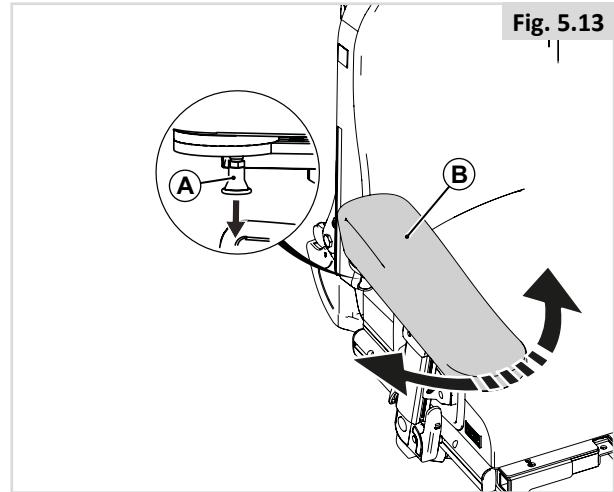


Fig. 5.13

5.9 Abduktionskile (Fig. 5.14)

Slå abduktionskilen ned

1. Træk (A) ud af den låste position.
2. Rand ned (B)
3. Giv slip (A).

Slå abduktionskilen op

1. Træk (A) ud af den låste position.
2. Rand op (B).
3. Giv slip på (A) i den låste position.



Sørg for, at (B) sidder forsvarligt fast!

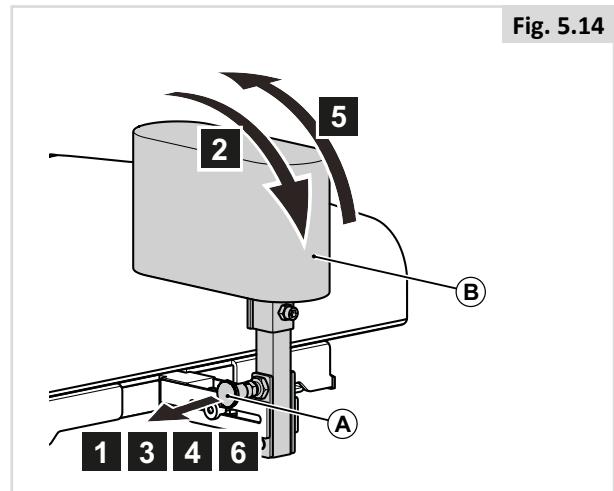


Fig. 5.14

6.0 Manuelle og elektriske sædefunktioner

6.1 Manuelle sædefunktioner

Indstil ryglænet manuelt (af hjælper) (Fig. 6.1)

1. Tryk ind (A).
2. Træk stangen fremad eller tilbage for at justere (B) til den ønskede stilling.



Bliv ved med at klemme (A) ind.

3. Giv slip (A).

Hæv benstøtternes knævinkel på Sledo Lite manuelt (Fig. 6.2)

Vinklen på komfort-benstøtterne kan justeres uafhængigt af hinanden.

1. Drej (A).
2. Løft benet.
3. Giv slip på håndtaget, når den ønskede position er nået.



- Pas på fingrene! Når benstøtten flyttes op eller ned, skal hænderne holdes fri af justeringsmekanismen mellem fodstøttens bevægelige dele.

Manuelt løft af benstøtternes knævinkel (Fig. 6.3)

Vinklen på komfort-benstøtterne kan justeres uafhængigt af hinanden.

1. Tryk håndtag (A) fremad.
2. Løft benet.
3. Giv slip på håndtaget, når den ønskede position er nået.



- Pas på fingrene! Når benstøtten flyttes op eller ned, skal hænderne holdes fri af justeringsmekanismen mellem fodstøttens bevægelige dele.

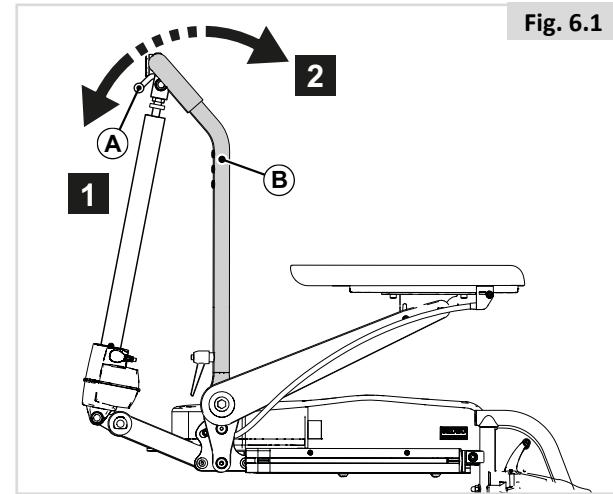


Fig. 6.1

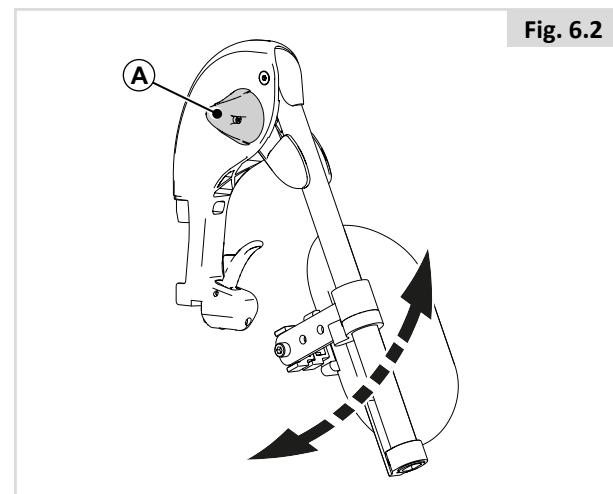


Fig. 6.2

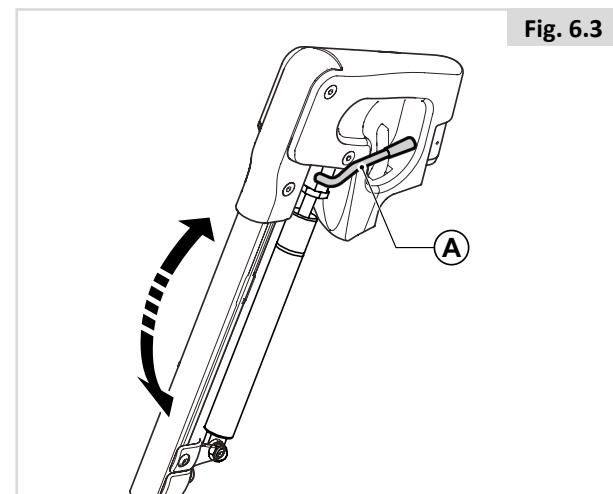


Fig. 6.3

6.2 (Elektriske) sædefunktioner

Kørestolen kan udstyres med de følgende elektriske siddeindstillinger. Disse indstillinger kan foretages af brugeren uden brug af værktøj.

Elektrisk justerbare sædeindstillinger (Fig. 6.4 - Fig. 6.6)

Læs, hvordan du betjener disse elektriske siddeindstillinger i BETJENINGSENHED:

1. Elektrisk vippefunktion
2. Elektrisk sædeløft
3. Elektrisk tilbagelæning af ryglæn
4. Elektriskleverbare benstøtter

RISIKO/ADVARSEL!

- Brugen af de elektrisk justerbare siddeindstillinger kan påvirke kørestolens stabilitet.
- Anvend kun de elektrisk justerbare siddeindstillinger, når kørestolen befinner sig på en plan overflade! Forsøg ikke at betjene de elektriske indstillinger, når du befinner dig på en hældning.
- Venligst hold dig væk fra elektriske aktivatorer, når de er i bevægelse. Elektriske kørestole fra Sunrise yder bevægelsesfrihed over et stort område. Brugere skal være bevidste om deres omgivelser, når komponenter er i bevægelse.
- Vær forsiktig, når du kører dette sædesystem i en tilbagelænet, hævet eller tiltet position.
- Forsøg ikke at betjene de elektriske sædefunktioner, mens kørestolen er i bevægelse.
- Forsøg ikke at betjene sædets hæve/sænke og tiltfunktioner i nærheden af børn.
- Via programmering er det muligt at tilbageføre alle elektriske siddeindstillinger. Sørg for, at du er klar over, hvilken retning, dit sæde vil bevæge sig, før du starter.
- Venligst vær opmærksom på at løft- og tiltfunktionerne udgør en risiko for fastklemning. For at forhindre skader, skal du under betjeningen af løft- og tiltfunktionerne sørge for, at stolen ikke kommer i berøring med tøj, hænder, fodder og andre legemsdele.
- Kør ikke på ramper eller skråninger med sædet i hævet position. Før du forsøger at køre op eller ned ad en skråning, skal kørestolen igen indstilles til en siddende standard-køreposition med opretstående ryglæn.

Dette elektriske system er designet til automatisk at reducere den maksimale kørselshastighed til sikkerhedstilstand, når visse elektriske sædegrænser er nået. Afhængig af kørestolens konfiguration kan der være flere sikkerhedstilstande.

Fig. 6.4



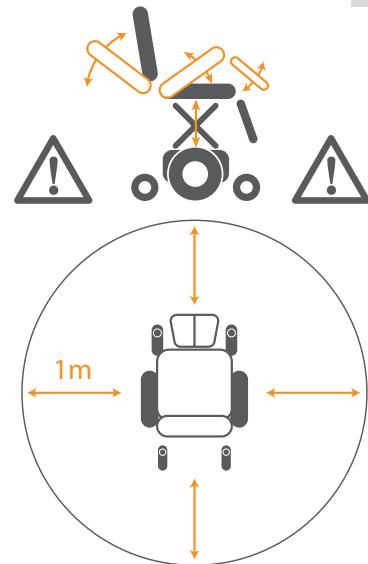


Fig. 6.5

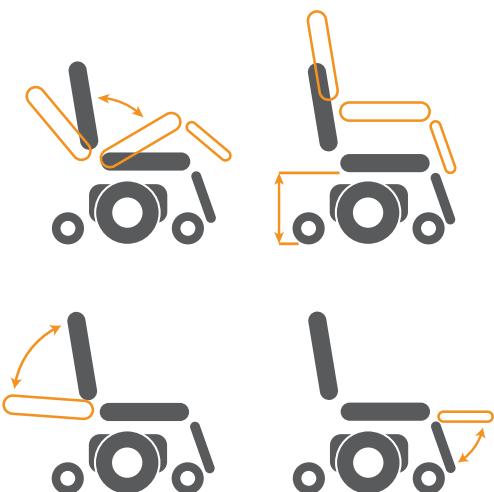


Elektrisk justerbare sædeindstillinger

Fig. 6.6

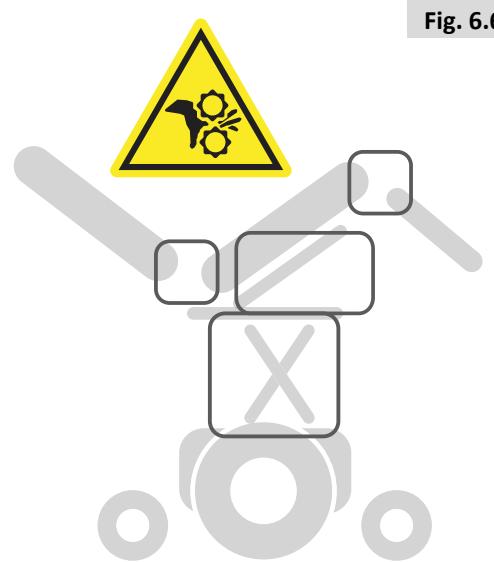

Elektrisk justerbare sædeindstillinger

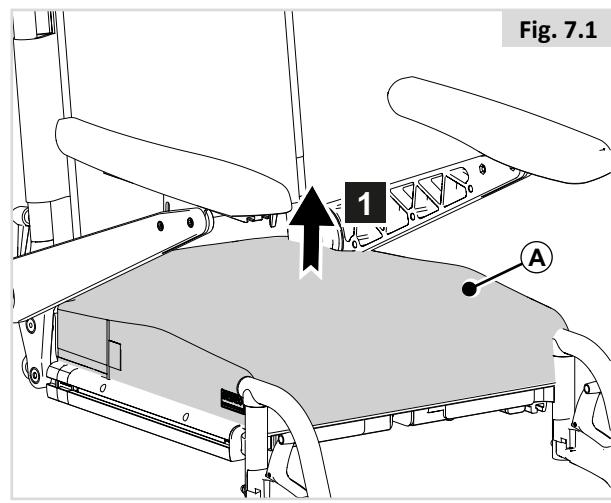

7.0 Reduktion af sædesystemets størrelse ved transport

! RISIKO/ADVARSEL!

Kørestolen kan reduceres i størrelse ved transport uden passager. Eventuelle komponenter på sædesystemet, der nemt kan tages af, skal fjernes. Opbevar komponenterne sikkert, så de ikke forårsager personskade eller beskadigelse eller selv bliver beskadiget.

7.1 Siddepude


Aftagning af sædet (Fig. 7.1)

- Træk (A) opad.

Sæt sædet på plads igen (Fig. 7.2)

- Anbring (A) med hullerne over boltene

Fig. 7.2

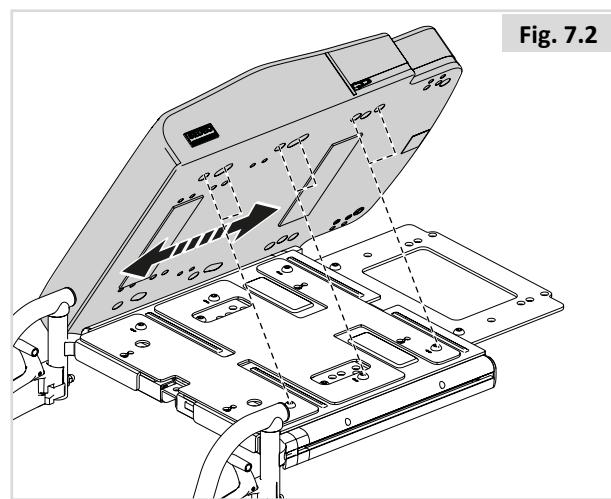

7.2 Rygpude

Aftagning af rygpuden (Fig. 7.3)

- Tryk (A) fremad for at låse op.
- Løft (B).

Placering af rygpuden (Fig. 7.3.1)

- Sørg for, at (A) er på linje.
- Tryk på plads (B).

! BEMÆRK/VIGTIGT!

Stifterne sidder korrekt, når de låses fast med et klik.

Fig. 7.3


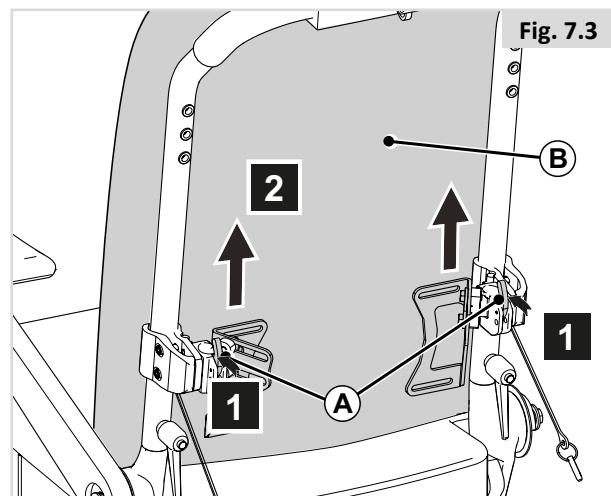


Fig. 7.3.1

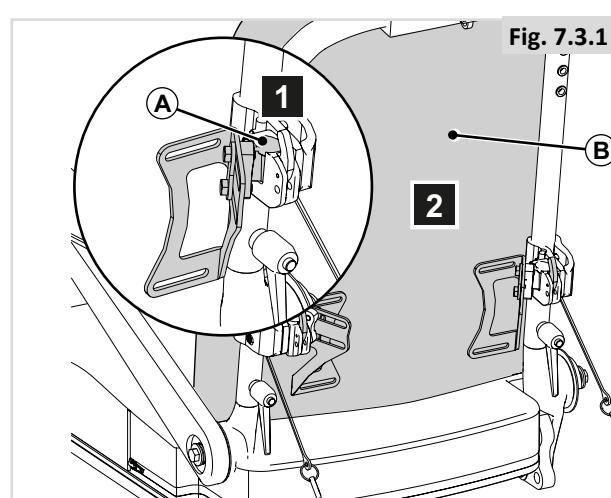

7.3 Slå ryglænet ned (Fig. 7.4)

1. Løsn (A).
2. Træk (B) opad.
3. Slå (B) op og fremad.

BEMÆRK/VIGTIGT!

Om nødvendigt skal du først fjerne rygpuden.

Sørg for, at (A) sidder forsvarligt fast!

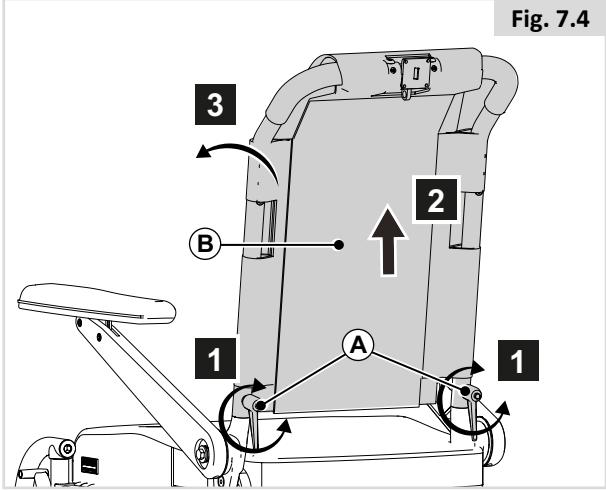


Fig. 7.4

7.4 Sådan slås det tilbagelænende ryglæn ned (Fig. 7.5)

1. Løsn (A).
2. Fjern (B).
3. Træk (C) opad.
4. Slå (C) op og fremad.

BEMÆRK/VIGTIGT!

Om nødvendigt skal du først fjerne rygpuden.

Sørg for, at (A) og (B) sidder forsvarligt fast.

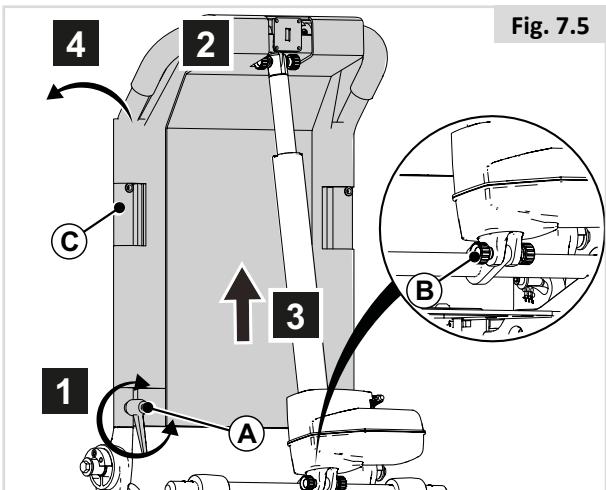


Fig. 7.5

BEMÆRK/VIGTIGT!

Der skal gribes fat om ryglænet øverst oppe for at sikre, at det nemt kan slås op og frem.

7.5 Svingbare benstøtter (Fig. 7.6)

Aftagning af svingbar benstøtte

1. Løsn lægremmen.
2. Skub låsemekanismen (A) bagud for at kunne låse benstøtten op.
3. Sving benstøtten udad.
4. Tag benstøtte (B) ud af sit beslag ved at løfte det.

Du bør høre et klik, når du sætter benstøtten tilbage. Dette betyder, at benstøtten er låst på plads.



Danger of finger entrapment (Fig.7.7)

⚠ Warning!

When the Manual Elevating swing away legrest is removed, carry the legrest at the handle intended for removing/carrying (A).

When carrying at B and at the same time releasing lever C there is a risk of finger trapping.

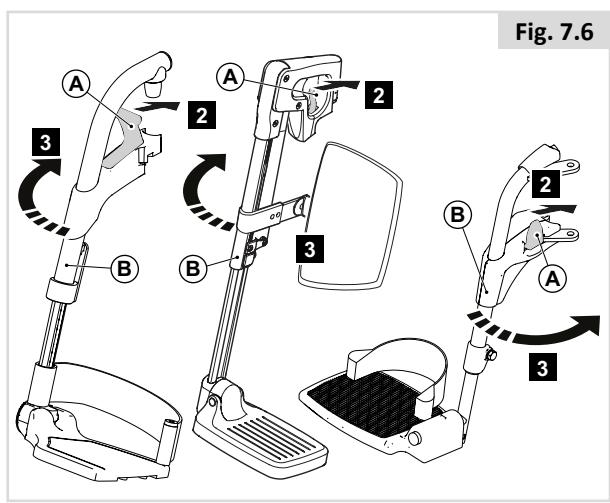


Fig. 7.6

7.6 Aftageligt single-post armlæn

Afmontering af armlæn (Fig. 7.8)

1. Drej (A) nogle få omgange.
2. Fjern (B).

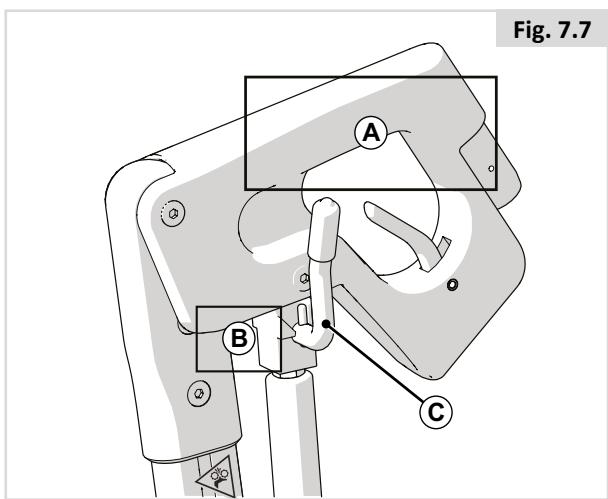


Fig. 7.7

Anbringelse af armlænsmontagen (Fig. 7.9)

1. Skub (A) over på (B).
2. Drej (C) nogle få omgange.

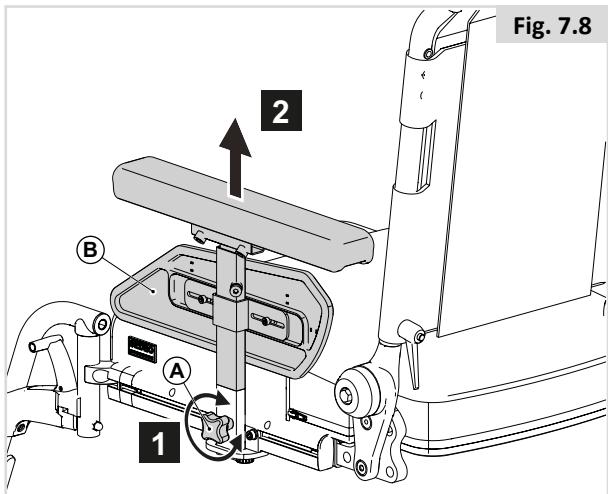


Fig. 7.8

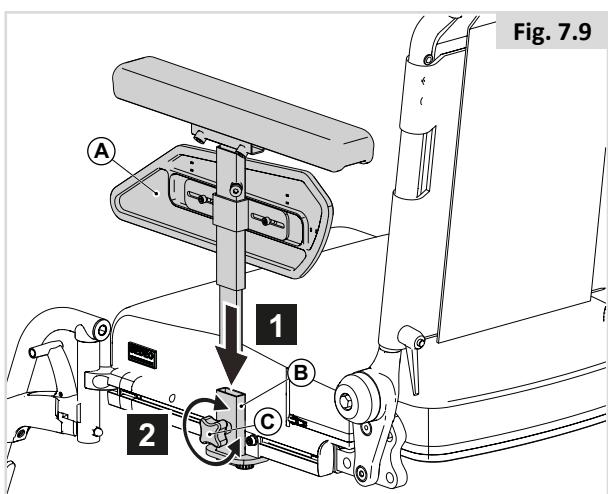


Fig. 7.9

8.0 Vedligeholdelse og rengøring

8.1 Generel vedligeholdelse

- Alle fastgørelseselementer, såsom løse bolte eller knækkede komponenter, skal kontrolleres hver måned for slitage.
- Løse fastgørelsесanordninger skal tilspændes igen i henhold til installationsvejledningen.

Se tabellen nedenfor for de nødvendige drejningsmomenter.

Type fastgørelseselement	Tilspændingsmoment (Nm)
M6-bolt /tapskrue	9 – 10

Bemærk: det er nødvendigt at anvende en momentnøgle.

- Kontroller alle seler månedligt for trævler, flænsede sørme eller andre tegn på kraftig slitage. Hvis selerne er beskadigede, må de ikke bruges.
- Brystseler skal udskiftes, når de viser det mindste tegn på skade og/eller kraftig slitage.
- Hvis der findes en knækket eller løs komponent, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt din forhandler for udskiftning.
- Kontroller om alle velcrostropernes klæbeevne er intakt, når de trykkes sammen.
- Sørg for, at alt snavs såsom fnug, hår, osv. er fjernet fra velcrostropperne. En sådan tilsmudsning kan påvirke klæbeevnen.

8.2 Rengøring af siddesystemet

Kørestolen bør tørres af en gang om ugen med en let fugtig (ikke våd) klud. Støv eller fnug, der har samlet sig på aktuatorerne, pustes væk eller tørres af med en støveklud.

BEMÆRK/VIGTIGT!

Sørg for, at alle dele af kørestolen tørres grundigt, hvis den bliver våd eller fugtig som følge af rengøring, eller hvis kørestolen anvendes i våde eller fugtige omgivelser.

RISIKO/ADVARSEL!

Hvis kørestolen anvendes af flere brugere, er det særligt vigtigt, at den bliver gjort grundigt ren for at undgå risiko for krydsinfektion.

8.2.2 Rengøring og eftersyn af sædet

RISIKO/ADVARSEL!

Flænet, bulet, slidt eller løstsiddende betræk - især hvis det sidder tæt på metaldele - kan medføre dårlig kropsstøtte eller nedsat komfort og trykaflastning.

Rengøringsvejledning for sæder:

Hvis der er en vaskemærkat inden i pudens betræk, kan du vaske betrækket. Følg anvisningerne på vaskemærkaten. Skumfyldet skal tages ud før vask, og velcrolokningerne skal fastgøres!

ADVARSEL!

Der må ikke anvendes organiske opløsningsmidler såsom fortynder, benzen eller mineralsk terpentin.

Polstringen må ikke kemisk renses. Polstringen må ikke stryges eller centrifugeres.

Hvis betrækket ikke er aftageligt, bør det rengøres regelmæssigt for at forhindre ophobning af snavs eller permanent tilsmudsning. Rengøres med opvredet sæbeklud. Der kan anvendes desinficerende midler, men kun i opløsninger svarende til producentens vejledning. Efter brug af denne slags midler skal overfladerne renses grundigt med rent vand og tørres omhyggeligt inden brug.

8.3 Hygiejneprocesser ved genanvendelse:

Hvis kørestolen skal anvendes af en ny bruger, bør den klargøres grundigt. Alle overflader, der kan komme i kontakt med brugeren, skal behandles med desinficeringsmiddel i sprayform.

Anvend til dette formål et egnet desinfektionsmiddel til hurtigtvirkende, alkoholbaseret desinfektion af medicinske hjælpemedler og medicinsk udstyr.

Producentens vejledning skal følges nøje under anvendelsen af desinficeringsmidlet.

BEMÆRK/VIGTIGT!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, klorin, skuremidler, syntetiske rengøringsmidler, polérvoks eller midler i sprayform.
- Der kan anvendes desinficerende midler, men kun i opløsninger svarende til producentens vejledning.
- Sørg for at skylle overfladerne med rent vand samt tørre dem grundigt.

8.4 Generelle rengøringsanvisninger:

BEMÆRK/VIGTIGT!

- Eventuelle pletter på sædet bør fjernes hurtigst muligt.
- Efter længere tids brug bør sædebetrækket renses med et almindeligt skumprodukt til tørrensning.
- Du bør altid rense hele overfladen på én gang frem for de enkelte pletter for at undgå grimme kanter rundt om pletterne. Jo længere en plet får lov at sidde, jo sværere bliver den at fjerne.
- Undgå at grubbe hårdt på pletterne med vandholdige oplosninger, da dette vil give betrækket en ru overflade.
- Smudspletter (f.eks. øl, blod, cola, rødvin o.l.) fjernes bedst med et skumprodukt til tørrensning eller et mildt rengøringsmiddel.
- Produkternes brugsvejledninger bør følges nøje ved behandling af betrækket.
- Betrækket skal have lov at tørre i mindst 48 timer efter behandling med skumprodukter.
- Fedtppletter (f.eks. kuglepen, læbestift, tyggegummi o.l.) fjernes med et produkt udviklet specielt til pletfjerning. Det snavsede område grubbes forsigtigt, og kun på overfladen, med en ren klud opvredet i pletfjerningsmidlet.
- Pletfjerner bør kun anvendes i ganske små mængder.
- Prøv altid først pletfjerningsmidlet af på et sted, der ikke er synligt.
- Betrækket må ikke gennemvædes, da det i givet fald kan angribes og ødelægges af pletfjerner.
- Kraftig gnidning skal undgås på f.eks. påtrykte skalaer, pilene på sædepladen og skalaen for sædebreddejusteringen.
- Der må ikke bruges vandslange eller højtryksspuler til rengøring af kørestolen.

RISIKO/ADVARSEL!

- Sørg for altid at læse etiketten på enhver form for rengøringsmidler til erhvervs- eller privatbrug.
- Brugsanvisningen skal altid følges nøje.

8.5 Rengøringstilbehør:

- Alle dele/alle former for tilbehør, f.eks. bordplader, rengøres ved aftørring med en fugtig klud.
- Alle former for sidestøtter, hovedstøtte, armlæn, sideafskærmninger, lægpuder, hofteseler og knæpuder bør rengøres ved aftørring med en fugtig klud.

8.6 Rengøring af betjeningsenheden:

Hvis kørestolens betjeningsenhed bliver snavset/beskidt, kan den tørres af med en fugtig klud med en desinficerende oplosning.

RISIKO/ADVARSEL!

- Dette er vigtigt for at undgå krydsinfektion, hvis kørestolen anvendes af flere brugere.
- Sørg for, at wafer boards, joystick (alle typer), enheder, der betjenes med hovedet samt afbrydere (alle typer) rengøres med en blød klud opvredet i et mildt desinficerende middel for at undgå risiko for krydsinfektion. Sug & Pust-systemets mundstykke og rør bør tages af kørestolen og vaskes med jævne mellemrum for at sikre optimal hygiejne og funktion.
- Sørg for, at betjeningsenheden er slukket inden rengøring.

8.7 Opbevaring

Hold polstringen og andre dele af kørestolen i god stand ved at opbevare kørestolen i et tørt miljø så tæt på stuetemperatur som muligt.


RISIKO/ADVARSEL!

- Kørestolen må ikke opbevares i direkte sollys eller på fugtige og/eller udendørs steder.
- Direkte sollys kan blege polstringen/plastikdelene og medføre, at metaldelene bliver varme.

9.0 Bortskaffelse

Nedenstående symboler angiver, at dette produkt i henhold til den lokale lovgivning ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald. Når produktets levetid er udløbet, bør det afleveres på nærmeste kommunale genbrugsstation. Ved at sørge for, at produktet bortskaffes og genbruges korrekt, kan man både spare naturlige råstoffer og sikre sig, at produktet genbruges på en miljøvenlig måde.

Sørg for at du er den retmæssige ejer af produktet, inden du arranger bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med de ovenstående anbefalinger og nationale forskrifter.

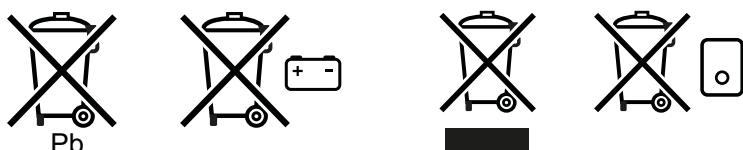

I dette kapitel findes en oversigt over, hvilke materialer, kørestolen er fremstillet af, med henblik på bortskaffelse eller genbrug af såvel kørestolen som dens emballage.

I tilfælde af bortskaffelse eller genbrug, se venligst Sedeo Lite-manualen (☞ Sædesystem).

Vær opmærksom på eventuel lokal lovgivning angående bortskaffelse eller genbrug, som der skal tages hensyn til, når kørestolen kasseres. (Der kan bl.a. være særlige regler angående rengøring eller desinfektion af kørestolen inden bortskaffelsen).

Aluminium: Svinghjulsgafler, hjul, sideafskærmlninger til chassiset.

Stål: Fastgøringspunkter, quick-release-aksel

Plast: Håndtag, rørstoppere, svinghjul og hjul/dæk

Emballage: Plastposer af blød polyethylen, pap

Bortskaffelse eller genbrug skal foretages gennem en autoriseret agent eller et autoriseret bortskaffelsessted. Alternativt kan din kørestol returneres til din forhandler for bortskaffelse.



10.0 Tekniske specifikationer:

10.1 Gældende normer/standarder

EN-ISO10993-5: 2009 Biologisk evaluering af medicinsk udstyr.

EN 1021 1&2 Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler. Antændelseskilde svarende til glødende cigaret.

10.2 Tekniske specifikationer:

Sedeo Lite siddesystem

	Metrisk system		Imperiale systemværdier & alternativ	
	Minimum	Maksimalt	Minimum	Maksimalt
Sædets vinkeljustering				
Elektrisk hældning med COG-justering, valgfrit	0° - 30°		-5° - 25°	
Elektrisk hældning med COG-justering, valgfrit	-5° - 25°		0° - 30°	
Elektrisk hældning med COG-justering, valgfrit	0° - 50°		0° - 50°	
Effektiv sædedybde	410 mm	560 mm	16,1"	22,0"
Effektiv sædebredde	385 mm	510 mm	15,2"	22,1"
Sæde til gulvhøjde				
Filler-modul (Ingen elektrisk tilt-in-space, ingen sædeelevator)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	415 mm		16,3"	
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	440 mm		17,3"	
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	465 mm		18,3"	
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	490 mm		19,3"	
Elektrisk hældning og sædeløft (30 cm)				
pos. 1 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
pos. 2 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
pos. 3 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	465 mm	765 mm	18,3"	30,1"
pos. 4 60 eller 80 Ah batterier 0° sædevinkel	490 mm	790 mm	19,3"	31,1"
Ryglænsvinkel				
Vinkeljusterbar ryg, anvend værktøj	86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°		86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°	
Elektrisk tilbagelæning	85° - 120°		85° - 120°	
Ryglænshøjde (sædeplade til toppen af rygpude)	460 mm	510 mm	18,1"	20,1"
Flip-back armlæn				
Armlænspudes højde (sædeplade til toppen af armpude)	190 mm	320 mm	7,5"	12,6"
Armlænspudes dybde (på armlænsprofil)	100 mm		3,9"	
Armlænspudes vinkel (lodret)	0° - 15°		0° - 15°	
Single-post flip-back armlæn				
Armlænspudes højde (sædeplade til toppen af armpude)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Armlænsbredde (på sæderamme)	-20 mm	+20 mm	-0,79"	+0,79"
Armlænspudes bredde (på armlænsprofil)	-20 mm		-0,79"	
Armlænsdybde (på sæderamme)	250 mm		9,8"	
Armlænspudes dybde (på armlænsprofil)	140 mm		5,5"	
Armlænspudes vinkel (lodret)	0° - 15°		0° - 15°	
Midtermonteret benstøtte				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Knævinkel	70° - 120°		70° - 120°	
Ankelvinkel	+20° - -40°		+20° - -40°	
Elektrisk midtermonteret benstøtte				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	210 mm	470 mm	8,3"	18,5"
Knævinkel	90° - 180°		90° - 180°	
Maks. længdekompensation	180 mm		7,1"	
Ankelvinkel	+35° - -15°		+35° - -15°	
SEDEO LITE-svingbare benstøtter				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knævinkel	70°		70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	

	Metrisk system		Imperiale systemværdier & alternativ	
	Minimum	Maksimalt	Minimum	Maksimalt
SEDEO LITE-svingbare benstøtter, manuel hævefunktion/ elektrisk hævefunktion				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knævinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
UNI-svingbare benstøtter				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knævinkel	70°		70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
SEDEO PRO-svingbare benstøtter				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knævinkel	70°		70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
SEDEO PRO-swingbare benstøtter, manuel hævefunktion/ elektrisk hævefunktion				
Nedre benlængde (fra sædeplade)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Knævinkel	0° - 70°		0° - 70°	
Ankelvinkel	0° - 180°		0° - 180°	
SEDEO hovedstøttemontage, multi-position				
Hovedstøtte højdejusteringsområde	170 mm		6,7"	
Hovedstøtte dybdejusteringsområde	200 mm		7,9"	
Hovedstøttevinkel (lodret)	-45° - +45°		-45° - +45°	
Hovedstøttebredde	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Laterale støtter				
Lateral støtte breddejusteringsområde	90 mm		3,5"	
Lateral støtte højdejusteringsområde	170 mm		6,7"	
Lateral støtte dybdejusteringsområde	45 mm		1,8"	
Abduktionskile (pommel)				
Abduktionskilehøjde (fra sædeplade til toppen af pude)	170 mm	250 mm	6,7"	9,8"
Abduktionskile dybdejusteringsområde	65 mm		2,5"	

11.0 Garanti

DENNE GARANTI INDSKRÆNKER IKKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL KØBELOVEN.

Sunrise Medical* yder en garanti som anført i garantibetingelserne for kørestole til sine kunder, der dækker det følgende.

Garantibetingelser:

1. Hvis en del eller dele af kørestolen har brug for reparation eller udskiftning på grund af en produktions- og/eller materialefejl bliver den berørte del repareret eller udskiftet gratis inden for 24 måneder. For produktions- og/eller materialefejl på stellet eller krydsstellet, kan reparation eller erstatning ske op til 5 år efter levering. Garantien dækker kun produktionsfejl.
2. For at håndhæve garantien, skal du kontakte Sunrise Medicals kundeservice med de nøjagtige oplysninger om problemet.
Såfremt du anvender kørestolen udenfor din Sunrise Medical-servicerepræsentants område, skal reparationer og udskiftninger udføres af en anden part anvist af producenten. Kørestolen skal repareres af en Sunrise Medical autoriseret servicemedarbejder.
3. For dele, som er blevet repareret eller udskiftet inden for garantien, giver vi en garanti i overensstemmelse med disse garantivilkår for kørestolens resterende garantiperiode i henhold til punkt 1).
4. Originale reservedele, der er blevet monteret på kundens regning, er dækket af en garanti på 12 måneder (efter montering) i overensstemmelse med garantibetingelserne i denne brugervejledning.
5. Erstatningskrav fra denne garanti kan ikke forekomme for reparationer eller udskiftninger på kørestolen på grund af følgende årsager:
 - a. Almindelig slitage, som omfatter batterier, armlænspuder, polstring, dæk, bremseklodser osv.
 - b. Hvis produktet overbelastes. Se EF-etiketten vedrørende den maksimale brugervægt.
 - c. Produktet eller delen ikke er blevet vedligeholdt i henhold til producentens anbefalinger som angivet i brugervejledningen og/eller den tekniske vejledning.
 - d. Der er anvendt andet tilbehør end det, der er angivet som originalt tilbehør fra producentens side.
 - e. Kørestolen eller delen er beskadiget som følge af misligholdelse, uheld eller uhensigtsmæssig brug.
 - f. Ændringer/modificeringer er blevet foretaget på kørestolen eller dele, der afviger fra producentens specifikationer.
 - g. Hvis der er foretaget reparationer, inden kundeservice er blevet informeret om problemerne.

6. Denne garanti er omfattet af loven i det land, hvor produktet blev købt fra Sunrise Medical™

* Betyder den Sunrise Medical forhandler, hvorfra produktet blev købt.

Ota yhteyttä Sunrise Medicalin valtuuttamaan huoltopalveluun, jos sinulla on kysyttävää pyörätuolisi käytöstä, huollostaa tai turvallisuudesta. Jos lähialueellasi ei ole valtuutettua jälleenmyyjää tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä kirjeitse tai soittamalla.

HALTIJA Group Oy

Koivuhaantie 2-4


01510 Vantaa

Suomi

Puh 09 612 2250

asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi



ISO 7010-M002

Käyttöohje/ohje on luettava!
(Sininen kuvake)

Jälleenmyyjän allekirjoitus ja leima

Sisällysluettelo

1.0 Tietoja käyttäjälle	87
1.1 Tämä käyttöopas	87
1.2 Lisätietoja	87
1.3 Tässä käyttöoppaassa käytettävät symbolit	87
2.0 Turvallisuus	88
2.1 Tuotteessa käytettävät istuinaiheiset symbolit ja tarrat	88
2.2 Turvallisuus: Lämpötila	88
2.3 Turvallisuus: Liikkuvat osat	88
2.4 Turvallisuus: Tukehtumisvaara	88
2.5 Turvallisuus: Pöydät	89
3.0 Yleiskuvaus	89
4.0 Istuinjärjestelmän asetusten tekeminen	90
4.1 Määritä istuinsyyys	90
4.2 Määritä istuinleveys	91
4.3 Selkänojan esiasetus (tämän säädon voi suorittaa vain koulutettu ammattilainen)	92
4.4 Taakse kääntyvien käsinojen esisäätiö	94
4.5 Keskiinnitteisten käsinojen esisäätiö	95
4.6 Keskiinnitteisten taakse kääntyvien käsinojen esisäätiö	95
4.7 Sivulaita	98
4.8 Määritä keskiinnitteisen jalkatuen asetukset	99
4.9 Kiinteästi asennetun keskiinnitteisen jalkatuen esiasetus	100
4.10 Määritä moottoroidun keskiinnitteisen jalkatuen asetukset	101
4.11 Sivulle kääntyvien SEDEO LITE-jalkatukien esisäätiö	102
4.12 Sivulle kääntyvän UNI-jalkatuen esisäätiö	102
4.13 Määritä taittuvien jalkatukien asetukset	103
4.14 Määritä pääntuen asetukset	104
4.15 Määritä kiinteän / sivulle taittuvan ohjaimen pidikkeen asento	105
4.16 Sivulle kääntyvän ohjaimen esisäätiö	106
4.17 Määritä sivutukien asetukset	107
4.18 Määritä sivulle käännettävän polvi/reisituen asetukset	108
4.19 Määritä haarakiilan asetukset	108
4.20 Lantio-/tukivyö	109
5.0 Pyörätuolin käyttäminen	110
5.1 Pyörätuoliin siirtyminen ja poistuminen	110
5.2 Valmistautuminen pyörätuoliin siirtymiseen etusuunnassa	110
5.3 Valmistautuminen siirtymiseen sivusuunnassa	111
5.4 Pääntuki	112
5.5 Sivulle taittuva ohjaimen pidike	112
5.6 Sivuttaissäädot (Kuva 5.11)	112
5.7 Polvi/reisituki (kuva 5.12)	113
5.8 Hemiplegiakäsinoja (kuva 5.13)	113
5.9 Haarakiila (kuva 5.14)	113
6.0 Manuaalisesti ja sähkötoimisesti tehtävät istuimen säädot	114
6.1 Manuaalisesti tehtävät istuimen säädot	114
6.2 Sähkötoimisesti tehtävät istuimen säädot	115
7.0 Istuinjärjestelmän pakkaaminen kuljetusta varten	116
7.1 Istuintyynty	116
7.2 Selkätyyny	116
7.3 Selkänojan taittaminen alas (kuva 7.4)	117
7.4 Kallistuvan selkänojan taittaminen alas (kuva 7.5)	117
7.5 Jalkatukien käänтäminen sivulle (kuva 7.6)	118
7.6 Keskiinnitteinen irrotettava käsinoja	118
8.0 Huoltaminen ja puhdistaminen	119
8.1 Yleinen kunnossapito	119
8.2 Pyörätuolin puhdistaminen	119
8.3 Tarvittavat hygieniatoimenpiteet ennen uudelle käyttäjälle luovuttamista:	119
8.4 Yleisiä puhdistusohjeita:	120
8.5 Lisääitteiden puhdistaminen:	120
8.6 Ohjauslaitteiden puhdistaminen:	120
8.7 Varastointi	120
9.0 Hävittäminen	121
10.0 Tekniset tiedot:	122
10.1 Sovellettavat standardit	122
10.2 Tekniset tiedot: SEDEO Lite-istuinjärjestelmä	123
11.0 Takuutiedot	125

1.0 Tietoja käyttäjälle

Kiitos, että valitsit Sunrise Medical -pyörätuolin. Sunrise Medicalin korkealaatuiset tuotteet lisäävät käyttäjän itsenäisyyttä ja helpottavat jokapäiväistä elämää.

1.1 Tämä käyttöopas

Tämän käyttöoppaan avulla käytät ja ylläpidät istuinjärjestelmääsi turvallisesti. Tämä istuinkäsikirja täydentää Sunrise Medicalin yleistä pyörätuolin käyttöohjetta:

- Pyörätuolin yleinen käyttöopas
- Pyörätuolin käyttöopas (tämä kirjanen)
- Ohjausjärjestelmän käyttöopas

Tässä istuinkäsikirjassa viitataan tarvittaessa muihin käsikirjoihin alla esitettyllä tavalla:

Yleinen käyttöopas:	Viittaus pyörätuolin yleiseen käyttöoppaaseen.
Ohjauslaite:	Viittaus ohjausjärjestelmän käyttöoppaaseen.
Akkulaturi:	Viittaus akkulaturin käyttöoppaaseen.

Älä käytä pyörätuolia ennen kuin olet lukenut kokonaan tämän käyttöoppaan (ja kaikki muut kirjaset) ja ymmärtänyt sen sisällön!

Jos jokin käyttöoppaista ei tullut pyörätuolin mukana, ota heti yhteyttä laitteen myyjään. Pyörätuolin mukana toimitetaan tämän käyttöoppaan lisäksi ammattitaitoiselle henkilöstölle tarkoitettu huolto-opas.

1.2 Lisätietoja

Ota yhteyttä paikalliseen Sunrise Medicalin valtuuttamaan jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää pyörätuolisista käytöstä, huollossa tai turvallisuudesta. Jos lähialueellasi ei ole valtuutettua jälleenmyyjää tai jos haluat kysyä jotakin, ole hyvä ja ota yhteyttä Sunrise Medicaliin joko kirjallisesti tai soittamalla.

Lisätietoja tuotteen käyttöturvallisuudesta ja mahdollisista takaisinkutsuista löydät osoitteesta www.haltija.fi

1.3 Tässä käyttöoppaassa käytettävät symbolit



VAARA/VAROITUS!

Loukkaantumisen, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara.




HUOMAUTUS/HUOMIO!


Laitevaurion vaara.

Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysisiä vammoja, laitevauriota tai ympäristövahinkoja!

Ilmoitus käyttäjälle ja/tai potilaalle: kaikista laitteeseen liittyvistä vakavista tapaturmista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

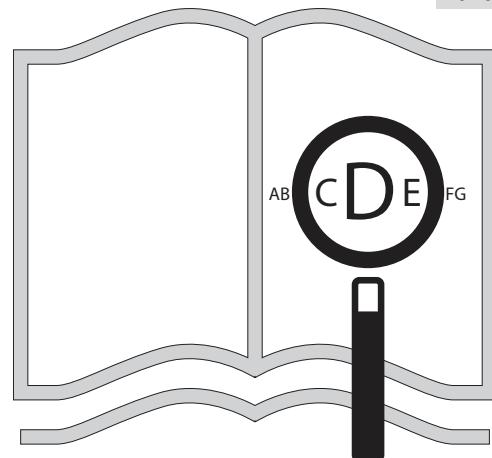

Jos olet näkövammainen, tämä asiakirja on nähtävissä PDF-muodossa osoitteessa:
www.haltija.fi

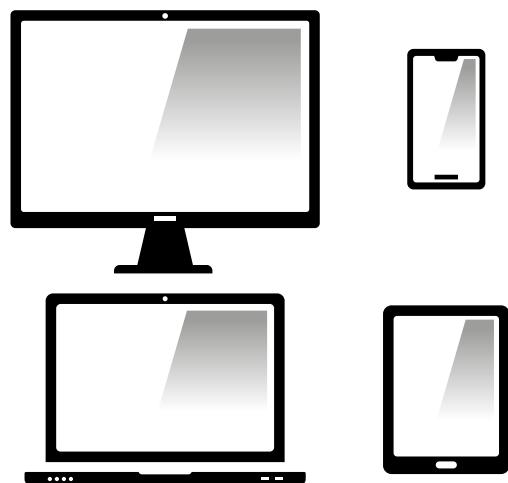

tai asiakirja voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa pyynnöstä suurena tekstinä.



2.0 Turvallisuus

Noudata näihin symboleihin liittyviä ohjeita huolellisesti! Jos näitä ohjeita ei lueta huolellisesti, seurauksena voi olla henkilövahinkoja, pyörätuoli voi vaurioitua tai ympäristö voi kärsiä. Turvallisuustiedot sisältyvät aina tarvittaessa asianmukaisessa kappaleessa.

2.1 Tuotteessa käytettävät istuinaiheiset symbolit ja tarrat

Pyörätuolin kiinnitetyt merkit, symbolit ja ohjeet liittyvät turvallisuustietoihin. Niitä ei saa koskaan peittää tai poistaa. Näiden turvamerkintöjen on oltava paikallaan ja selvästi luettavissa koko pyörätuolin käyttöän ajan.

Vaihda tai korjaa kaikki lukukelvottomat tai vaurioituneet merkit, symbolit ja ohjeet välittömästi. Pyydä apua jälleenmyyjältä.

Kuva 2.1: Varoitus – Sormet voivat jäädä puristukseen.

Kuva 2.2: Varoitus – Varmista ennen pyörätuolin käyttöä, että istuimen rungon pikakiinnitys on ruuvattu tiukasti kiinni varsinkin ennen kaltevalla tasolla ajoa

Kuva 2.3: Varoitus – Älä aja pyörätuolilla kaltevalla tasolla selkänoja taka-asennossa ja/tai istuin seisontatilassa.

2.2 Turvallisuus: Lämpötila

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Kun pyörätuoli ei ole käytössä, säilytä sitä paikassa, jossa se ei ole alttina suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Jotkin pyörätuolin osat (esim. istuin, selkänoja ja kädensijat) voivat kuumentua, jos pyörätuoli on pitkään suorassa auringonvalossa. Tämä saattaa aiheuttaa palovammoja tai allergisia ihoreaktioita.

2.3 Turvallisuus: Liikkuvat osat

⚠️ VAARA/VAROITUS!

Pyörätuolissa on liikkuvia ja pyöriviä osia. Liikkuvien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa vakavia fyysisiä vammoja tai vahingoittaa pyörätuolia. Pyörätuolin liikkuvien osien koskettamista tulee välttää.


- Sähkötoiminisen istuimen kallistus
- Sähkötoiminisen istuimen korkeudensäätö
- Sähkötoiminisen selkänojan kallistus
- Ohjaimen sivulle käännyvä pidike

2.4 Turvallisuus: Tukehtumisvaara

⚠️ VAARA/VAROITUS!

Tämä liikkumisen apuväline sisältää pieniä osia, jotka voivat tietyissä olosuhteissa aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.


Kuva 2.1

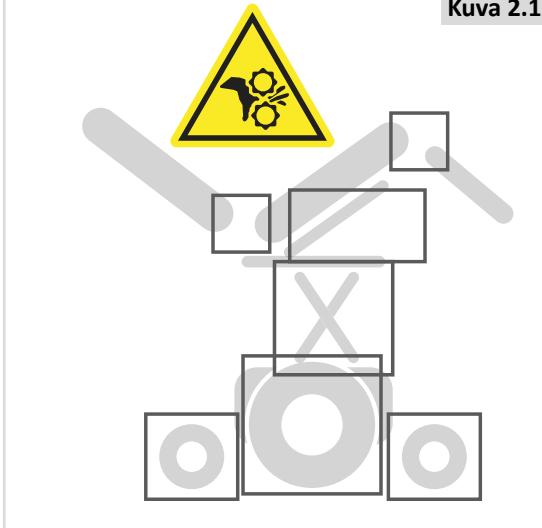

Kuva 2.2



Kuva 2.3

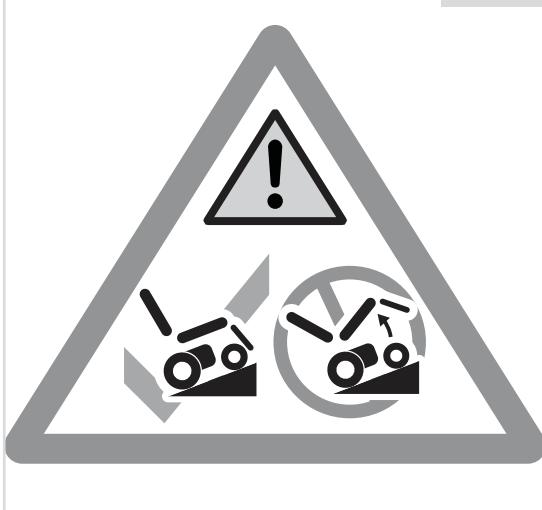

2.5 Turvallisuus: Pöydät

Turvallisuus: Hengityslaitteen teline

⚠️ VAARA/VAROITUS!

Hengityslaitteen telineen käyttö vaikuttaa pyörätuolin vakauteen ja kokonaispainoon.

- Varmista, että hengityslaite ja akut ovat kunnolla kiinnitetty telineeseen ennen käyttöä.
- Tutustu pyörätuolin muuttuneisiin mittasuhteisiin etukäteen voidaksesi välttää mahdolliset törmäykset.
- Varmista selkänoja kallistaessasi, että hengityslaitteen telineen ympärillä on riittävästi tilaa.
- Ota huomioon, että sormet voivat jäädä hengityslaitteen telineen väliin puristukseen selkänoja kallistettaessa.
- Hengityslaitteen telinettä ei ole tarkoitettu muiden kuin hengityslaitteen ja sen akkujen pidikkeeksi, sitä ei ole suunniteltu esim. happipullon telineeksi. Muiden esineiden kuljettaminen voi häirittää pyörätuolin tasapainoa.
- Ainoastaan Sunrise Medicalin valtuuttama jälleenmyyjä saa asentaa hengityslaitteen telineen ja huoltaa sitä.

Turvallisuus: Käännettävä taso:

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Pöydän enimmäiskuormitus on 2,5 kiloa.
- Älä ylikuormita telinettä; se voi hajota tai heikentää pyörätuolin vakautta.
- Älä jätä telineelle palavia savukkeita tai muita kuumia esineitä, jotka voivat jättää telineeseen jälkiä tai muuttaa sen muotoa.
- Varmista ennen pöydän käyttöönottoa, ettet jätä mitään ruumiinosia tai vaatteita pöydän väliin.


3.0 Yleiskuvaus

Tämä pyörätuoli on varustettu Sedeo Lite -istuinjärjestelmällä. Sedeo Lite -istuinjärjestelmä tukee erinomaisesti päätä, vartaloa, käsiä ja jalkoja. Optimaalisen vartalon tuen ansiosta pyörätuolin käyttäjä voi toimia mahdollisimman itsenäisesti.

Pyörätuolin säädöt saa suorittaa vain tehtävään koulutuksen saanut henkilö. Väärin tehdyt asetukset voivat vaikuttaa haitallisesti istumaa-asentoon.

Pääkomponentit (kuva 3.1):

1. Pääntuki
2. Ohjainsauva
3. Käsinoja
4. Istuintyyny
5. Jalkatuki
6. Selkänoja

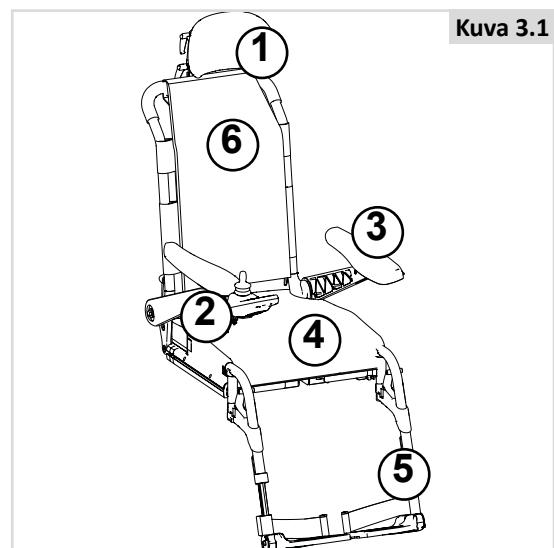

Kuva 3.1

4.0 Istuinjärjestelmän asetusten tekeminen

Keskivertoista pyörätuolin käyttäjää ei ole olemassa. Siksi Sunrise Medical -pyörätuolien asetukset voidaan säätää etukäteen käyttäjän erityistarpeiden mukaan.

Esiasetukset tehdään vain kerran ennen pyörätuolin ensimmäistä käyttökertaa. Nämä asetukset saa tehdä vain pätevä asiantuntija, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Työkalu ja kalibrointimerkit

Ammattilaisen on käytettävä M5-kuusiokoloavainta kaikkien istuinjärjestelmäasetusten säätämiseksi.


⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Istuinjärjestelmän eri osissa on kalibrointimerkkejä. Tehdasasetukset on merkitty.

4.1 Määritä istuinsyvyys

Selkänojan syvyys (kuva 4.1):

1. Löysää (A) molemmin puolin yhdellä kierroksella.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

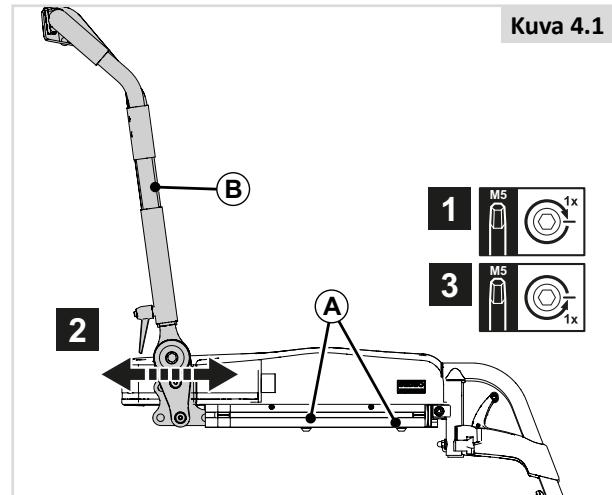

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Mallit SD 535 ja 560: poista (A) kokonaan ja säädä ne seuraavaan paikkaan.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

- Jos istuinsyvyyttä on säädettävä huomattavasti, varmista että kaapeleita pidennetään ennen mekaanista säätöä.

Istuinpehmusteenvaakunasta johtava reikiä (kuva 4.2)

Käytä istuintyyyn asennon säätöä varten kuvassa 4.2 näkyviä reikiä (integroidulla istuinlevyllä varustetut istuintyynt). Istuinpehmusteenvaakunasta johtava reikiä voi asentaa myös yhden kiinnityskohdan verran eteenpäin istuinsyvyuden lisäämiseksi.

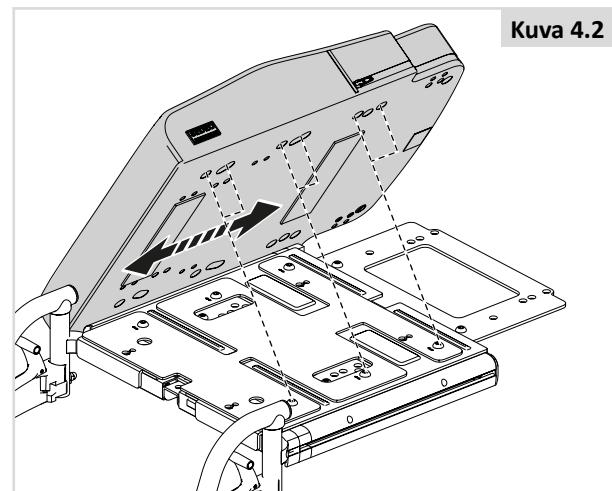

4.2 Määritä istuinleveys

Jos haluat säättää istuinrungon leveyttä, istuinlevyn ja selkäosan leveys on säädettävä samanaikaisesti. Selkeän selityksen vuoksi ne on mainittu erikseen kuvissa 4.3, 4.4 ja 4.5.

Istuinrungon leveys (kuva 4.3)

Irrota istuintyyny Velcro®-tarranauhoista päästäksesi käsiksi istuinlevyihin.

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

Selkäosan leveys (kuva 4.4)

1. Avaa suojuus
2. Poista (A) kokonaan.
3. Säädä (B) haluttuun asentoon.
4. Asenna (A).
5. Sulje suojuus

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Selkäosan leveydensäätöä varten on olemassa kaksi eri kokoa. Yksi 385-485 mm ja yksi 460-510 mm.

Selkäosan leveys, sähkötoimisella kallistuksella varustetut pyörätuolit (kuva 4.5)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).


Keskiinnitteisten taittuvien käsinojien leveys (lisävaruste) (kuva 4.6)

Hienosäätöjä voidaan tehdä vain käsinojalla.


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Varmista ettei käsinojan uusi asento häiritse mitään istuma-asentoa.

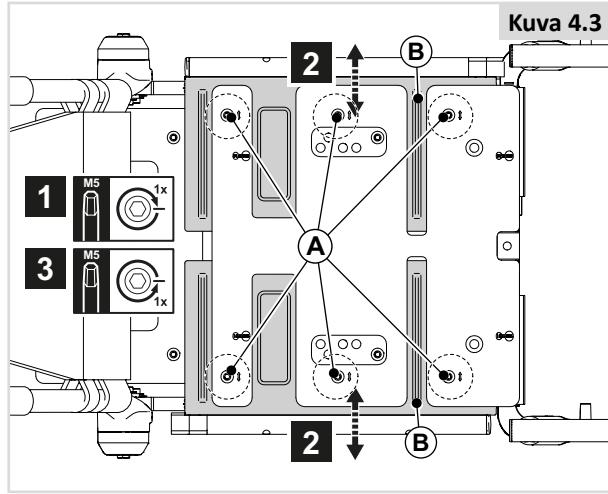


Kuva 4.3

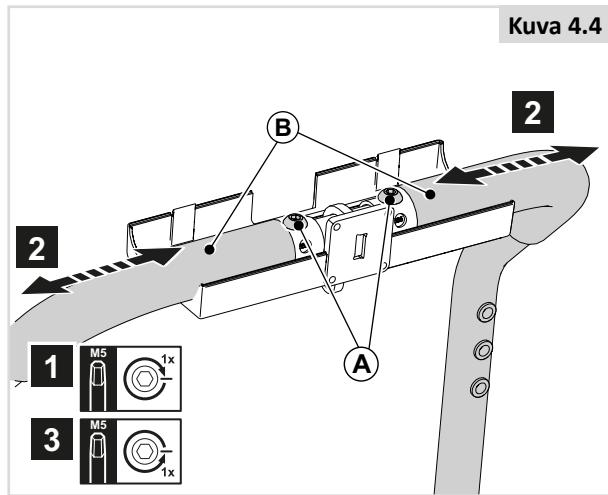

Kuva 4.4

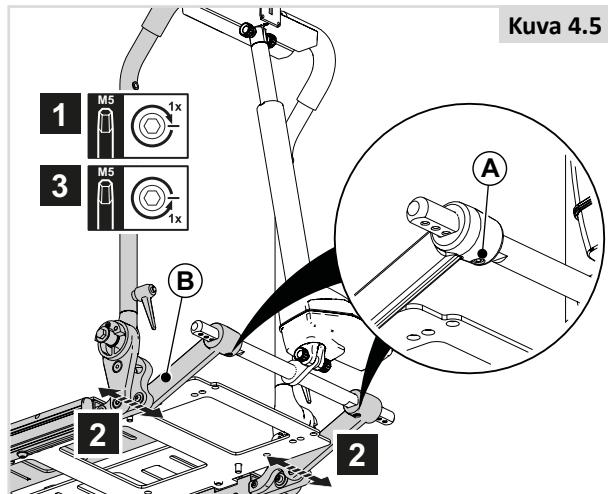

Kuva 4.5

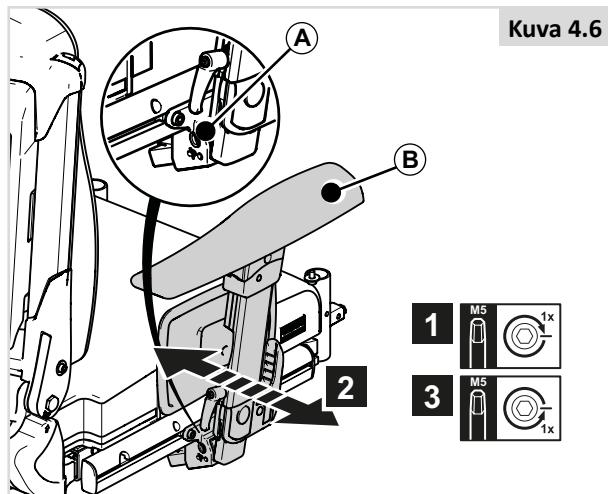

Kuva 4.6

4.3 Selkänojan esiasetus (tämän säädön voi suorittaa vain koulutettu ammattilainen)


Selkänojan kallistuskulma (kuva 4.7)

1. Löysää (A) siten, että (B) vapautuu
2. Säädä (B) haluttuun asentoon ja säädä (C) haluttuun asentoon. Kierrä (B) 180° saavuttaaksesi -4° , 4° , 12° .
3. Kiristä (A)


HUOMAUTUS: Nastojen on oltava reikien sisällä ja levy (B) on kiinnitettävä pintaa vasten.

Hihnoilla varustetun selkänojan korkeus (kuva 4.8)

1. Poista (A) avaamalla (B).
2. Poista (C) kokonaan.
3. Säädä (D) haluttuun asentoon.
4. Kiristä (C).
5. Laita (A) takaisin.

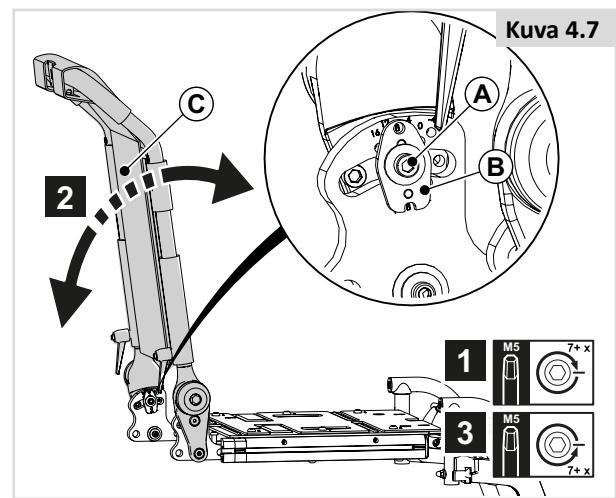


Kuva 4.7

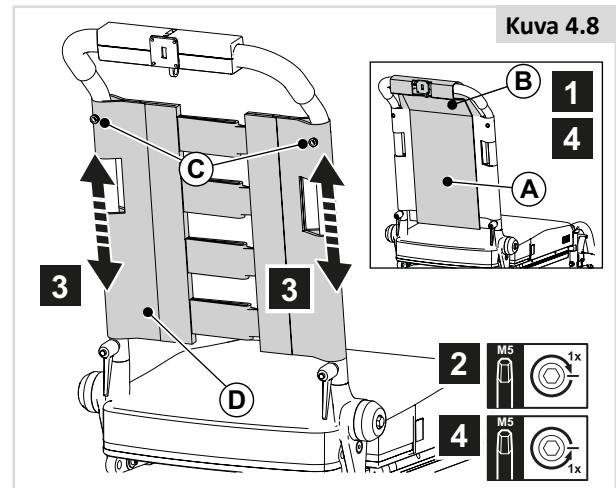

Kuva 4.8

SEDEO LITE -selkätyynyllä varustetun selkänojan korkeus (kuva 4.9)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

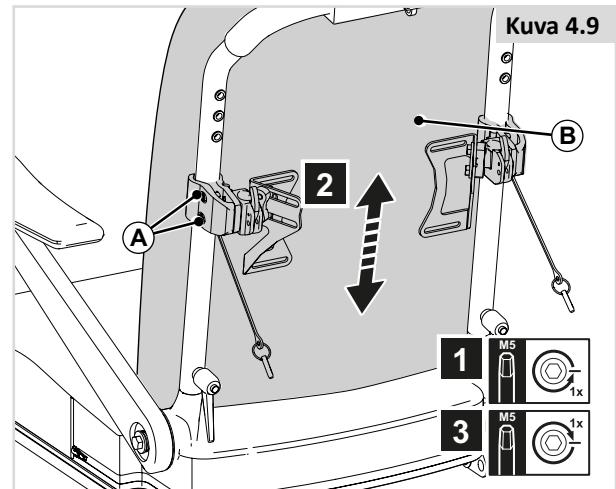


Kuva 4.9

Säädetävillä hihnoilla varustettu selkänoja (kuva 4.10)

Pyörätuolissa on selän kaarevuuden mukaan säädetävillä hihnoilla varustettu selkänoja, joka mahdollistaa mukavan istuma-asennon ja hyvän vakauden. Käyttäjä voi istua pyörätuolissa selkänojan kaarevuuden säätöjä tehtäessä.

1. Käännä (A) taakse.
2. Löysää tai kiristä (B) tarranauhalla.

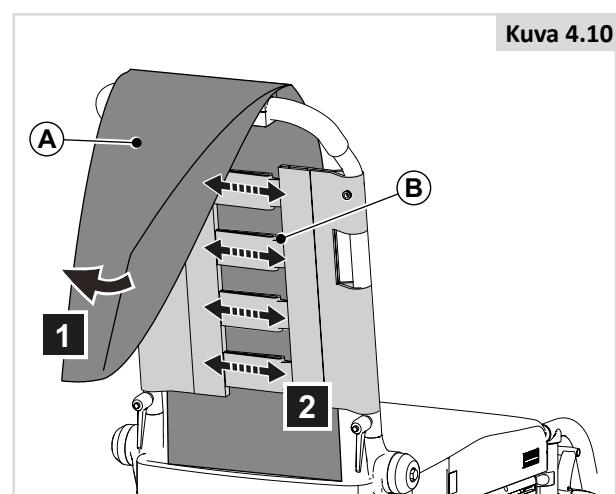

Kuva 4.10

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO

Seuraavan toimenpiteen saa suorittaa vain Sunrise Medicalin kouluttama ammattitaitoinen teknikko.

Jos pyörätuolissa on kallistettava selkänoja ja hihnat ovat liian löysät, voit säätää käyttölaitetta. Tässä tapauksessa voit kääntää käyttölaitetta 180 astetta luodaksesi enemmän tilaa (kuva 4.11).

1. Poista (A)
2. Käännä osaa (B).
3. Kiristä uudelleen (A)

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO

Kaapelilenkki on ehkä säädettyvä uudelleen.


Selkänojan joustavan sivuttaiskulman säätö (Kuva 4.12)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

Selkänojan kaareutuman säätö (Kuva 4.13)


Pyörätuoli on varustettu pehmustetulla selkänojalla, jonka kaarevuus voidaan säätää käyttäjän selän mukaisesti. Näin saavutetaan miellyttävä istuma-asento ja hyvä ajovakaus. Käyttäjä voi istua pyörätuolissa selkänojan kaareutuman säätöjä tehtäessä.

1. Avaa vetoketju
2. Vapauta hihna painamalla kohdasta A
3. Vapauta tai kiristä jokainen hihna erikseen
4. Vapauta A säilyttääksesi hihnan asetuksen

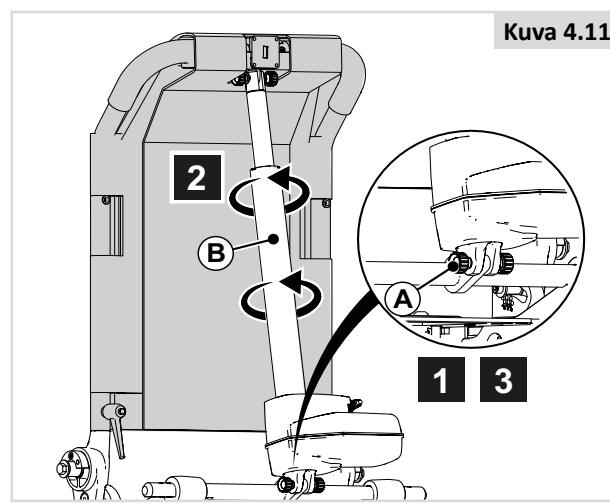


Kuva 4.11

SUOMI

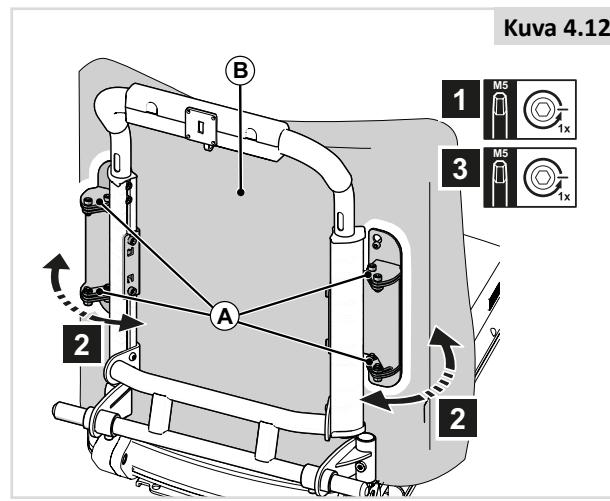


Kuva 4.12

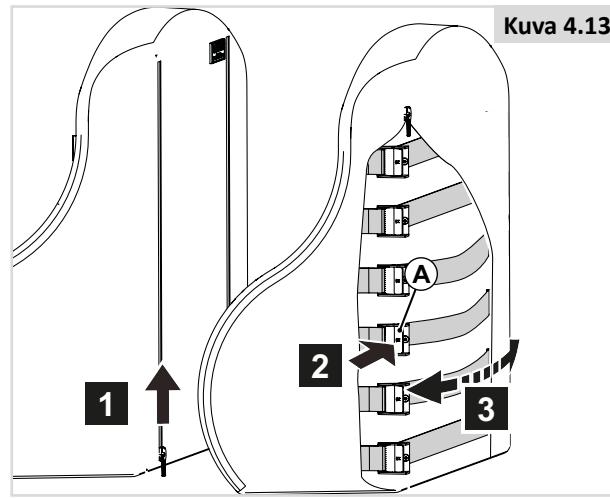

Kuva 4.13

J3-selkäosa, (kuva 4.14)

HUOMAUTUS: Jay 3 -selkänojaa voi käyttää yhdessä Sedeo Lite -istuinjärjestelmän kanssa. Katso asennus- ja säätöohjeet J3-selkäosan käyttöoppaasta.

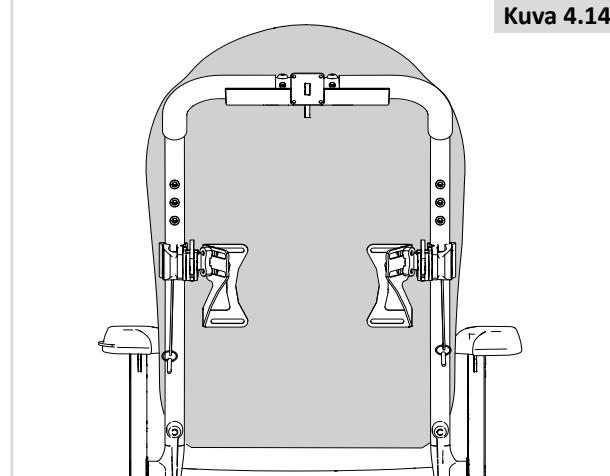

Kuva 4.14

4.4 Taakse kääntyvien käsinojen esisäätö

Käsinojen korkeus

Alustavat säädot ja hienosäätö suoritetaan kahdessa vaiheessa:

OSA 1 (Kuva 4.15)

1. Kierrä kohtaa (A), jotta voit säättää kohdan (B).

OSA 2 (Kuva 4.16)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

Käsinojan pehmusteenv syvyys (kuva 4.17)




1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

HUOMAUTUS

Jos taaimmaiseen säätöpulttiin on hankala päästä käsiksi käsinojan alhaisen asennon vuoksi, löysää ensin pulnit (A) (kuva 4.16) ja säädä ensin pehmusteenv kallistuskulma.

VAARA/VAROITUS!

Kaikkien pulppien kireys tulee tarkastaa säännöllisesti. Jos ne ovat löystyneet, kyynärnoja saattaa luiskahtaa alas kuormitettaessa.

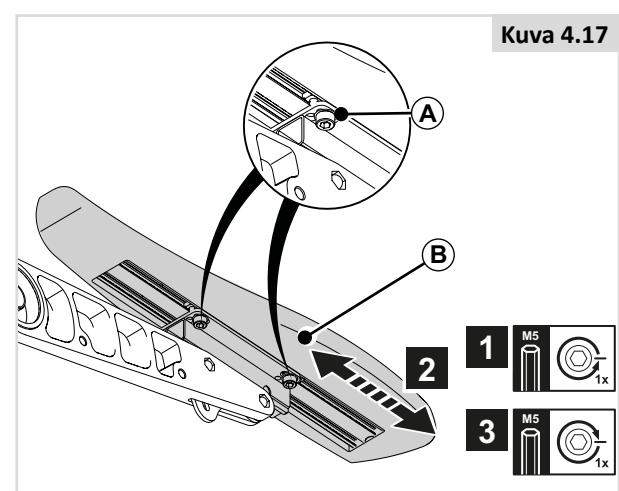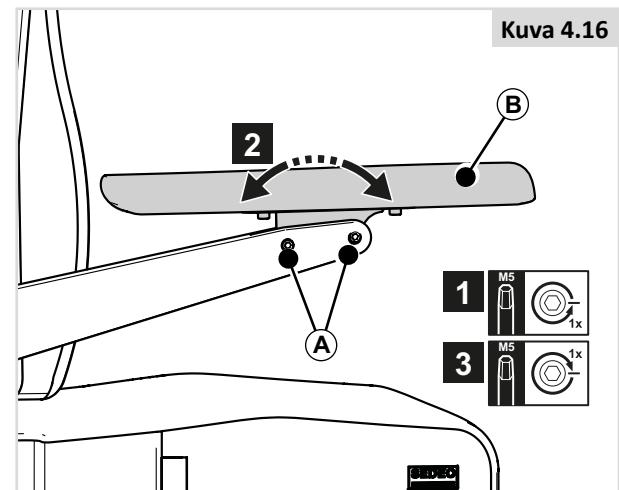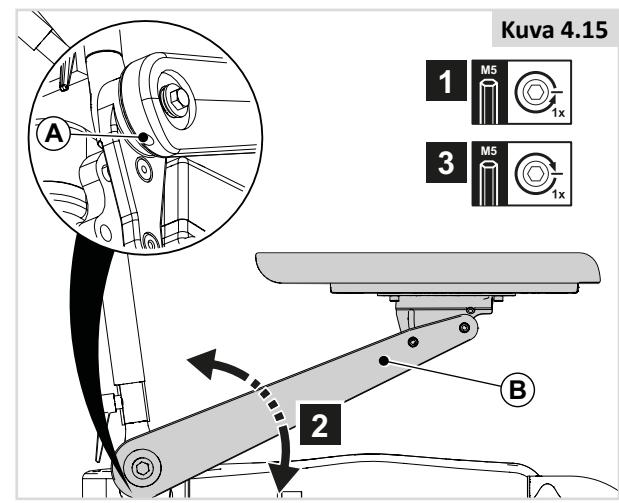


4.5 Keskikiinnitteisten käsinojen esisäätö

Käsinojan korkeus (kuva 4.18)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Käsinojan syvys (kuva 4.19)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Löysää (B).
3. Sääädä (C) haluttuun asentoon.
4. Kiristää (A) ja (B).

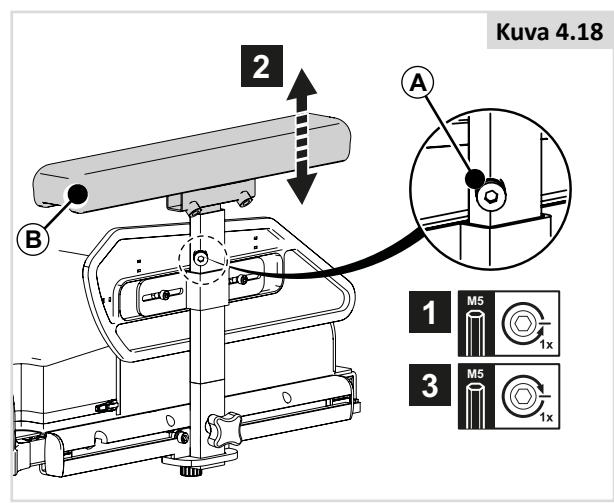

Kuva 4.18

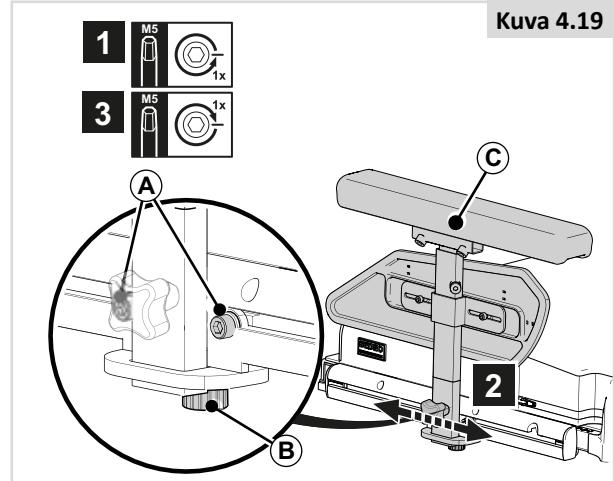

Kuva 4.19

4.6 Keskikiinnitteisten taakse kääntyvien käsinojen esisäätö

Käsinojan korkeus (kuva 4.20)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Varmista, että käsinojat tukevat käsiä hyvin ilman, että käyttäjän olkapäät nousevat ylöspäin.


Käsinojan syvys (kuva 4.21)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Siirrä taittuva käsinoja taaemaksi, jotta pyörätuoliin on helpompi nousta sivuttaissuunnassa. Siirrä käsinoja edemmäksi, jos käyttäjä tarvitsee enemmän tukea siirtyessä pyörätuolista etusuunnassa.

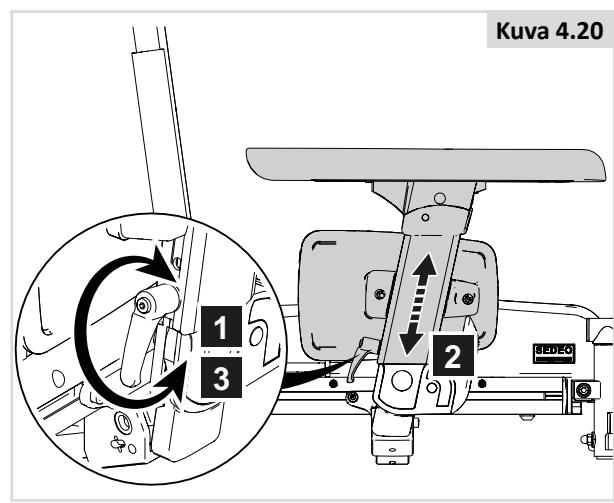

Kuva 4.20

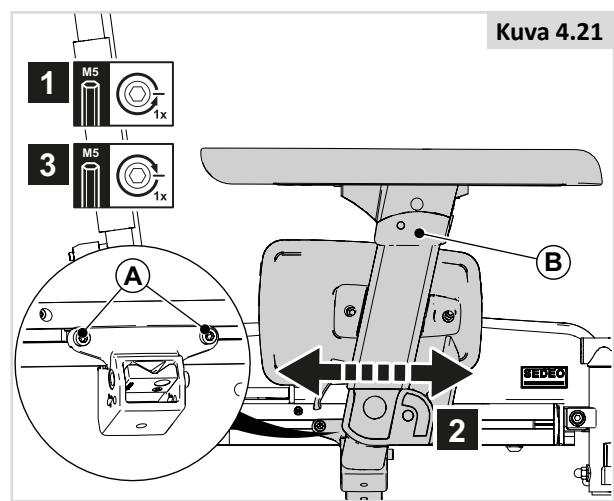



Kuva 4.21

Käsinojan kulma (kuva 4.22)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).


Sivusuojan korkeus (kuva 4.23)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

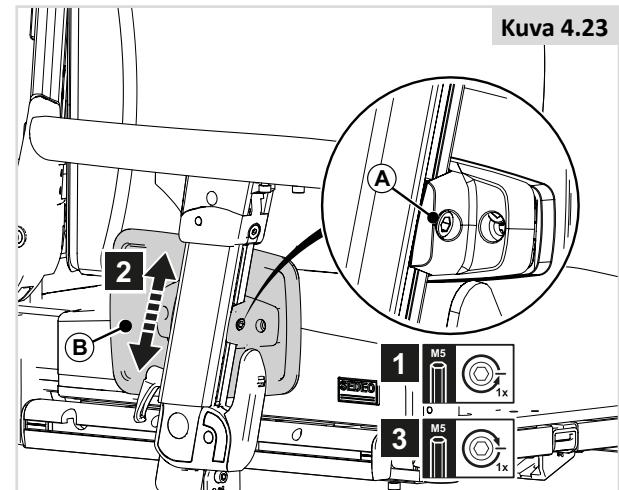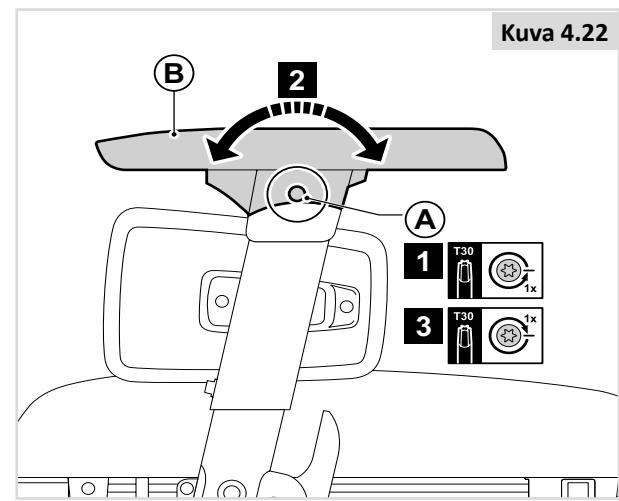

Käsinojan pehmusteiden syvyys (kuva 4.24)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

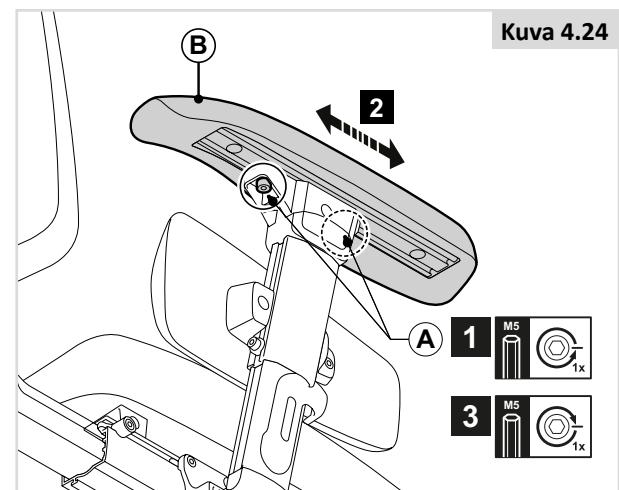

Käsinojan pehmusteiden leveys (kuvat 4.25-4.28)

Kuva 4.25

Poistaminen:

1. Löysää (A).
2. Poista (B).
3. Löysää (E) yhden kierroksen verran.
4. Poista (F).


Asennus:

1. Liu'uta (A) yhdessä B:n tai C:n kanssa kohtaan D.


HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että riviliittimessä oleva ura kohdistuu aukkoon.


1. Säädä osan (A) syvyyts ja kiristä (E).
2. Kohdista ohjaimen pidike.
3. Kohdista käsinoja.

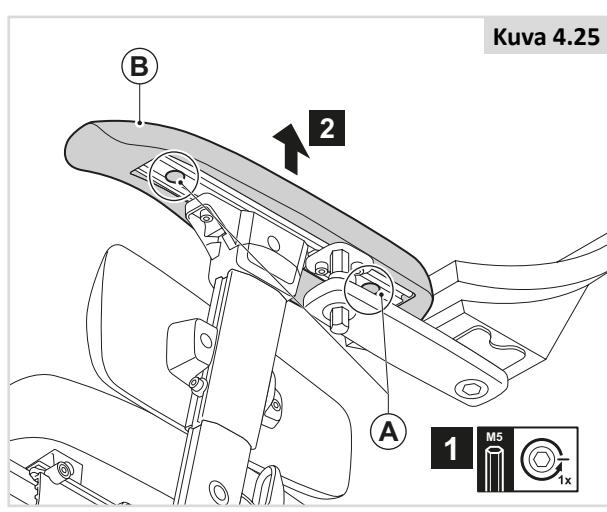


Kuva 4.26

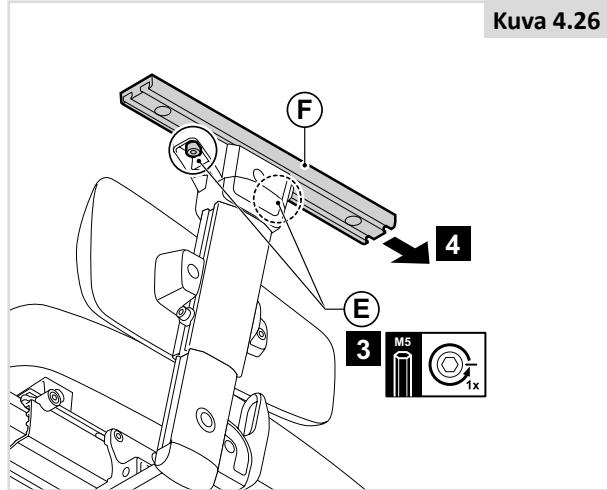

Kuva 4.27

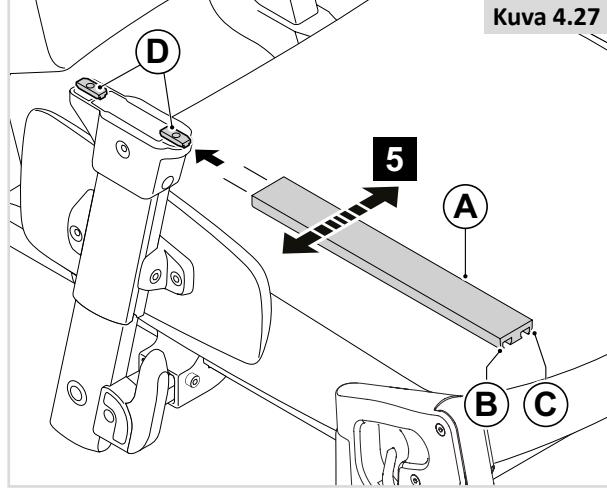

Kuva 4.28

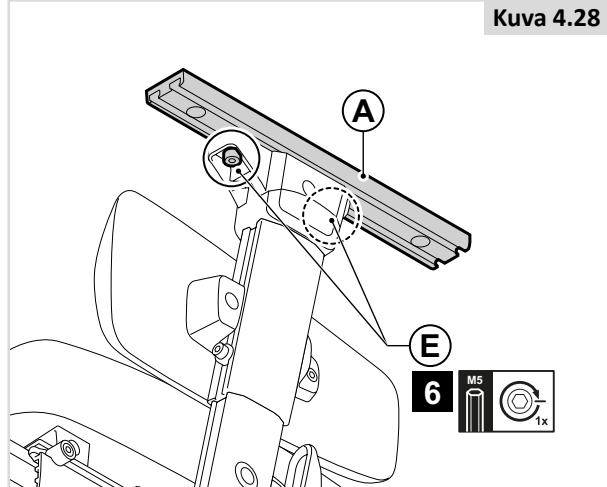



4.7 Sivulaita

Sivusuojan korkeus (kuva 4.29)

1. Poista (A).
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

Sivusuojan syvys (kuva 4.30)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

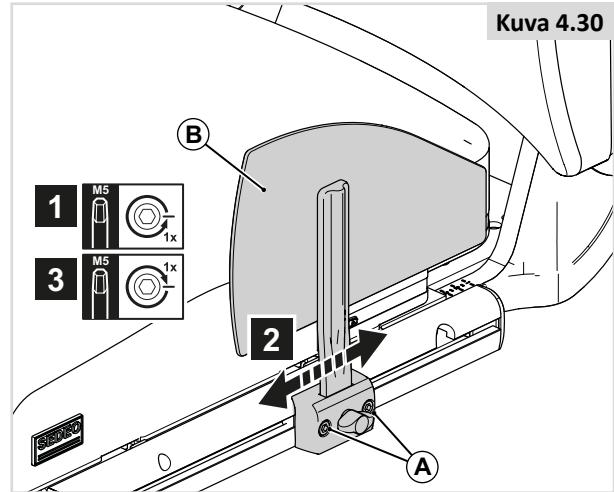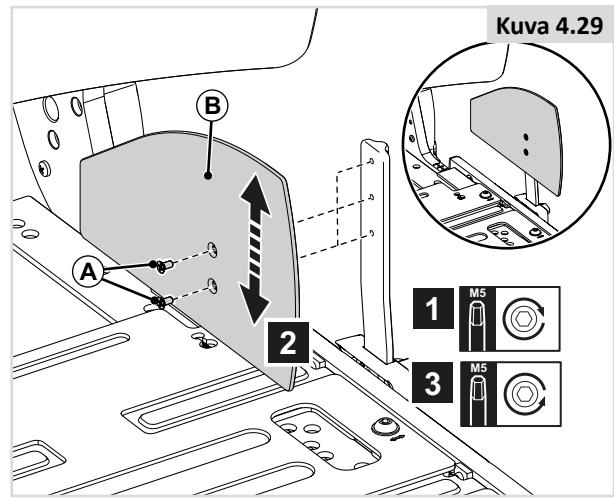

4.8 Määritä keskikiinnitteisen jalkatuen asetukset

Kuva 4.31

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.31)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

⚠️ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että kohdan (B) alla on riittävästi tilaa, jotta pyörätuolilla pystyy ajamaan esteiden ylitse.

Polven kulma (kuva 4.32)

1. Löysää (A) kahden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

⚠️ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Muuta korkeus tai polven kulma, jos jalkalevy ottaa kiinni etupyöriin.

Nilkan kulma (kuva 4.33)



1. Käännä ylös (A).
2. Käännä (B) ja säädä nilkan kulma haluttuun asentoon.
3. Taita (A) alas.

Pohjetuen korkeus (kuva 4.34)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

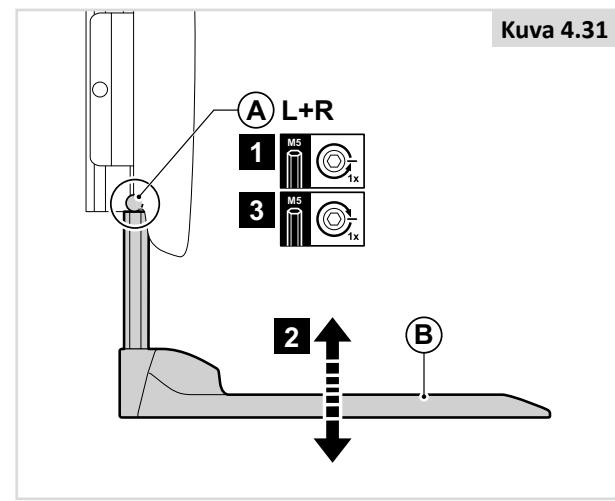

Kuva 4.32

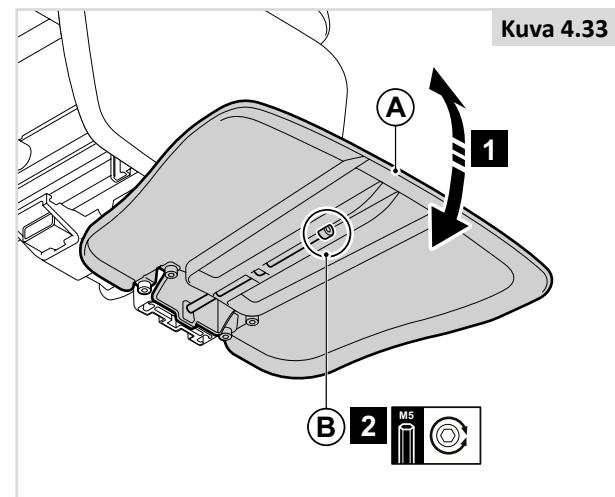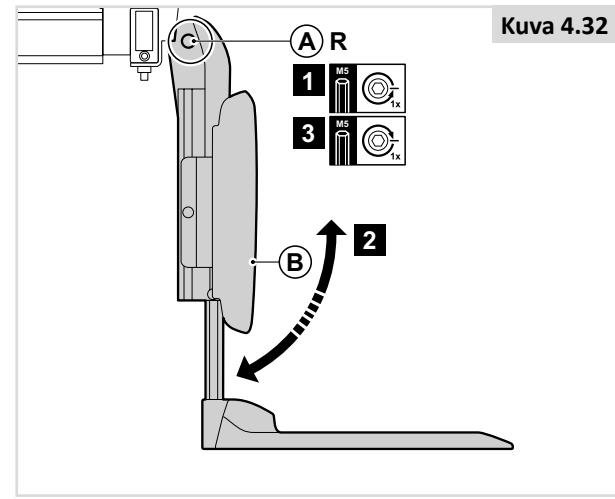


Kuva 4.34

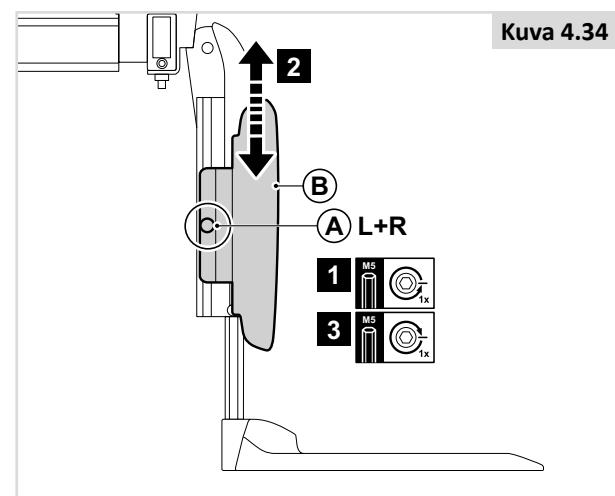

4.9 Kiinteästi asennetun keskiinnitteisen jalkatuen esiasetus

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.35)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A)
4. Toista samat työvaiheet pyörätuolin toisella puolella.

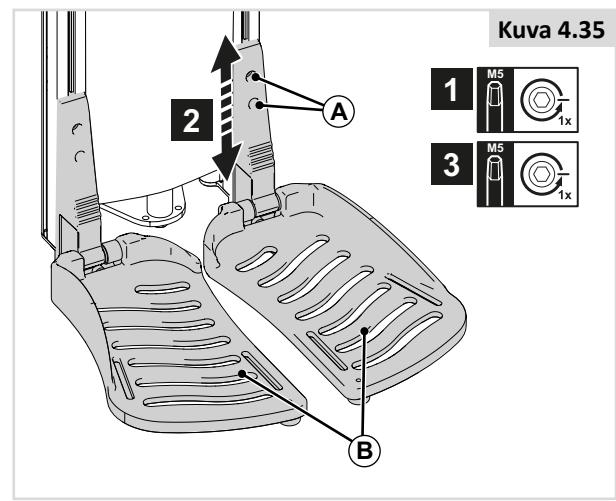


Nilkan kulma (kuva 4.36)

1. Käännä ylös (A).
2. Käännä (B) ja säädä nilkan kulma haluttuun asentoon (4 mm kuusikokoluavain)
3. Taita (A) alas.

VAARA/VAROITUS!

- Kun säädöt on suoritettu ja istuin on tavallisessa ajoasennossa: Varmista, että jalkalevyn ja maanpinnan väliin jää aina riittävästi tilaa (> 25 mm).
- Suorita testi käyttäjän istuessa pyörätuolissa ja kuormittaessa jalkalevyjä.
- Pyörätuolin käyttäminen jalkatuet liian alhaalle asennettuina voi johtaa henkilövahinkoihin ja vaurioittaa pyörätuolia sekä ympäristöä.

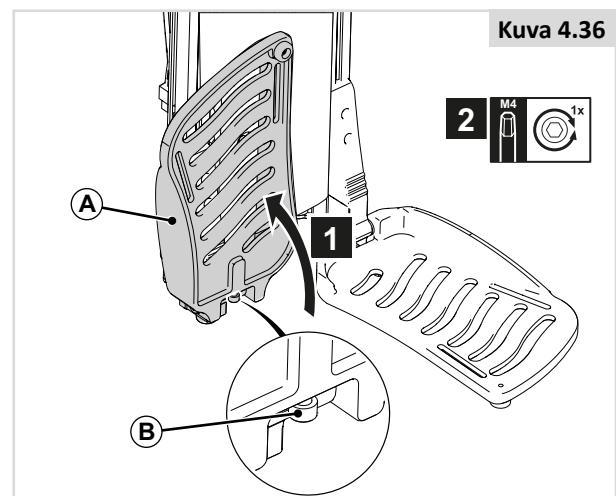


Pohjetynyn korkeus (kuva 4.37)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (C) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Pohjetynyn leveys (kuva 4.37)

4. Löysää (B) yhden kierroksen verran.
5. Sääädä (C) haluttuun asentoon.
6. Kiristää (B).

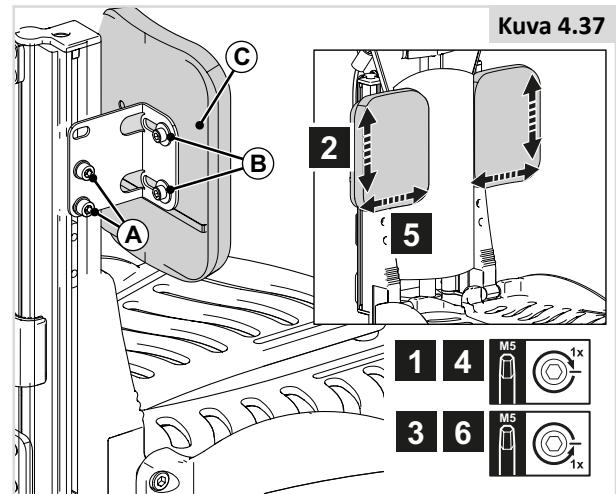

4.10 Määritä moottoroidun keskikiinnitteisen jalkatuen asetukset

! VAARA/VAROITUS!

- Varmista jalkatukia käyttäässäsi, etteivät ne voi ottaa mihinkään kiinni ja vaarioitaa siten jalkojasi.
- Varmista aina ennen pyörätuolilla ajamista, etteivät jalkatuet tai jalkalevy kosketa käännyviin etupyöriin.
- Pyörätuolia ei saa nostaa tai kantaa jalkatuista missään tapauksessa.
- Kuten kaikkien liikkuvien osien kanssa, varo etteivät sormesi jäädä puristuksiin (kuva 4.40).

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.39)

Moottoroitu keskikiinnitteinen jalkatuki voidaan säätää 90–180° kulmassa maanpintaan nähden ja mahdollistaa 180 mm:n sähkökäytöisen pidennynksen.

- Löysää (A) yhden kierroksen verran.
- Säädä (B) haluttuun asentoon.
- Kiristä (A).
- Toista samat työvaiheet pyörätuolin toisella puolella.

Nilkan kulma (kuva 4.40)

- Käännä ylös (A).
- Käännä (B) ja säädä nilkan kulma haluttuun asentoon (4 mm kuusikoloavain)
- Taita (A) alas.

! VAARA/VAROITUS!


- Kun säädöt on suoritettu ja istuin on tavallisessa ajoasennossa: Varmista, että jalkalevyn ja maanpinnan väliin jäädä aina riittävästi tilaa (> 25 mm).
- Suorita testi käyttäjän istuessa pyörätuolissa ja kuormittaessa jalkalevyjä.
- Pyörätuolin käyttäminen jalkatuet liian alhaalle asennettuna voi johtaa henkilövahinkoihin ja vaarioitaa pyörätuolia sekä ympäristöä.

Pohjetynyn korkeus (kuva 4.41)


- Löysää (A) yhden kierroksen verran.
- Säädä (C) haluttuun asentoon.
- Kiristä (A).

Pohjetynyn leveys (kuva 4.41)


- Löysää (B) yhden kierroksen verran.
- Säädä (C) haluttuun asentoon.
- Kiristä (B).

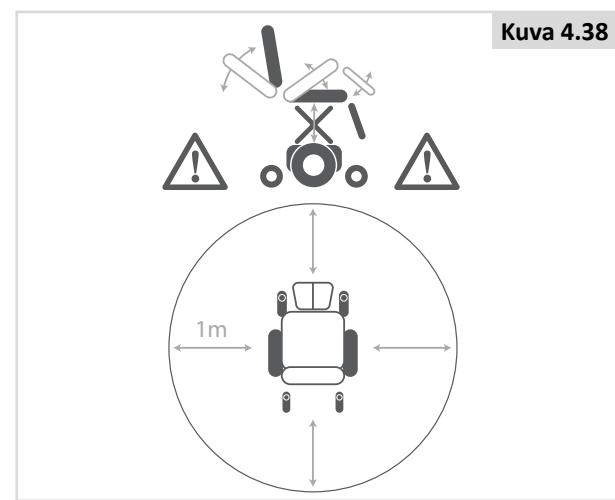


Kuva 4.38

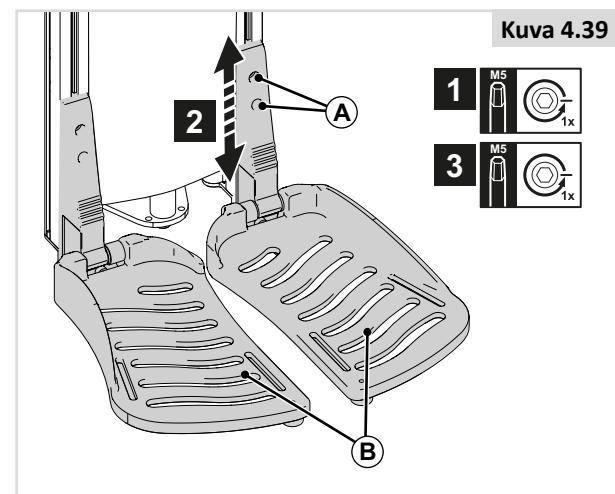

Kuva 4.39

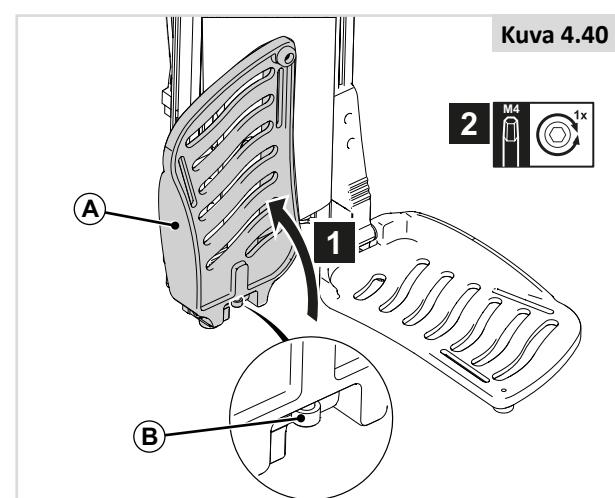

Kuva 4.40

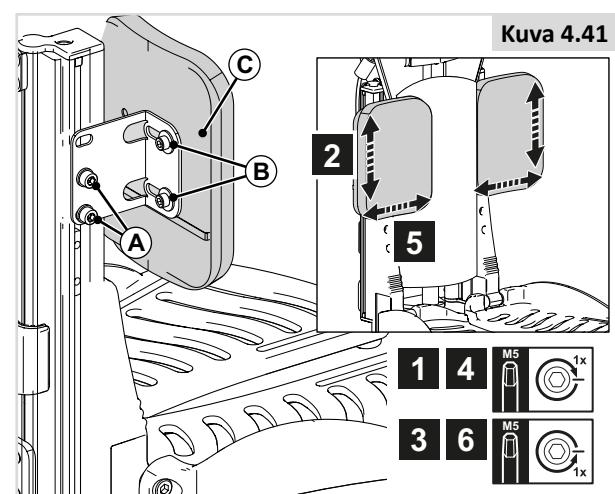

Kuva 4.41

4.11 Sivulle kääntyvien SEDEO LITE -jalkatukien esisäätö

Jalkatuen leveys (kuva 4.42)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.43)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).



HUOMAUTUS/HUOMIO!

- Varmista, että kohdan (B) alla on riittävästi tilaa, jotta pyörätuolilla pystyy ajamaan esteiden ylitse.

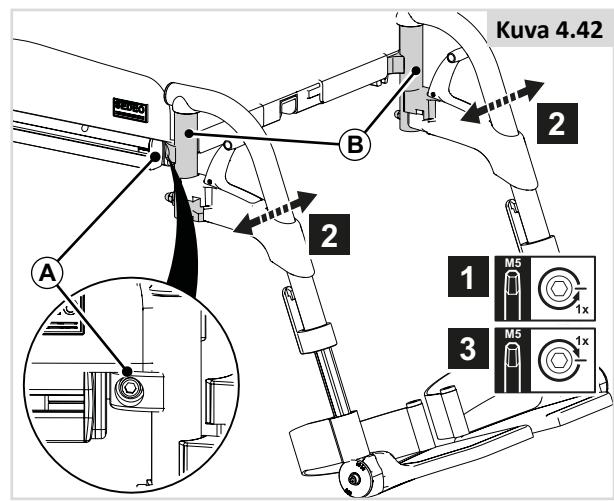

Nilkan kulma (kuva 4.44)

1. Löysää (A) muutaman kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

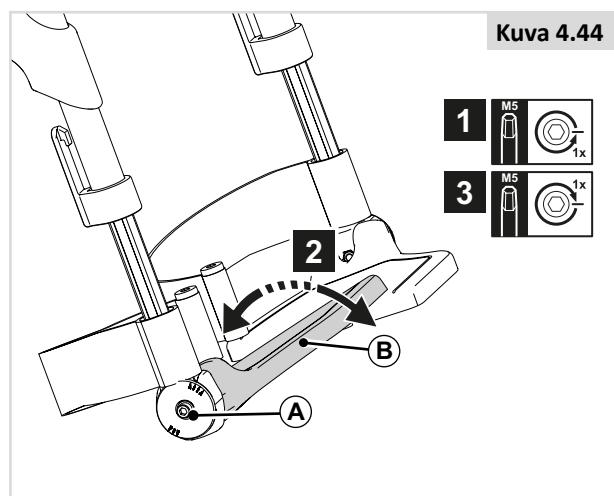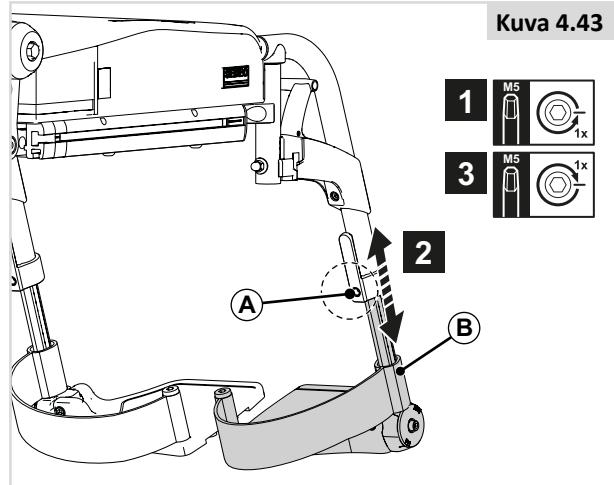


4.12 Sivulle kääntyvän UNI-jalkatuen esisäätö

Jalkatuen leveys, katso kuva 4.42

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.45)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

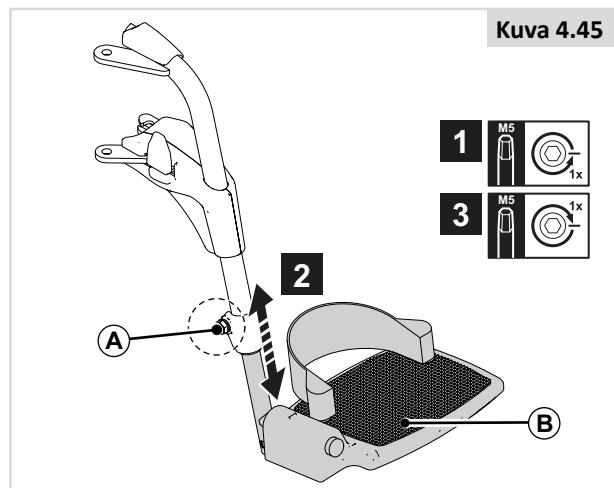

4.13 Määritä taittuvien jalkatukien asetukset

Jalkatuen leveys (kuva 4.46)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Säätö säären pituuden mukaan (Kuva 4.47)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että kohdan (B) alla on riittävästi tilaa, jotta pyörätuolilla pystyy ajamaan esteiden ylitse.

Nilkan kulma (kuva 4.48)

1. Löysää (A) muutaman kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Polven kulma, manuaalisesti/sähkötoimisesti nostettavat jalkatuet (kuva 4.49)

Jalkalevyjen asentoa voi muuttaa polven kulmaa säätämällä.


1. Löysää (A) muutaman kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

⚠ VAARA/VAROITUS!


- Sormet voivat jäädä puristukseen! Älä laita sormiasi säätmekanismin liikkuvien osien väliin nostaaessasi tai laskiessasi jalkatukia.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Muuta korkeus tai polven kulma, jos jalkalevy ottaa kiinni etupyöriin.

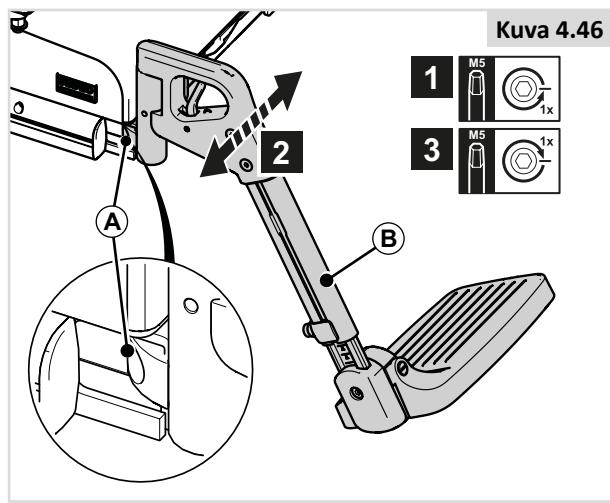


Kuva 4.46

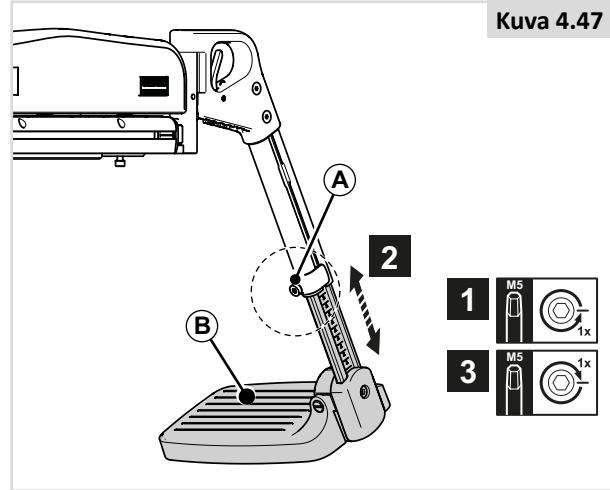

Kuva 4.47

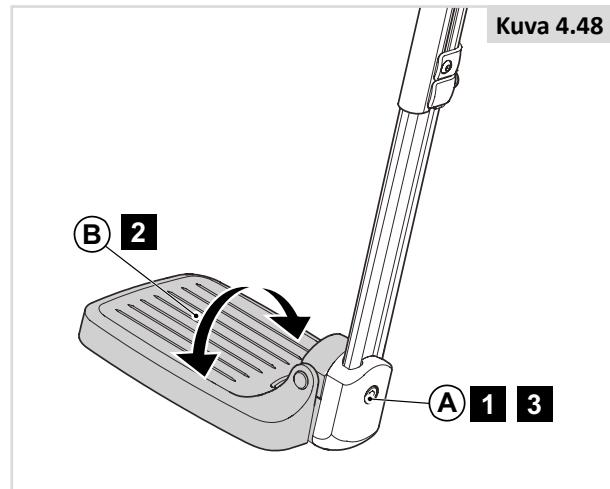

Kuva 4.48

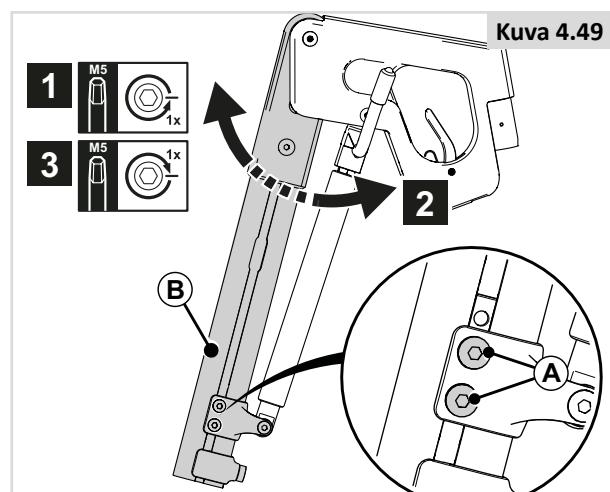

Kuva 4.49

Pohjetyynyn korkeus (kuva 4.50)


1. Löysää (A) muutaman kierroksen verran.
2. Säädä (D) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

Pohjetyynyn syvyys (kuva 4.50)

4. Löysää (B) muutaman kierroksen verran.
5. Säädä (D) haluttuun asentoon.
6. Kiristä (B).

Pohjetyynyn leveys (kuva 4.50)

7. Löysää osan (D) takaosassa olevaa osaa (C) muutaman kierroksen verran.
8. Säädä (D) haluttuun asentoon.
9. Kiristä (C).

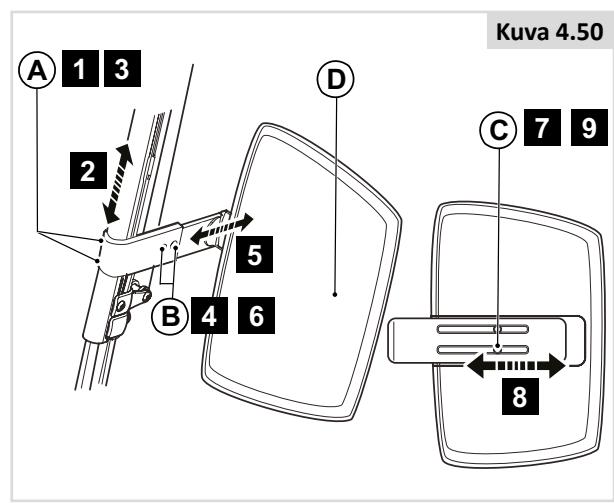

Kuva 4.51


4.14 Määritä päätuen asetukset

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Jos pyörätuolin käyttäjää varten on valittu päätuki, hän ei saa koskaan ajaa pyörätuolia ilman päätukea.
- Älä koskaan käytä pyörätuolia ilman päätukea, jos pyörätuolissa istuvaa henkilöä kuljetetaan ajoneuvossa.

Päätuen korkeus (kuva 4.51)


1. Löysää (A) muutaman kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

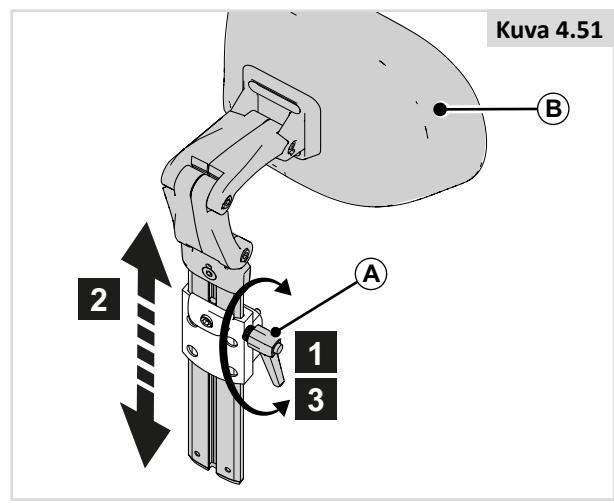

Kuva 4.52

Muistiasetus (kuva 4.52)

1. Löysää (C) yhden kierroksen verran.
2. Liu'uta (D) niin alas kuin mahdollista.
3. Kiristä (C).

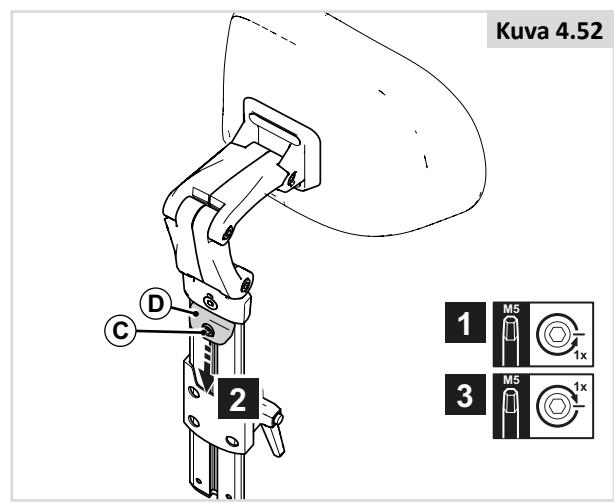


Kuva 4.52

Päätuen asento (kuva 4.53)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Säädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristä (A).

⚠️ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Korja päätuen korkeus ja kallista päätuen tyyny haluttuun asentoon.

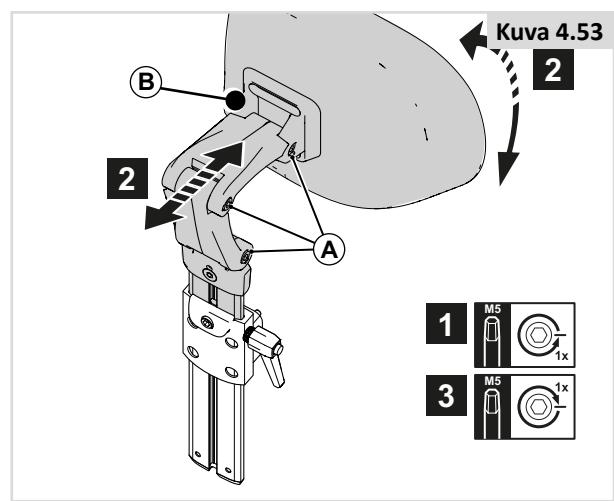

Kuva 4.53

Pääntuen tyynyn leveyden säätö (kuva 4.54)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

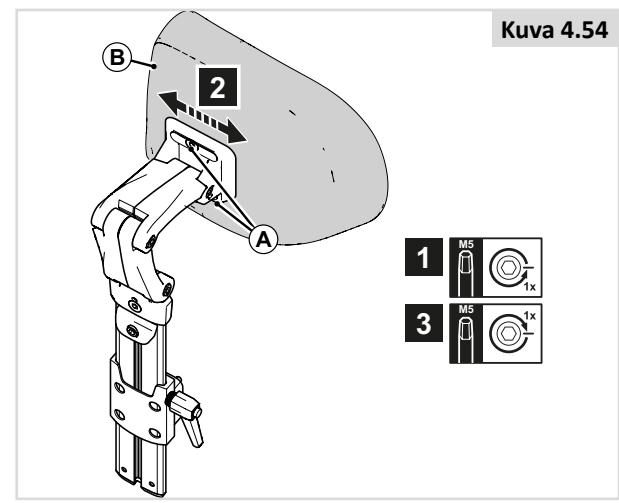

Kuva 4.54


4.15 Määritä kiinteän / sivulle taittuvan ohjaimen pidikkeen asento

Ohjaimen syvyys (kuva 4.55)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Ohjaimen korkeus (1) (kuva 4.56)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

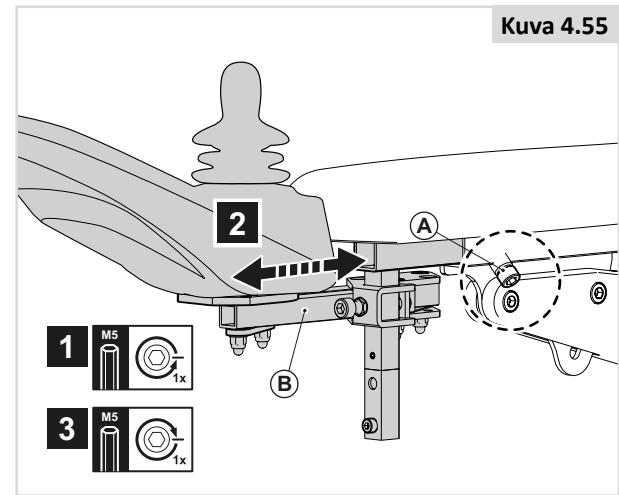

Kuva 4.55

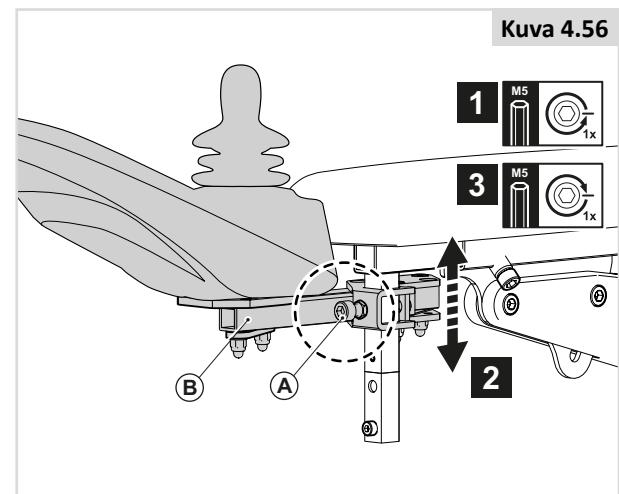


Kuva 4.56

4.16 Sivulle käännyvän ohjaimen esisäätö

Kuva 4.57


Ohjaimen syvyys (kuva 4.57)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

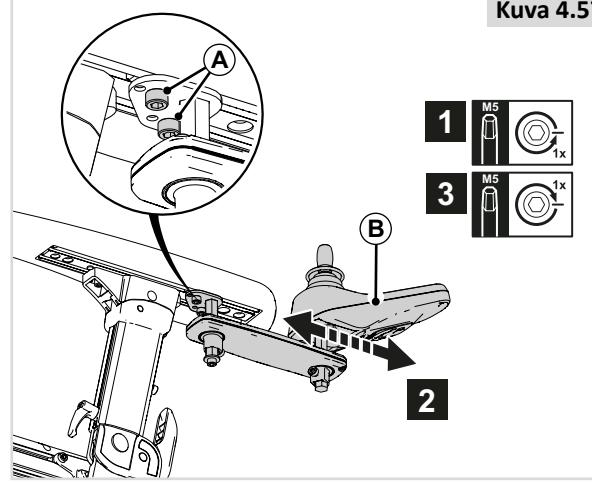


Ohjaimen korkeus (1) (kuva 4.58)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

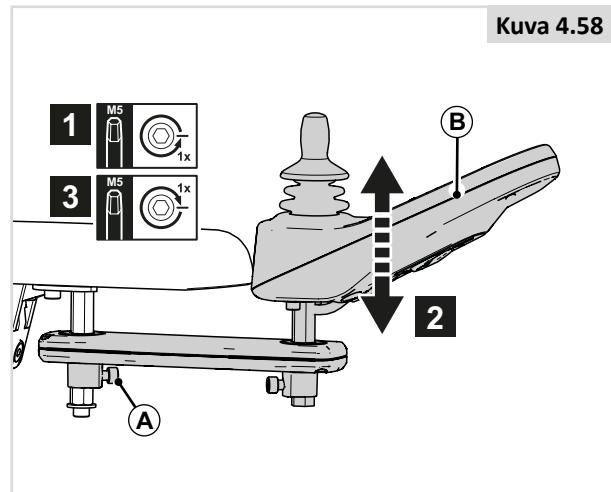

Kuva 4.58

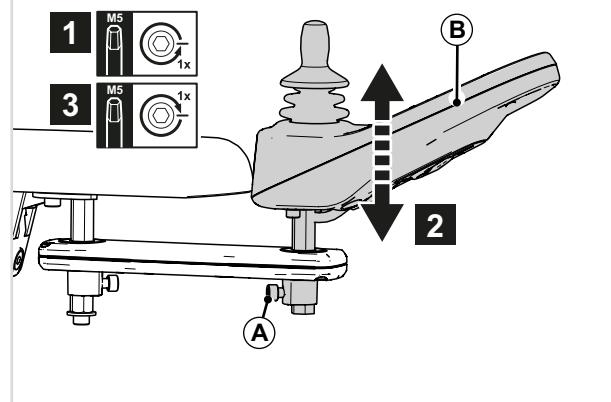

Kuva 4.59

4.17 Määritä sivutukien asetukset

Sivutukien korkeus (kuva 4.60)




1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Sivutukien syvyys (kuva 4.61)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).
4. Löysää (C) yhden kierroksen verran.
5. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
6. Kiristää (C).

Sivutukien kallistuskulma (kuva 4.62)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).
4. Löysää (C) yhden kierroksen verran.
5. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
6. Kiristää (C).

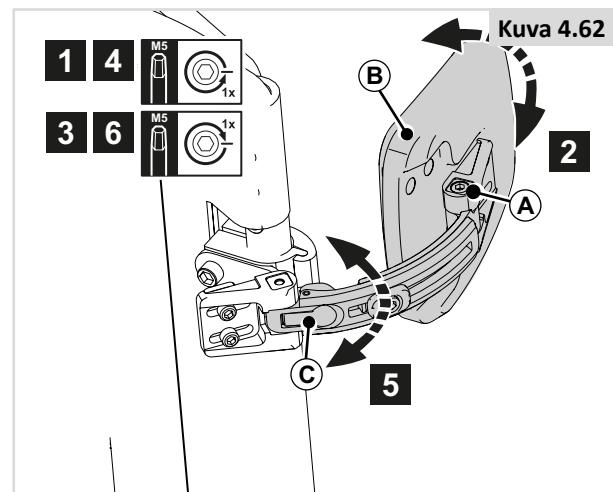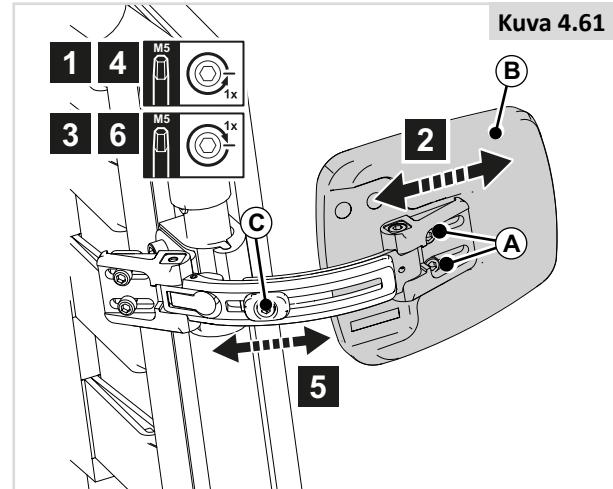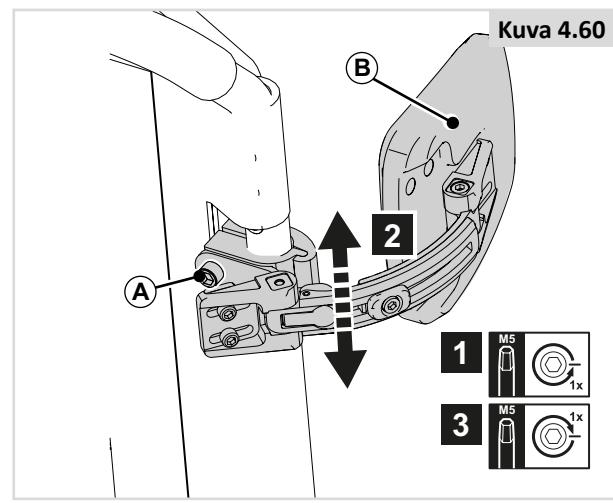


4.18 Määritä sivulle käännettävän polvi/reisituen asetukset

Tuki voidaan asentaa kahteen eri asentoon tukemaan polvea tai reittää (kuva 4.63)

Asennus reisitueksi (kuva 4.63 ja 4.64)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

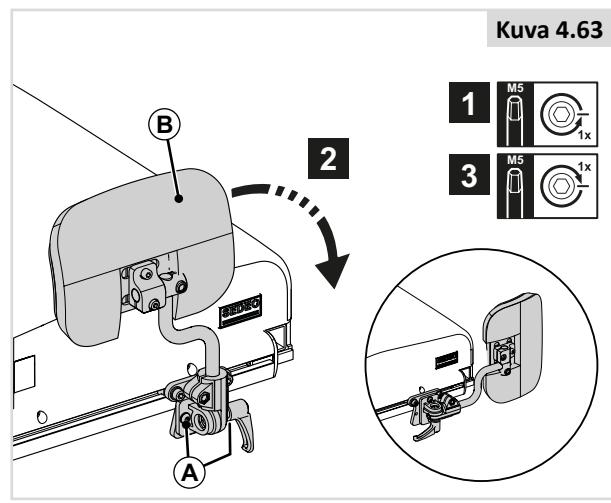

Kuva 4.63


4.19 Määritä haarakiilan asetukset

Haarakiilan korkeus (kuva 4.65)


1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

Haarakiilan syvyys (kuva 4.66)

1. Löysää (A) yhden kierroksen verran.
2. Sääädä (B) haluttuun asentoon.
3. Kiristää (A).

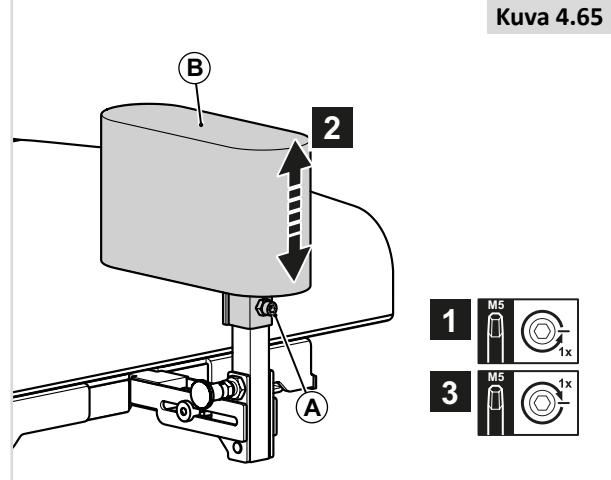

Kuva 4.65

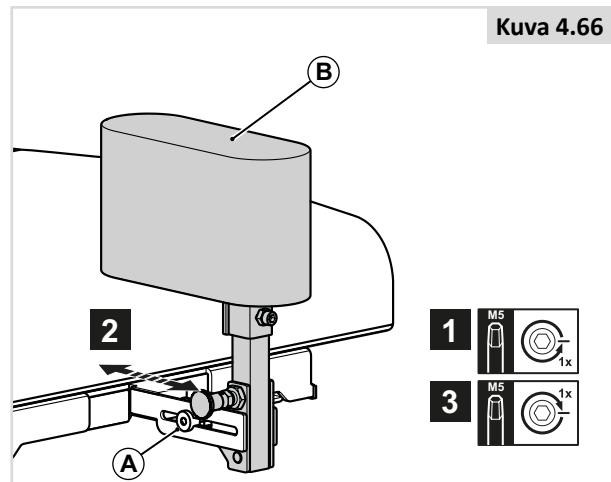

Kuva 4.66

4.20 Lantio-/tukivyö

Kuva 4.67

⚠️ VAARA/VAROITUS!


- Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yhden käyttäjän asennon varmistamiseksi pyörätuolissa.
- Lantiovyöt eivät soveltu ajoneuvossa kuljetuksen aikaiseksi turvajärjestelmäksi. Kuljetuksen aikana on käytettävä hyväksyttyä käyttäjän kiinnitysjärjestelmää.
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
- Varmista, että hoitaja tai avustaja on saanut tukivöiden käyttöön liittyvän asianmukaisen opastuksen.
- Jos hoitajalle tai avustajalle ei ole annettu asianmukaista opastusta, hän ei välttämättä pysty reagoimaan riittävän nopeasti hätätilanteissa.

Lantio-/tukivyön asennus


1. Kiinnitä (A) istuimen runkoon sen molemmilla puolilla olevien ruuvien avulla. (Kuva 4.68)

Lantiovyön käyttäminen


- Säädä lantiovyö siten, että käyttäjä pystyy pujottamaan kätensä kiinnitetyn vyön väliin; näin vyö istuu mukavasti ja on turvallinen (Kuva 4.69).
- Käden tulee mahtua vyön väliin vyön ollessa normaalikireydessä. Suuria välyksiä tai kierteitä ei saa esiintyä.
- Lantiovyö tulisi asentaa siten, että vyö on noin 45° kulmassa (Kuva 4.70). Lantiovyö on säädetty oikein, kun se estää käyttäjän valumisen alaspäin istuimella.
- Vasenkätilinen käyttäjä: aseta lantiovyö vapaasti istuimelle siten, että soljen pää osoittaa oikealle; oikeakätilinen käyttäjä: soljen pää osoittaa vasemmalle. Pujota istuinvoiden päät selkänojan pystypukien ja selkänojan välistä.

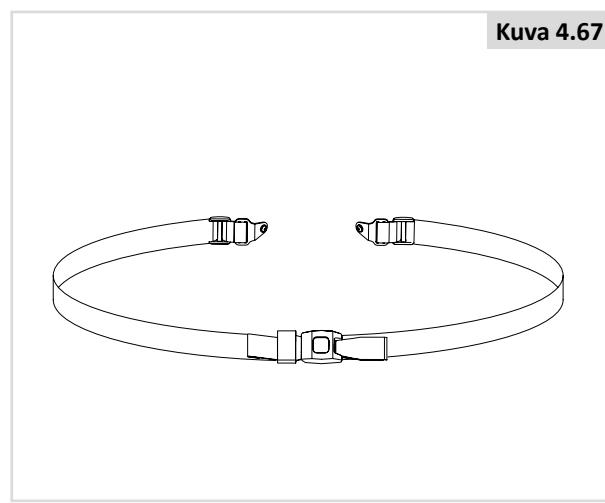


Kuva 4.68

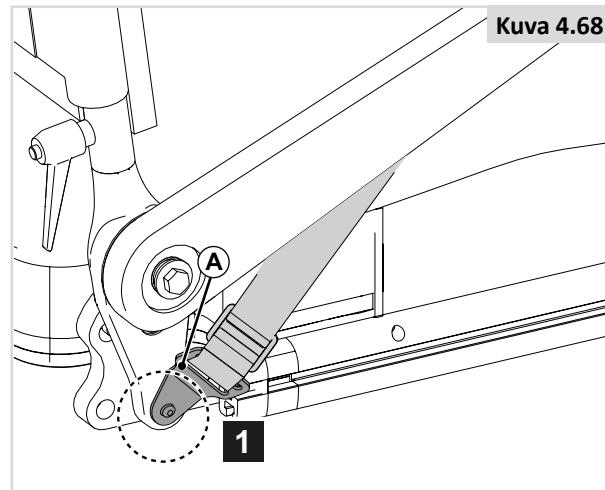

Kuva 4.69

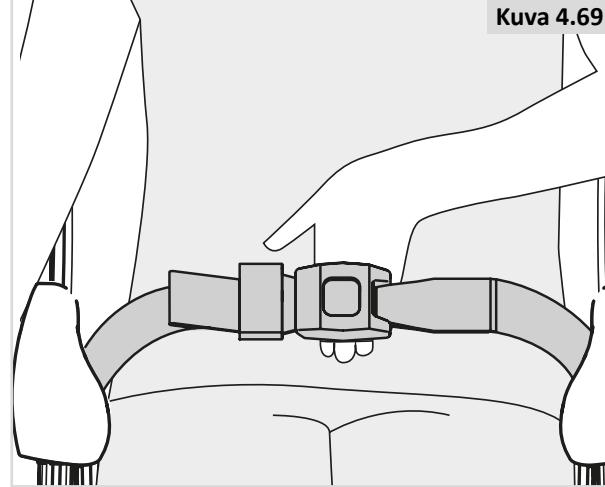

Kuva 4.70

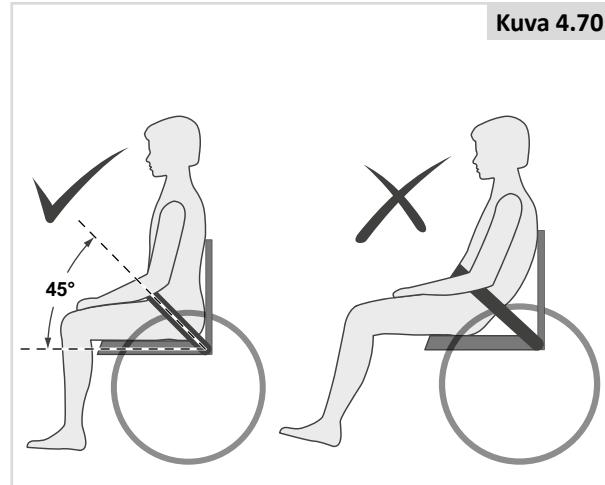

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Varmista aina ennen pyörätuolin käyttöä, että lantiovyö on säädetty ja kiinnitetty oikein.
- Jos hihna on liian löysällä, käyttäjä voi valua istuimella alaspäin ja saada vakavia vammoja.
- Tarkasta lantiovyö ja vyön kiinnityskohdat säännöllisesti kulumien ja vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Tarkasta huollon yhteydessä, että solki toimii oikein ja että vyön ja solkien materiaali ei ole kulunut.
- Säännölliset tarkastukset/tehtävät:
- Kaikkien kiinnikkeiden tapaan näitäkin kiinnikkeitä on aika ajoin säädettävä, sillä pyörätuolin käyttäjän istuma-asento muuttuu ajan myötä.
- Tarkasta säännöllisin väliajoin, että vyöt istuvat oikein. Näin takaat käyttäjän turvallisuuden ja käytönmukavuuden.

5.0 Pyörätuolin käyttäminen

Kuva 5.1


5.1 Pyörätuoliin siirtyminen ja poistuminen

Sunrise Medical suosittelee, että kehität yhdessä lääkintähenkilösi kanssa parhaan tavan siirtyä pyörätuoliin / pois pyörätuolista joko etu- tai sivusuunnasta välttääksesi mahdolliset loukkantumiset.


VAARA/VAROITUS!

Nämä estät kaatumisen:

- Varmista että ohjauslaitte on kytketty pois päältä pyörätuoliin/ pyörätuolista nostessasi. Nämä pyörätuoli ei pääse vahingossa liikkumaan. Jos se jää tekemättä, saatat tahtomattasi koskettaa ohjainsauvaa ja aiheuttaa pyörätuolin liikkumisen silloin, kun et odota sitä.
- Varmista, että vapaakytkimen vipu on asetettu ajotilaan, Yleinen käyttöopas.
- Käännä etupyörät niin, että ne osoittavat eteenpäin.
- Tee yhteistyötä lääkintähenkilösi kanssa oppiaksesi kaikki turvalliset siirtymistavat.
- Varmista että moottorijarrut on aktivoitu. Tämän ansiosta pyörätuoli pysyy siirtymisen yhteydessä paikallaan.
- Siirtyminen pyörätuoliin ilman avustajaa on vaarallista. Se vaatii hyvää tasapainoa ja ketteryyttä. Huomaa, että jokaiseen siirtymiseen sisältyy hetki, jolloin istuin ei ole allasi.
- Opettele tukemaan vartaloasi siirtymien yhteydessä.
- Pyydä harjoittelun apua, kunnes olet varma, että pystyt siirtymään pyörätuoliin/tuolista turvallisesti ilman ulkopuolista apua.
- Älä nouse seisomaan jalkatuen varaan. Jos annat koko painosi kohdistua jalkatukeen, pyörätuoli voi vaurioitua ja seurausena voi olla erilaisia vaaratilanteita mukaan lukien pyörätuolin kaatuminen.
- Varmista, etteivät jalkasi jää kiinni jalkatukien väliseen tilaan.

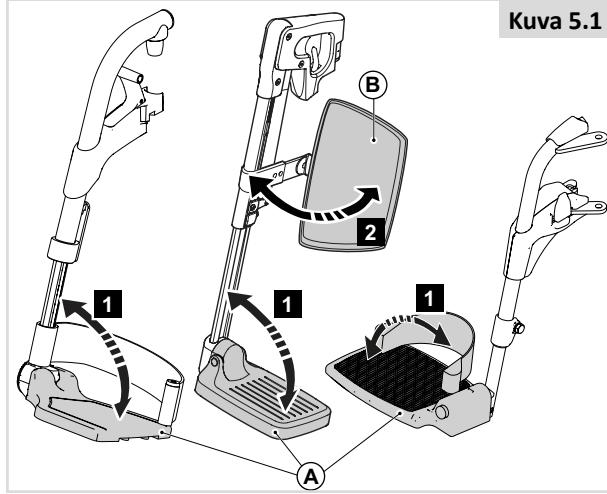

Kuva 5.1

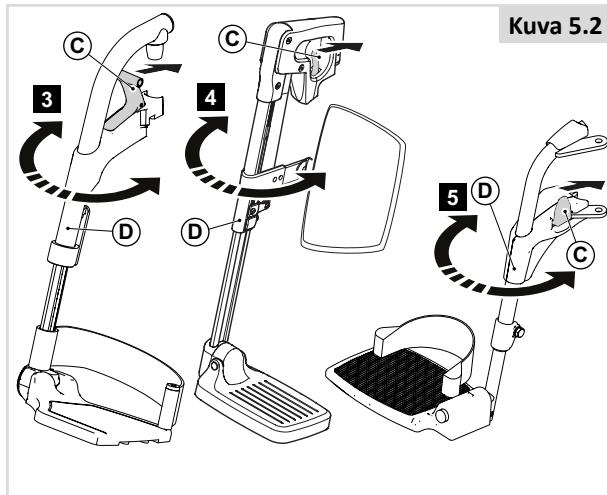


Kuva 5.2

5.2 Valmistautuminen pyörätuoliin siirtymiseen etusuunnassa

VAARA/VAROITUS!

Siirrä pyörätuoli mahdollisimman lähelle istuinta, jolle haluat siirtyä.

Taittuvat jalkatuet (kuva 5.1 ja 5.2)

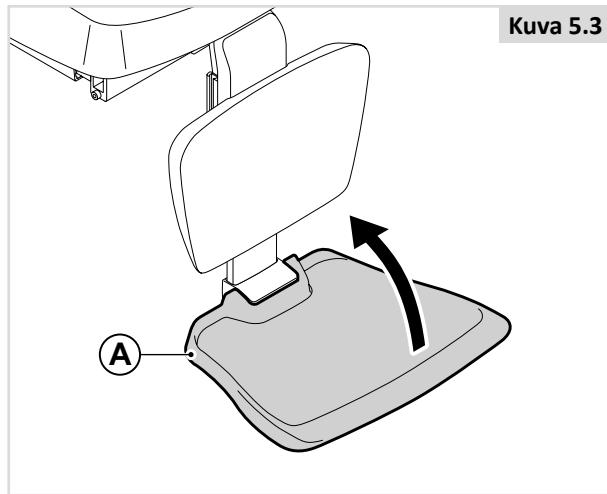

Kuva 5.3

1. Taita jalkalevyt (A) ylös.

2. Käännä pohjetuet (B) sivuille (jos asennettu)

SIVULLE KÄÄNTYVÄT SEDEO LITE -JALKATUET

3. Jos mahdollista, työnnä (C) taakse ja käännä jalkatuet (D) sivuille.

SIVULLE KÄÄNTYVÄT UNI-JALKATUET

4. Jos mahdollista, työnnä (C) taakse ja käännä jalkatuet (D) sivuille.

SIVULLE KÄÄNTYVÄT SEDEO PRO -JALKATUET

5. Jos mahdollista, työnnä (C) taakse ja käännä jalkatuet (D) sivuille.

Keskikiinnitteinen jalkatuki (Kuva 5.3)

1. Käännä ylös (A).

Moottoroitu keskikiinnitteinen jalkatuki (Kuva 5.4)

1. Käännä ylös (A) x 2.

5.3 Valmistautuminen siirtymiseen sivusuunnassa

Kuva 5.4

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Siirrä pyörätuoli mahdollisimman lähellä istuinta, jolle aiot siirtyä. Jos mahdollista, käytä apuna siirtymislevyä.
- Siirry istuimella niin taakse, kuin mahdollista. Nämä minimoit putoamisen tai ohi istumisen riskin.

⚠️ HUOMAUTUS/HUOMIO!

- Jotkin ohjainmallit on käännettävä sivulle.
- Poista pöytälevy ennen kuin taitat käsinojan taakse.
- Älä nojaa taakse taitettuun käsinojaan.

Taakse taittuva käsinoja (kuva 5.5)





- Taita (A) taakse.

Keskiinnitteinen Sedeo Lite -käsinoja (kuva 5.6)

- Löysää A.
- Poista B.

Keskiinnitteinen taakse taittuva käsinoja (kuva 5.7)


- Paina (A).
- Taita (B) taakse.

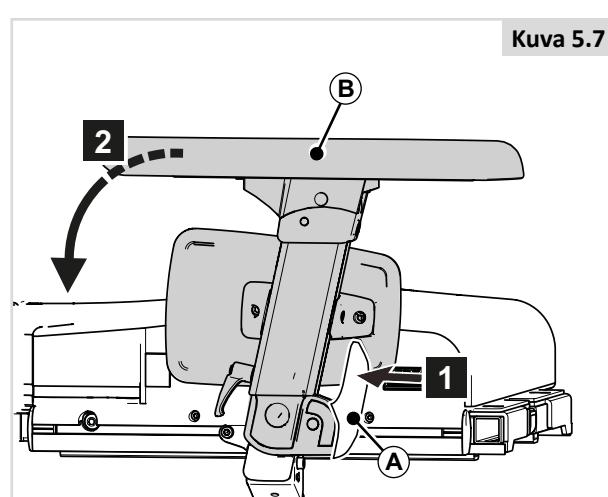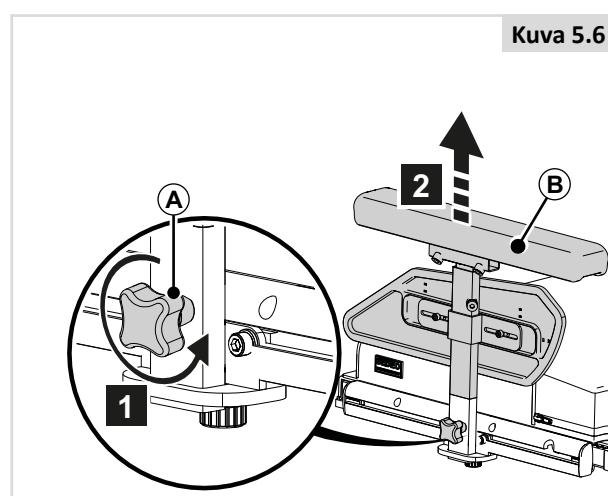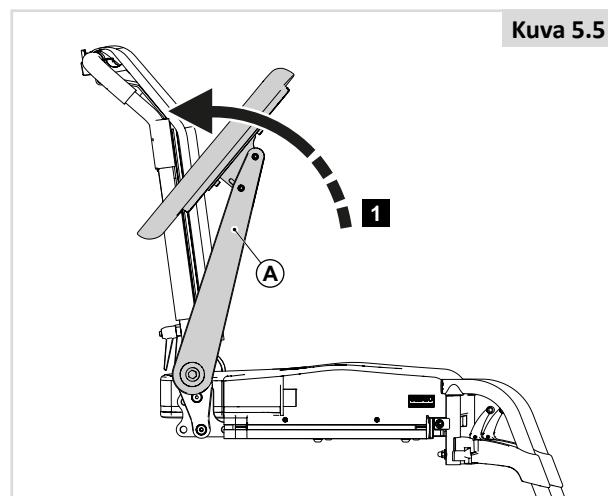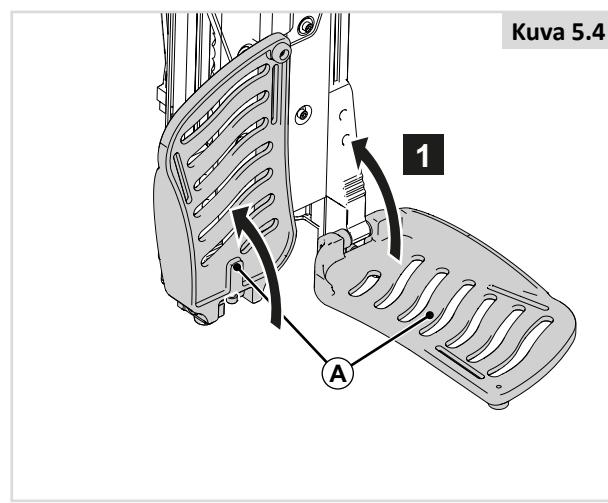

5.4 Pääntuki

Pääntuen poistaminen/kohdistaminen (kuva 5.8)

1. Nosta (A).
2. Liu'uta (B) osasta (C) ulos- tai sisäänspäin.
3. Paina (A) alas.

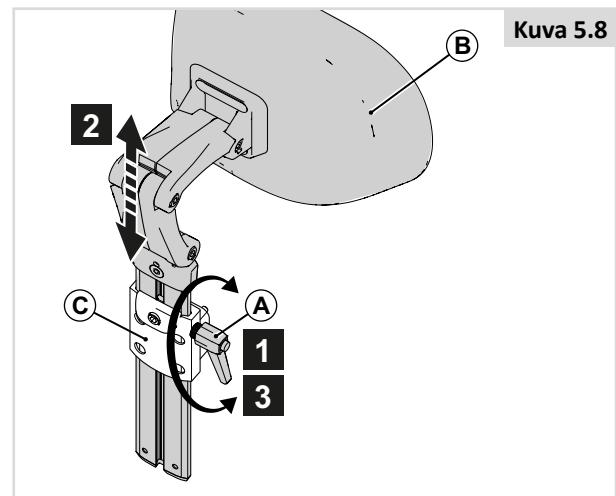


Kuva 5.8

5.5 Sivulle taittuva ohjaimen pidike

Sivulle kääntyvä ohjain (kuva 5.9)

Ohjaimen pidike mahdollistaa ohjaimen lukitsemisen kahteen eri etuasentoon.

1. Työnnä (A) sisään- tai ulospäin.
2. Palauta ohjain etuasentoon työntämällä sitä takaosasta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu naksaltaen paikalleen.

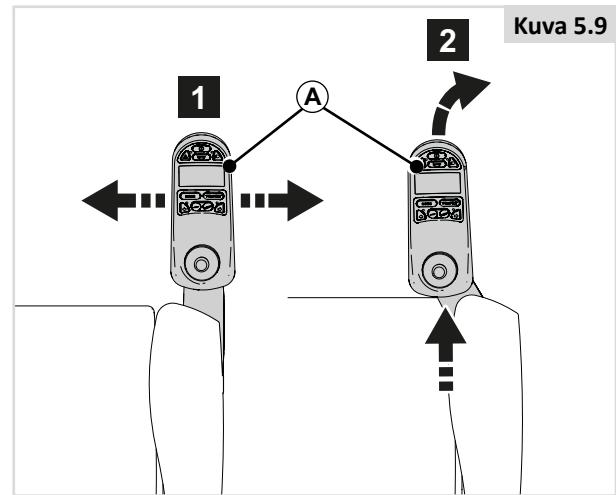


Kuva 5.9

Käännä ohjaimen pidike ulospäin (kuva 5.10)

1. Työnnä (A) ulospäin.
2. Palauta ohjain etuasentoon työntämällä sitä takaosasta eteenpäin, kunnes se lukkiutuu naksaltaen paikalleen.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!


Vetämällä ohjaimen taka-asentoon voit ajaa lähemmäs pöydän reunaa. Kaikki ohjaimen toiminnot ovat edelleen käytettävissä.

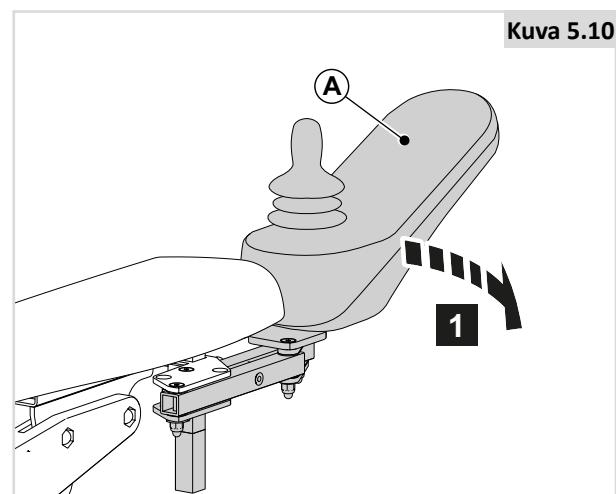

Kuva 5.10

5.6 Sivuttaissäädöt (Kuva 5.11)


1. Paina kohdasta A ja taita osa B ulospäin.

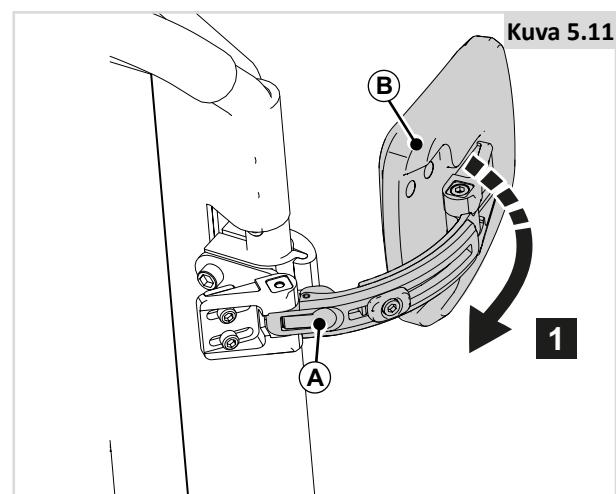

Kuva 5.11

5.7 Polvi/reisituki (kuva 5.12)

- Löysää A ja taita osa B ulospäin.

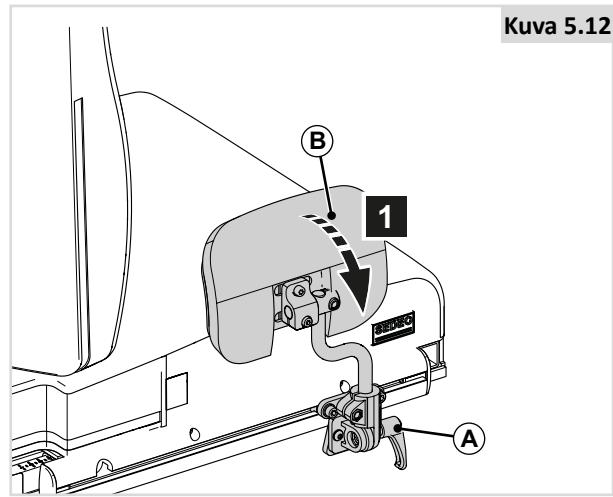


5.8 Hemiplegiakäsinoja (kuva 5.13)

- Vedä (A) ulos lukitusta asennosta ja siirrä (B) haluttuun asentoon.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että (B) on lukittu kunnolla!

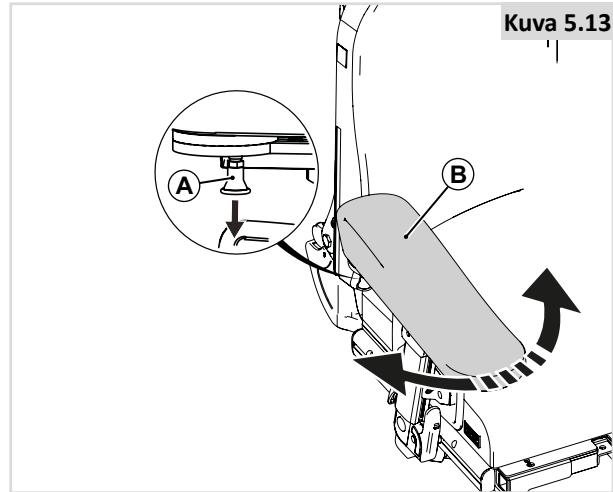

5.9 Haarakiila (kuva 5.14)

Haarakiilan siirtäminen alas


- Vedä (A) ulos lukitusta asennosta.
- Käännä (B) alas.
- Vapauta (A).

Haarakiilan siirtäminen ylös

- Vedä (A) ulos lukitusta asennosta.
- Käännä (B) ylös.
- Vapauta (A) takaisin lukittuun asentoon.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että (B) on lukittu kunnolla!

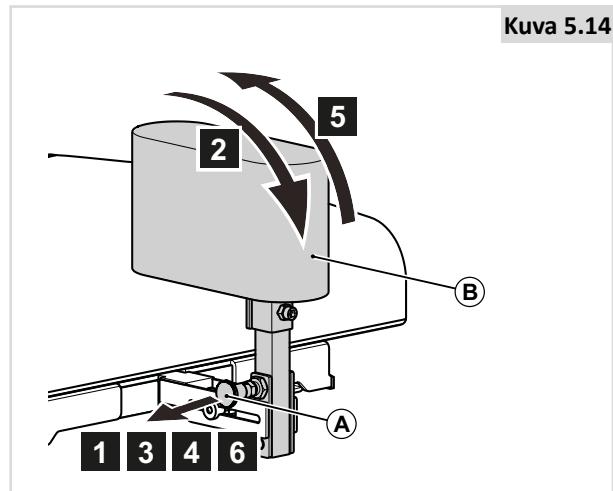

6.0 Manuaalisesti ja sähkötoimisesti tehtävät istuimen säädöt

Kuva 6.1

6.1 Manuaalisesti tehtävät istuimen säädöt

Manuaalisesti kallistettava selkänoja (avustajan toimesta), (kuva 6.1)

1. Purista osaa (A).
2. Vedä eteen- tai taaksepäin säättääksesi (B) haluamaasi asentoon.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Jatka osan (A) puristamista.

3. Vapauta (A).

Sedeo Lite, manuaalisesti nostettavien jalkatukien polven kulma (kuva 6.2)

Molempien jalkatukien kallistuskulmat voi säätää itsenäisesti.

1. Käännä osaa (A).
2. Nosta jalkaasi.
3. Vapauta vipu, kun jalka on halutussa asennossa.

⚠ VAARA/VAROITUS!

- Sormet voivat jäädä puristukseen! Älä laita sormiasi säätömekanismin liikkuvien osien väliin nostaessasi tai laskiessasi jalkatukia.


Jalkatukien polvikulman manuaalinen nostaminen (kuva 6.3)

Molempien jalkatukien kallistuskulmat voi säätää itsenäisesti.


1. Työnnä vipua (A) eteenpäin.
2. Nosta jalkaasi.
3. Vapauta vipu, kun jalka on halutussa asennossa.

⚠ VAARA/VAROITUS!


- Sormet voivat jäädä puristukseen! Älä laita sormiasi säätömekanismin liikkuvien osien väliin nostaessasi tai laskiessasi jalkatukia.

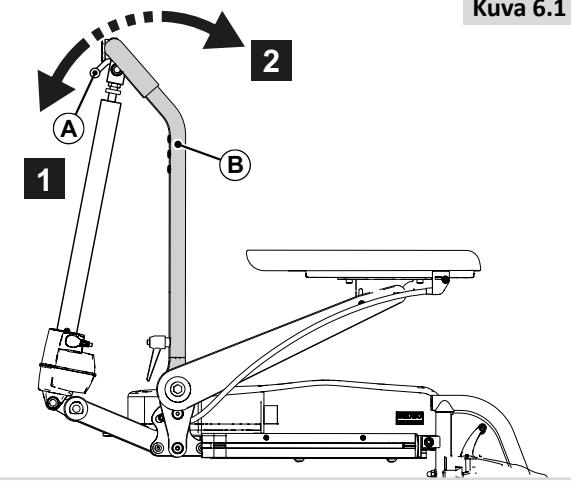


Kuva 6.2

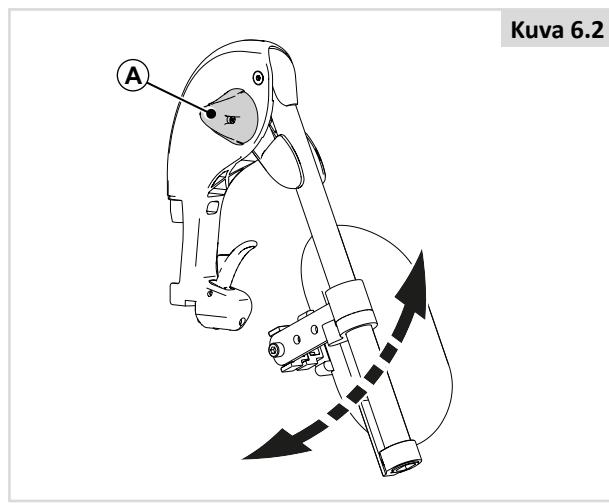

Kuva 6.3

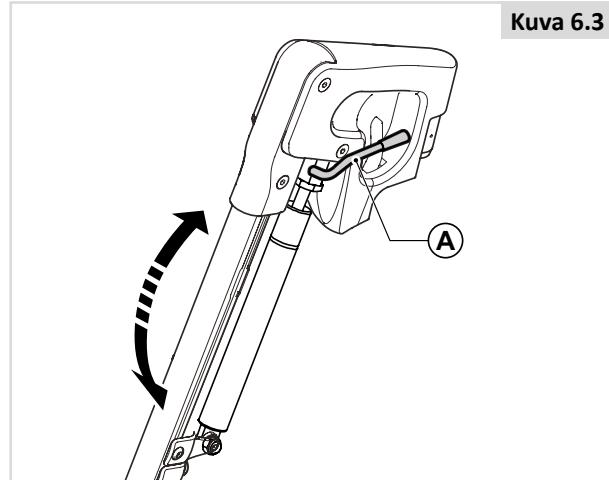

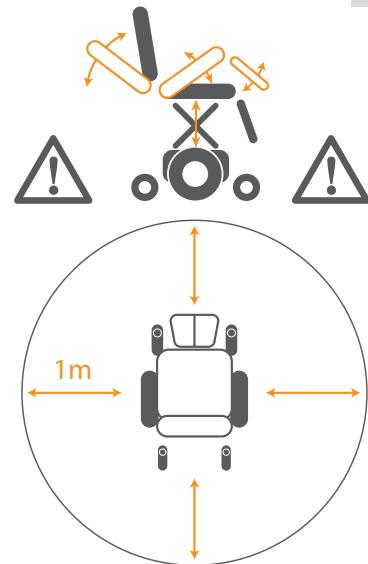

6.2 Sähkötoimisesti tehtävät istuimen säädöt

Pyörätuoli voidaan varustaa seuraavilla sähkötoimisilla istuimen säätömahdollisuuksilla. Käyttäjä voi tehdä nämä säädöt itse ilman työkaluja.

Sähköisesti säädettävät valinnaiset istuointoiminnot (kuvat 6.4 - 6.6)


Katso sähkötoimisiin istuimen säätöihin liittyvät ohjeet kohdasta OHJAIN.

1. Sähkötoiminen istuimen kallistuksen säätö
2. Sähkötoiminen istuimen korkeudensäätö
3. Sähkötoiminen selkänojan kallistuksen säätö
4. Sähkötoimisesti nostettavat jalkatuet


VAARA/VAROITUS!

- Istuimen sähkötoimisesti tehtävät säädöt voivat vaikuttaa pyörätuolin vakauteen.
- Käytä sähkötoimisia säätötoimintoja vain, kun pyörätuoli on tasaisella alustalla! Älä yritä säätää mitään istuimen asentoja sähkötoimisesti pyörätuolin ollessa kaltevalla alustalla.
- Pysy riittävän etäällä toimimoottoreista säädettävän osan liikkuessa. Sähkötoimisesti säädettävien osien toimilaitteet liikkuvat laajalla alueella. Käyttäjien tulee tarkkailla pyörätuolia sen osien liikkuessa.
- Ole erityisen varovainen, jos ajat pyörätuolilla istuinjärjestelmä kallistettuna eteen tai taakse tai nostettuna korkeammalle kuin tavallisesti.
- Älä yritä säätää mitään istuimen asentoja sähkötoimisesti pyörätuolin liikkuessa.
- Älä käytä nosto- tai kallistustoimintoja lasten lähettyvillä.
- Kaikkien sähkötoimisten säätöjen käyttösuuntaa voi muuttaa ohjelmoimalla; varmista ennen säätötoimintojen käyttöä, että tiedät mihiin suuntaan istuin liikkuu.
- Ota huomioon, että hissi-/tiltimoduulit voivat aiheuttaa kiinnijutumisen vaaran. Varmista hissiä/tiltiä käyttäässäsi, etteivät vaatteet, kädet, jalat tai muut ulkonemmat pääse juuttumaan kiinni.
- Älä aja ajoliuskalle tai rinteeseen istuin ylös nostettuna. Palauta pyörätuoli tavalliseen istuma-asentoon ja varmista, että istuin on istuma-asennossa ennen kuin ajat rinnnettä ylös tai alas.

Tämä pyörätuoli on suunniteltu siirtymään automaattisesti ryömintänopeuteen, kun tietty sähkötoimisesti säädettävä istuinjärjestelmän ääriasennot on saavutettu. Pyörätuolin kokoonpanosta riippuen käytössä voi olla useita eri ryömintänopeuksia.

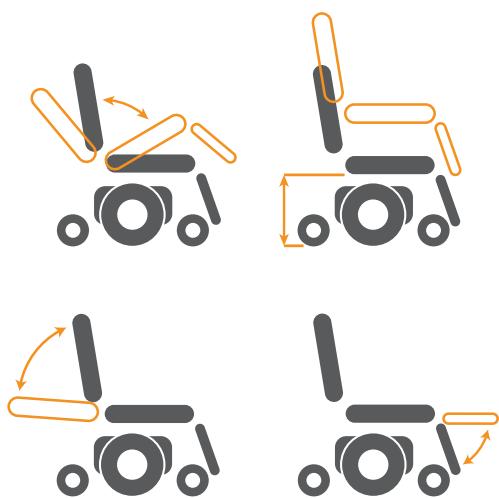

Istuimen sähkötoimiset säädöt

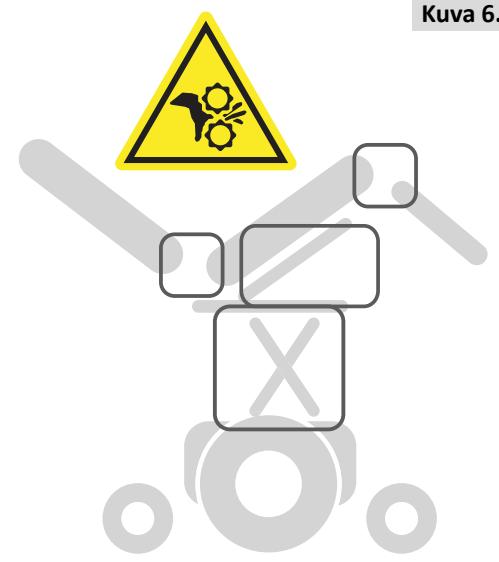

Istuimen sähkötoimiset säädöt

7.0 Istuinjärjestelmän pakkaaminen kuljetusta varten


! VAARA/VAROITUS!

Pyörätuoli voidaan pakata pienempään kokoon kuljetusta varten, mikäli käyttäjä ei istu pyörätuolissa kuljetuksen aikana. Irrota kaikki helposti irrotettavat istuinjärjestelmän osat. Laita osat turvalliseen paikkaan, jossa ne eivät voi vahingoittua tai aiheuttaa vammoja tai vahinkoja.

7.1 Istuintyynty


Istuimen irrotus (kuva 7.1)

1. Vedä (A) ylöspäin.

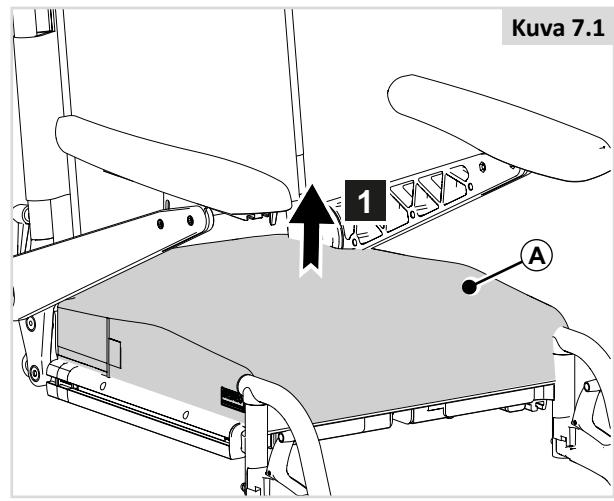

Istuimen asennus (kuva 7.2)

1. Kohdista (A) siten, että siinä olevat reiät ovat pulttien päällä.

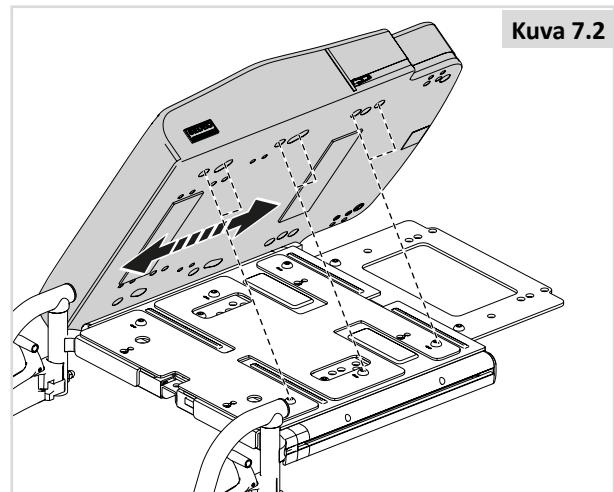

7.2 Selkätyyny

Selkätyynyn irrotus (kuva 7.3)



1. Avaa lukitus työntämällä (A) eteen.
2. Nosta (B).


Selkätyynyn asennus (kuva 7.3.1)

1. Kohdista (A).
2. Työnnä takaisin paikalleen (B).

! HUOMAUTUS/HUOMIO!

Oikein asetettuina sokat naksahvatavat lukitusasentoon.

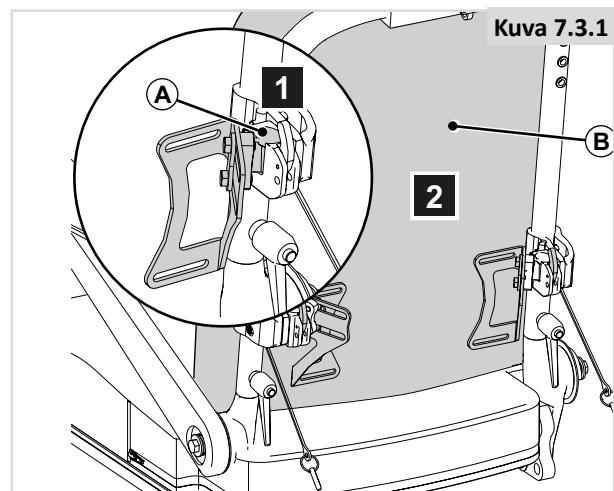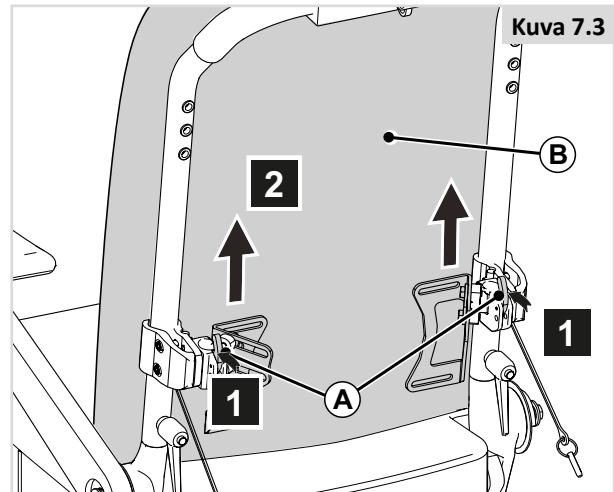

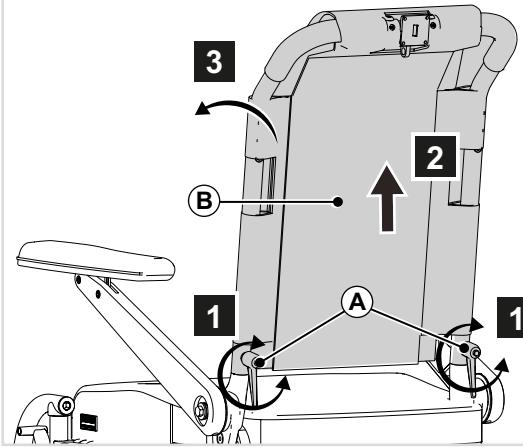

7.3 Selkänojan taittaminen alas (kuva 7.4)

1. Löysää (A).
2. Vedä (B) ylöspäin.
3. Taita (B) eteen.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Poista tarvittaessa ensin selkätyyny.

Varmista, että (A) on lukittu kunnolla!


7.4 Kallistuvan selkänojan taittaminen alas (kuva 7.5)

1. Löysää (A).
2. Poista (B).
3. Vedä (C) ylöspäin.
4. Taita (C) eteen.

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Poista tarvittaessa ensin selkätyyny.

Varmista, että (A) ja (B) ovat kunnolla kiinni.

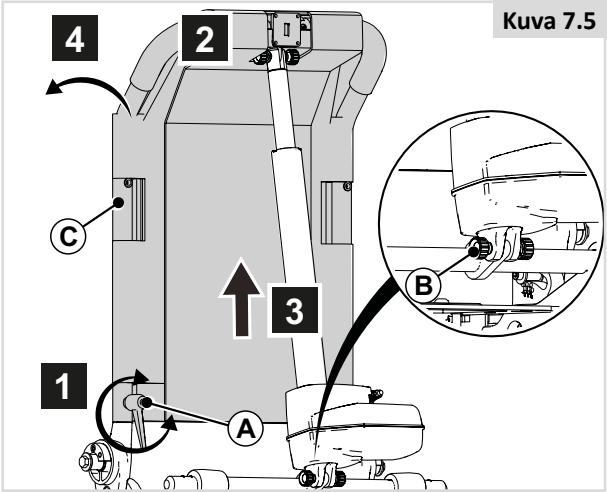

⚠ HUOMAUTUS/HUOMIO!

Selkänoja on helppo taittaa eteen pitäen kiinni selkänojan yläosasta.

7.5 Jalkatukien kääntäminen sivulle (kuva 7.6)

Kuva. 7.6

Sivulle taitettavan jalkatuen poistaminen

1. Löysää pohjenauha.
2. Työnnä lukkoja (A) taaksepäin jalkatuen lukituksen avaamiseksi.
3. Taita jalkatuki ulospäin.
4. Irrota jalkatuki (B) pidikkeestä nostamalla ylöspäin.

Kun asennat jalkatuen takaisin paikalleen, kuulet sen nakahtavan paikalleen. Näin tiedät, että jalkatuki on lukkiutunut paikalleen.


Danger of finger entrapment (kuva 7.7)



⚠ Warning!

When the Manual Elevating swing away legrest is removed, carry the legrest at the handle intended for removing/carrying (A).

When carrying at B and at the same time releasing lever C there is a risk of finger trapping.

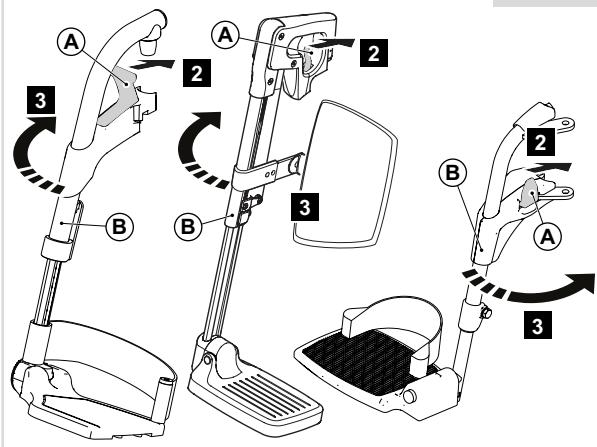




7.6 Keskikiinnitteinen irrotettava käsinaja

Käsinajan irrotus (kuva 7.8)

1. Käännä (A) muutama kierros.
2. Poista (B).

Käsinajan asennus (kuva 7.9)

1. Liu'uta (A) osaan (B).
2. Käännä (C) muutama kierros.

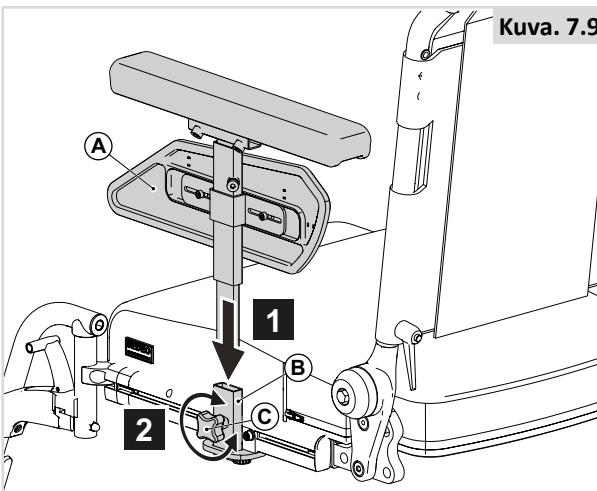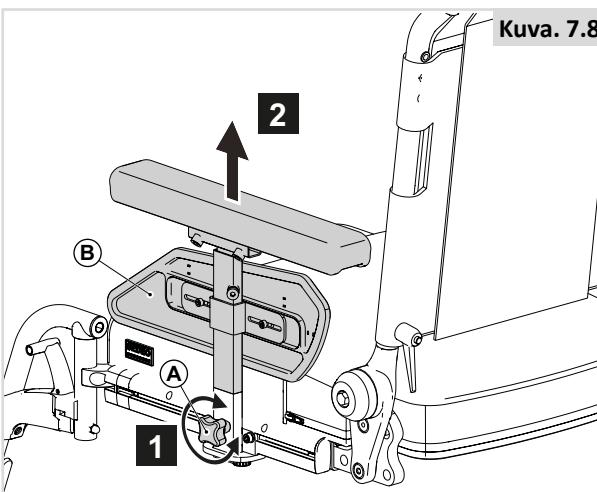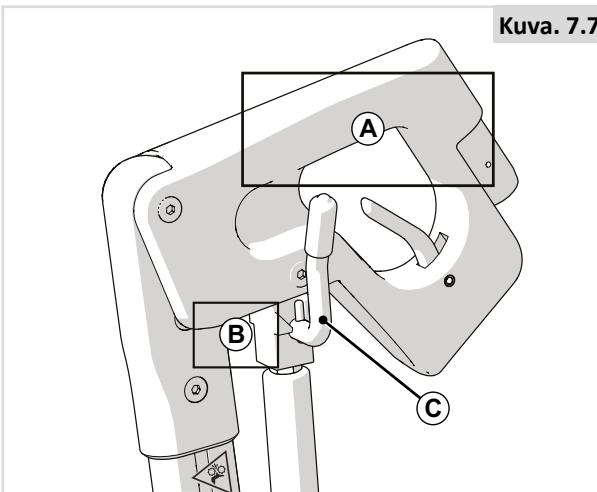

8.0 Huoltaminen ja puhdistaminen

8.1 Yleinen kunnossapito

- Kaikki kiinnikkeet on tarkastettava kulumisen, löystyneiden ja rikkoutuneiden osien (esim. pultit) varalta joka kuukausi.
- Löystyneet kiinnikkeet tulee kiristää asennusohjeiden mukaisesti.

Katso tarvittavat kiristysmomentit alla olevasta taulukosta.

Kiinnittimet	Kiristysmomentti (Nm)
M6 pultti	9 - 10

Huomautus: momenttiavaimen käyttö on tarpeen.

- Tarkasta kaikki hihnat joka kuukausi hankaumien, revenneiden saumojen ja muun liiallisen kulumisen varalta. Poista hihnat käytöstä, jos havaitset niissä vaurioita.
- Rintahihnat tulee vaihtaa heti, kun niissä ilmenee vaurioita ja/tai liiallisen kulumisen merkkejä.
- Jos havaitset hajonneen tai löystyneen osan, lopeta käyttö heti ja ota yhteys valtuutettuun Sunrise Medicalin edustajaan varaosan hankkimiseksi.
- Tarkasta, että kaikki tarranauhat tarttuvat kunnolla toisiinsa.
- Poista tarranauhoista kaikki roskat ja lika (esim. nöyhtä, hiukset jne). Ne voivat heikentää tartuntatehoa.

8.2 Pyörätuolin puhdistaminen

Pyörätuoli on pyhittää kerran viikossa kevyesti kostutetulla liinalla ja toimilaitteiden ympärille kertynyt pöly ja roskat on puhallettava pois.

HUOMAUTUS/HUOMIO!

Varmista, että kaikki pyörätuolin osat kuivataan jos pyörätuoli kastuu tai on kostea puhdistuksen jälkeen tai jos sitä käytetään märissä tai kosteissa olosuhteissa.

VAARA/VAROITUS!

Tartuntojen välttämiseksi on tärkeää, että pyörätuoli puhdistetaan perusteellisesti, jos sitä käyttää useampi henkilö.

8.2.2 Istuimen puhdistaminen ja tarkastus

VAARA/VAROITUS!

Repeytymät, lommot, verhoilun kuluminen tai löystyminen erityisesti metallin lähellä saattaa johtaa huonoon ja epämukavaan asentoon sekä heikentyneeseen paineenpoistoon.

Istuimen puhdistusohjeet:

Jos tyynypäällisen sisäpuolella on pesuohjeet, päällisen voi pestä. Noudata pesuohjeita. Poista vaatokumit ennen pesua ja sulje tarranauhakiinnittimet.

VAROITUS!

Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai tärpätiä.

Älä puhdista verhoilua kemiallisesti. Älä silitä tai rumpukuivaa verhoilua.

Jos verhoilua ei voi poistaa, puhdista verhoilu säännöllisesti lian kertymisen ja tahriintumisen estämiseksi. Puhdista kostealla saippuaisella kankaalla. Laimennettua desinfointiainetta voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista, että pinnat huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivataan läpikotaisin.

8.3 Tarvittavat hygieniatoimenpiteet ennen uudelle käyttäjälle luovuttamista:

Pyörätuoli on puhdistettava huolellisesti ennen uudelle käyttäjälle luovuttamista. Kaikki käyttäjän kanssa kosketuksissa olevat pinnat on desinfoitava ruiskuttamalla.

Puhdistukseen on käytettävä lääkintälaitteiden puhdistukseen soveltuva alkoholipohjaista desinfointiainetta.

Noudata desinfointiaineen valmistajan antamia käytööhjeteita.

HUOMAUTUS/HUOMIO!

- Älä käytä puhdistukseen liuottimia, valkaisuaineita, hiomaaineita, synteettisiä pesuaineita, kiillotusvahaa tai aerosolia.
- Laimennettua desinfointiainetta voidaan käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että pinnat huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivataan läpikotaisin.

8.4 Yleisiä puhdistusohjeita:

⚠️ HUOMAUTUS/HUOMIO!

- Poista istuimeen tarttuneet tahrat mahdollisimman pian.
- Puhdista istuimen pinnat pitkääikaisen käytön jälkeen tavallisella vaahtopohjaisella kuivapesuaineella.
- Puhdista aina koko pinta-ala yksittäisten tahrojen sijasta raitojen välttämiseksi. Mitä kauemmin odotat, sitä vaikeammin tahrat lähevät irti.
- Vältä voimakasta hankausta vesipohjaisilla pesuaineilla. Se kovettaa kankaan pinnan.
- Likatahrat (esim. olut, veri, kolajuoma, punaviini jne.) irtoavat parhaiten vaahtopohjaisella kuivapesuaineella tai miedolla pesuaineella.
- Noudata asianmukaisia ohjeita istuinpäälliäsi puhdistessaasi.
- Anna päällisten kuivua vähintään 48 tunnin ajan vaahtopesun jälkeen.
- Rasvatahrat (esim. mustekynä, huuliraska, purukumi jne). Käytä tahranoistoainetta. Hankaa tahrain kevyesti tahranoistoaineeseen kastellulla kankaalla.
- Käytä vain hyvin vähän tahranoistoainetta.
- Kokeile ensin pienellä huomaamattomalla alueella.
- Päälliset eivät saa kastua, sillä tahranoistoaine voi siinä tapauksessa syövyttää ne.
- Pyörätuolin osiin painettuja asteikkoja (esim. istuinlevyssä olevat nuolet ja istuimen leveyden säätöasteikko) ei saa hangata voimakkaasti.
- Älä puhdista pyörätuolia letkulla tai painepesurilla.

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Lue aina kaikkien teollisuus- tai kotikäyttöön tarkoitettujen puhdistusaineiden pakkaustiedot.
- Nouda ohjeita aina tarkasti.

8.5 Lisääitteiden puhdistaminen:

- Kaikki osat/lisävarusteet, kuten käännettävä tasot on puhdistettava kostealla kankaalla.
- Kaikki sivutuet, niskatuet, käsinojat, sivusuojat, pohjesuojat, lantiovyöt ja polvisuojukset on puhdistettava kostealla kankaalla.

8.6 Ohjauslaitteiden puhdistaminen:

Jos ohjainlaite pääsee likaantumaan, voit pyyhiä sen puhtaaksi desinfointiaineeseen kostutetulla kankaalla.

⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos pyörätuoli on useampien henkilöiden käytössä; näin vältetään infektioiden tarttuminen.
- Varmista, että wafer board -ohjaimet, ohjaussauvat (kaikki tyypit), päälä ohjattavat ohjaimet ja kytkimet (kaikki tyypit) puhdistetaan miedolla pesuaineella ja puhdistuskankaalla tartuntojen välttämiseksi. Irrota ja pese imu-puhallus-ohjaimen suukappale ja putkiosat säännöllisesti, jotta ne pysyvät puhdistuksissa ja toimintakunnossa.
- Varmista, että ohjausjärjestelmä on kytketty pois päältä ennen puhdistusta.

8.7 Varastointi

Säilytä pyörätuolia kuivassa paikassa mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, jotta sen verhoilu ja muut osat pysyvät hyvässä kunnossa.


⚠️ VAARA/VAROITUS!

- Älä koskaan varastoii pyörätuolia suorassa auringonvalossa tai kosteissa tiloissa tai ulkotiloissa.
- Suora auringonvalo saattaa valkaista verhoilun / muoviosat ja ylikuumentaa metalliosat.

9.0 Hävittäminen

Symbolit ilmaisevat, että tuote on hävitettävä paikallisten lakiens ja säännösten mukaisesti erillään talousjätteestä. Kun tuotteen elinkaari on päättynyt, vie se paikalliseen keräyspisteesseen. Tuotteen oikea hävittäminen ja kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistaa, että tuote kierrätetään ympäristövälillisellä tavalla.

Varmista, että olet tuotteen laillinen omistaja ennen kuin järjestät tuotteen hävittämisen edellä mainittujen suositusten ja kansallisten lakiens mukaisesti.

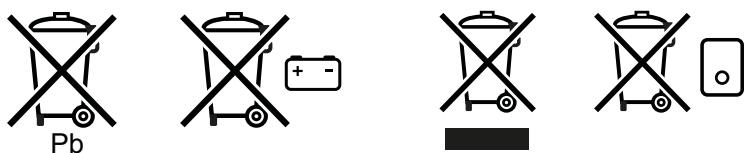

Seuraavassa kohdassa esitetään pyörätuolin materiaalit ja pyörätuolin ja sen pakauksen kierräykseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot.

Katso istuinjärjestelmän hävittämiseen ja kierräykseen liittyvät tiedot Sedeo Lite -käyttöoppaan kohdasta (Istuinjärjestelmä).

Lisäksi alueellasi voi olla voimassa paikallisia sääädöksiä, joita sinun on noudatettava pyörätuolin kierrätyksen tai hävittämisen yhteydessä. (Sääädöksissä voidaan esim. vaatia, että pyörätuoli on puhdistettava tai desinfioitava ennen hävittämistä).

Alumiini: tukipyörien haarukat, pyörät, rungon sivusuojat.

Teräs: Kiinnitysosat, pikalukitusakseli

Muovi: Kahvat, putkien tulpat, tukipyörät ja pyörä/rengas

Pakausmateriaalit: Pehmeät polyetyleenipussit, pahvi

Jätteiden hävitys ja kierrätyks tulee antaa virallisesti hyväksytyn toimipisteen suoritettavaksi. Pyörätuoli voidaan vaihtoehtoisesti palauttaa jälleenmyyjälle kierrätettäväksi.



10.1 Sovellettavat standardit

EN-ISO10993-5: 2009	Lääkinnällisten laitteiden biologinen arvointi.
EN 1021 1&2	Pehmustettujen huonekalujen sytyvyyden arvointi. Sytytyslähde: palava savuke / tulitikku tai vastaava.

10.2 Tekniset tiedot:

SEDEO Lite -istuinjärjestelmä

	Metrimitat		Imperiaaliset mitat ja vaihtoehto	
	Minimi	Maksimi	Minimi	Maksimi
Istuimen kallistuskulman säätö				
Sähkötoiminen kallistus painopisteen säädöllä valinnainen	0° - 30°		-5° - 25°	
Sähkötoiminen kallistus painopisteen säädöllä valinnainen	-5° - 25°		0° - 30°	
Sähkötoiminen kallistus painopisteen säädöllä valinnainen	0° - 50°		0° - 50°	
Tosiasiallinen istuimen syvyys	410 mm	560 mm	16,1"	22,0"
Tosiasiallinen istuimen leveys	385 mm	510 mm	15,2"	22,1"
Etäisyys istuimesta lattiaan				
Täytömoduuli (ei sähkötoimista kallistusta, ei istuimen nostoa)				
asento 1 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	415 mm		16,3"	
asento 2 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	440 mm		17,3"	
asento 3 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	465 mm		18,3"	
asento 4 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	490 mm		19,3"	
Sähkötoiminen kallistus ja istuimen korkeudensäätö (300 mm)				
asento 1 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	-	-	-	-
asento 2 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	-	-	-	-
asento 3 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	465 mm	765 mm	18,3"	30,1"
asento 4 60 tai 80 Ah:n akut 0° istuimen kallistuskulma	490 mm	790 mm	19,3"	31,1"
Selkänojan kulma				
Selkänojan kallistuksen säätöalue	86°,90°,94°,98°,102°,106°		86°,90°,94°,98°,102°,106°	
Sähkötoiminen kallistus	85° - 120°		85° - 120°	
Selkänojan korkeus (istuinlevystä selkätyynyn yläosaan)	460 mm	510 mm	18,1"	20,1"
Taakse taittuva käsinoja				
Käsinojan pehmusteent korkeus (istuinlevystä käsinojan yläosaan)	190 mm	320 mm	7,5"	12,6"
Käsinojan pehmusteent syvyys (käsinojalla)	100 mm		3,9"	
Käsinojan pehmusteent kallistuskulma (pystysuunta)	0° - 15°		0° - 15°	
Keskiinnitteinen taakse taittuva käsinoja				
Käsinojan pehmusteent korkeus (istuinlevystä käsinojan yläosaan)	250 mm	400 mm	9,8"	15,7"
Käsinojan leveys (istuinrungossa)	-20 mm	+20 mm	-0,79"	+0,79"
Käsinojan pehmusteent leveys (käsinojalla)	-20 mm		-0,79"	
Käsinojen syvyys (istuinrungossa)	250 mm		9,8"	
Käsinojan pehmusteent syvyys (käsinojalla)	140 mm		5,5"	
Käsinojan pehmusteent kallistuskulma (pystysuunta)	0° - 15°		0° - 15°	
Keskiinnitteinen jalkatuki				
Säären pituus (istuinlevystä)	305 mm	460 mm	12"	18,1"
Polven kulma	70° - 120°		70° - 120°	
Nilkan kulma	+20° - -40°		+20° - -40°	
Sähkötoiminen keskiinnitteinen jalkatuki				
Säären pituus (istuinlevystä)	210 mm	470 mm	8,3"	18,5"
Polven kulma	90° - 180°		90° - 180°	
Maks. pituuden kompensoatio	180 mm		7,1"	
Nilkan kulma	+35° - -15°		+35° - -15°	
Sivulle käännyvä SEDEO LITE -jalkatuet				
Säären pituus (istuinlevystä)	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
Polven kulma	70°		70°	
Nilkan kulma	0° - 180°		0° - 180°	

	Metrimitat		Imperiaaliset mitat ja vaihtoehto	
	Minimi	Maksimi	Minimi	Maksimi
Sivulle käännyvät SEDEO LITE -jalkatuet, manuaalisesti / sähkötoimisesti nostettavat				
	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
	0° - 70°		0° - 70°	
	0° - 180°		0° - 180°	
Sivulle käännyvät UNI-jalkatuet				
	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
	70°		70°	
	0° - 180°		0° - 180°	
Sivulle käännyvät SEDEO PRO -jalkatuet				
	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
	70°		70°	
	0° - 180°		0° - 180°	
Sivulle käännyvät SEDEO PRO -jalkatuet, manuaalisesti / sähkötoimisesti nostettavat				
	350 mm	510 mm	13,8"	20,1"
	0° - 70°		0° - 70°	
	0° - 180°		0° - 180°	
SEDEO Multi-Position -pääntuen kiinnike				
	Pääntuen korkeuden säätöalue		170 mm	
	Pääntuen syvyyden säätöalue		200 mm	
	Pääntuen kallistuskulma (pystysuunta)		-45° - +45°	
	-20 mm	20 mm	-0,8"	+0,8"
Sivutuet				
	Sivutuen leveyden säätöalue		90 mm	
	Sivutuen korkeuden säätöalue		170 mm	
	Sivutuen syvyyden säätöalue		45 mm	
Haarakiila				
	Haarakiilan korkeus (istuinlevystä tyynyn yläosaan)		170 mm	250 mm
	Haarakiilan syvyyden säätöalue		65 mm	

11.0 Takuutiedot

TÄMÄ TAKUU EI VAIKUTA MITENKÄÄN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI.

Sunrise Medical* tarjoaa pyörätuoleille takuehtojen mukaisen takuun, joka kattaa seuraavat.

Takuuehdot:

1. Jos pyörätuolin osa tai osat pitää korjata tai vaihtaa johtuen valmistus- ja / tai materiaalivasta 24 kuukauden kuluessa tai runko ja poikkituet 5 vuoden kuluessa toimituksesta asiakkaalle, niin kyseinen osa tai osat korjataan tai vaihdetaan uuteen veloituksetta. Takuu kattaa vain valmistusvirheet
2. Ota takuutapaiksissa yhteyttä Sunrise Medicinalin asiakaspalveluun ja kerro ongelman yksityiskohdista. Jos käytät pyörätuolia muualla kuin lähimmän valtuutetun huoltopalvelun alueella, huoltotyöt suorittaa toinen Sunrise Medicinalin määrittämä huoltopalvelun tarjoaja. Pyörätuolin korjaustyöt saa suorittaa vain Sunrise Medicinalin valtuuttama huoltopalvelu (jälleenmyyjä).
3. Osille, jotka on korjattu tai vaihdettu tämän takuun puitteissa, annetaan näiden takuehtojen mukainen takuu pyörätuolin jäljellä olevalle takuuajalle kohdan 1 mukaisesti).
4. Alkuperäisille varaosille, jotka on asennettu asiakkaan kustannuksella, annetaan 12 kuukauden takuu (asennuksen jälkeen) näiden takuehtojen mukaisesti.
5. Tämä takuu ei kata seuraavista syistä aiheutuvia pyörätuolin korjauksia tai vaihtoa:
 - a. Tavallisesta kulumisesta (esim. akut, käsinojen pehmusteet, verhoilu, renkaat, jarrut jne.) aiheutuneita kuluja.
 - b. Tuotteen ylikuormituksesta aiheutuneita kuluja; katso käyttäjän sallittu enimmäispaino EC-kyltistä.
 - c. Tuotetta tai osaa ei ole ylläpidetty tai huollettu valmistajan käyttöoppaassa ja/tai huoltokäsikirjassa antamien suositusten mukaisesti.
 - d. Pyörätuolissa on käytetty muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita.
 - e. Pyörätuoli tai osa on vaurioitunut välinpitämättömyyden, tapaturman tai väärän käytön seurauksena.
 - f. Pyörätuoliin tai sen osiin on tehty muutoksia / muunnoksia, jotka poikkeavat valmistajan ohjeista.
 - g. Korjaukset on tehty, ennen kuin asiakaspalvelumme on saanut tiedon huoltotarpeesta.

6. Tähän takuuseen sovelletaan sen maan lakia, josta tuote on ostettu Sunrise Medicinaliltä"

* Tarkoittaa Sunrise Medicinalin palvelua, josta tuote on ostettu.





Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
SunriseMedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Sunrise Medical
North American Headquarters
2842 Business Park Avenue
Fresno, CA, 93727, USA
(800) 333-4000
(800) 300-7502
www.SunriseMedical.com



Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical S.A.S
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Mickaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : + 33 (0) 247554400
Fax : +30 (0) 247554403
www.sunrisemedical.fr

