CHODÍTKO

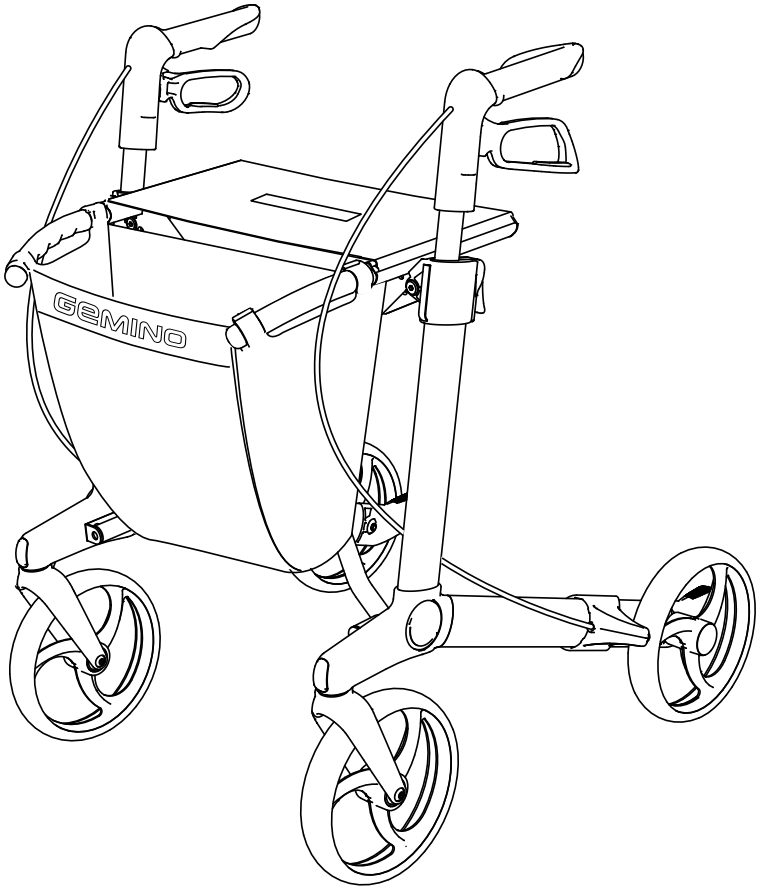

Gemino 30 Parkinson
Gemino 30 M Parkinson
Gemino 30 Comfort Parkinson
Gemino 30 Comfort M Parkinson

NÁVOD K OBSLUZE

GEMINO

MB4400-CZ R

Společnosti SUNRISE MEDICAL byl udělen certifikát ISO 13485, potvrzující kvalitu našich výrobků ve všech stádiích, od výzkumu a vývoje až po výrobu. Tento výrobek splňuje normy stanovené v předpisech EU a Spojeného království. Uvedené varianty a příslušenství jsou k dispozici za příplatek.

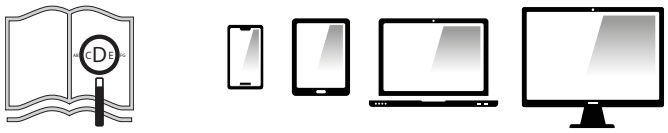

Jste-li zrakově postižený(á), můžete si tento dokument prohlédnout ve formátu PDF na stránce www.medicco.cz

Případně si jej můžete vyžádat s textem psaným velkým písmem.

Štítky

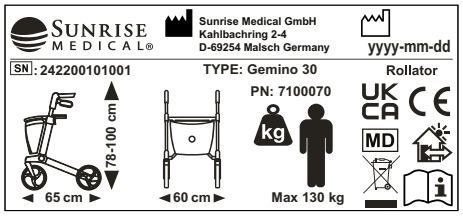

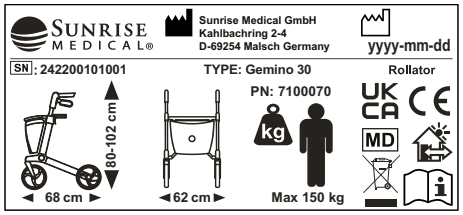

GEMINO

ISO 7010-M002

	Celková výška
	Celková délka
	Celková šířka
	Maximální hmotnost uživatele
	Datum výroby
	Adresa výrobního místa
	CE značka
	CE značka.
	Výrobní číslo
TYPE:	Název výrobku/SKU číslo.
	Vnitřní a venkovní použití
	Tento symbol znamená zdravotnický prostředek
	Adresa dovozce
	Informace najdete v návodu k obsluze
	Odpovědná osoba v UK
	Adresa zástupce ve Švýcarsku
	ISO 7010-M002 Käyttöohje/ohje on luettava! (Sininen kuvake)

CZ

Ⓐ Rukojeť/madlo
Ⓑ Brzdová páka
Ⓒ Sedátko
Ⓓ Košík
Ⓔ Brzdové lanko
Ⓕ Boční rám
Ⓖ Křížová vzpěra
Ⓗ Naklápěcí lišta
Ⓘ Aretace pro nastavení výšky
Ⓙ Popruh pro složení chodítka
Ⓚ Brzdový klínek s bočním deflektorem
Ⓛ Zvedací rukojeť a držák na košík

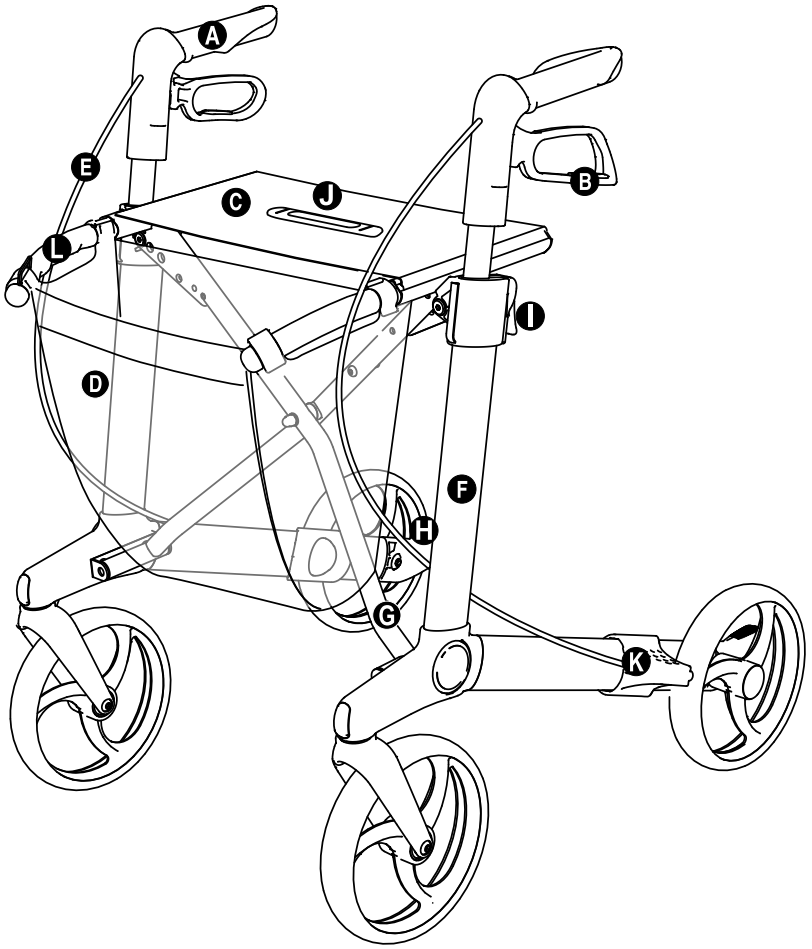

1

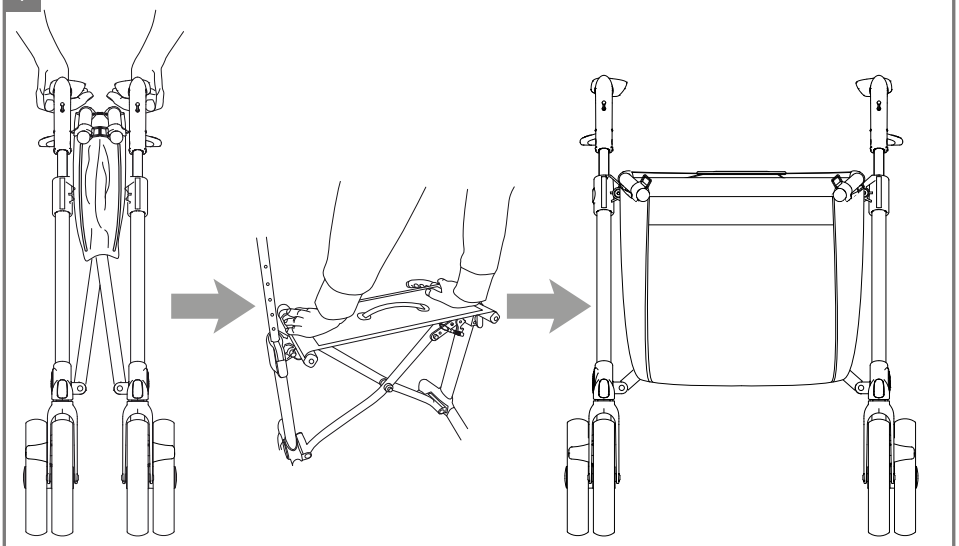

2

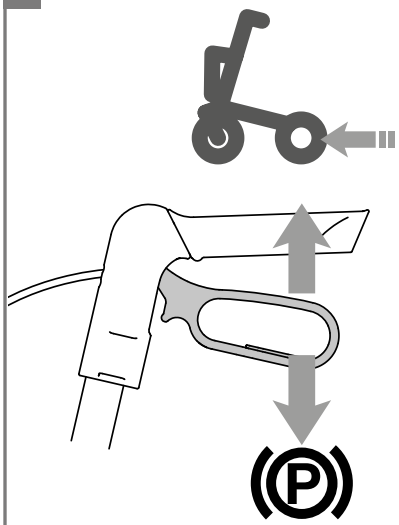

3

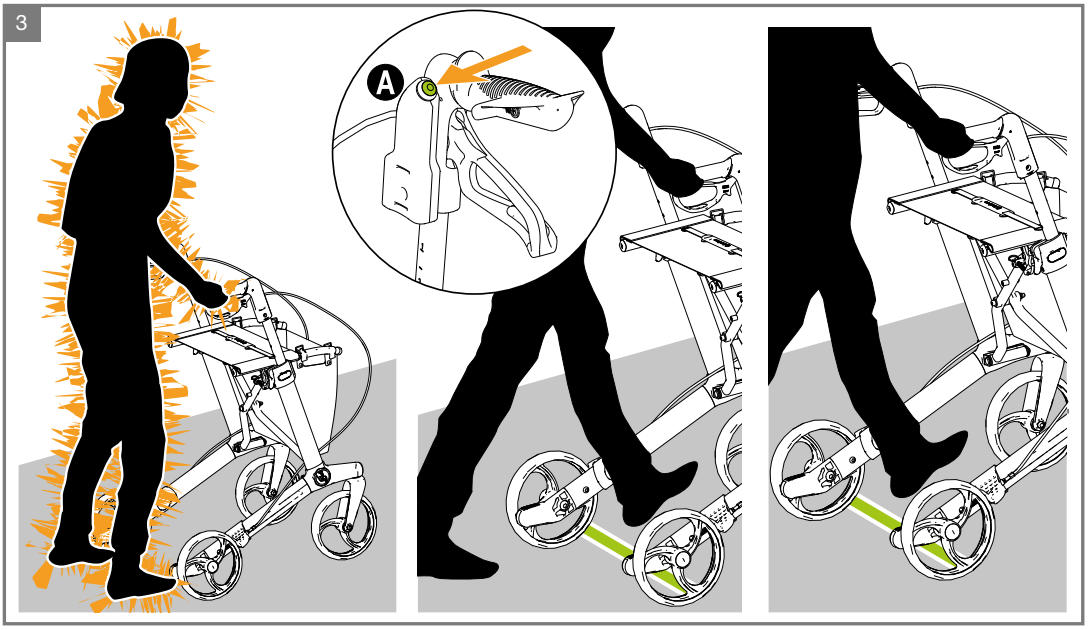

4

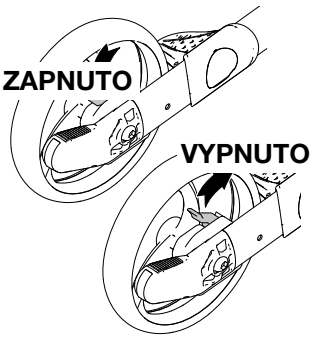

5a

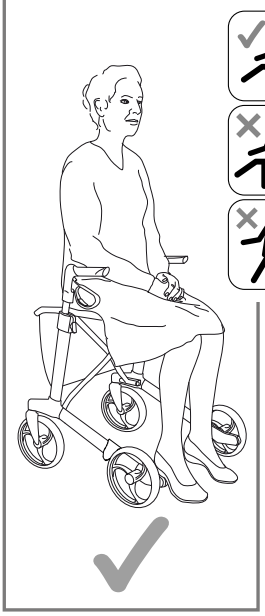

5b

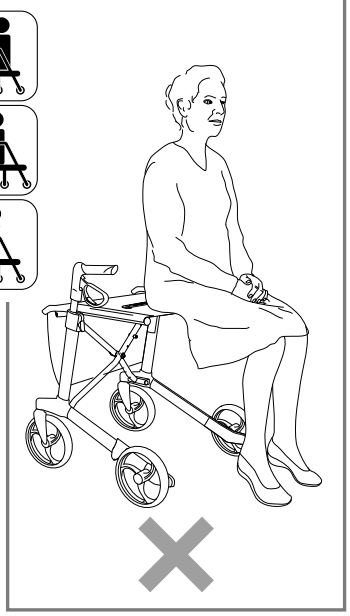

6

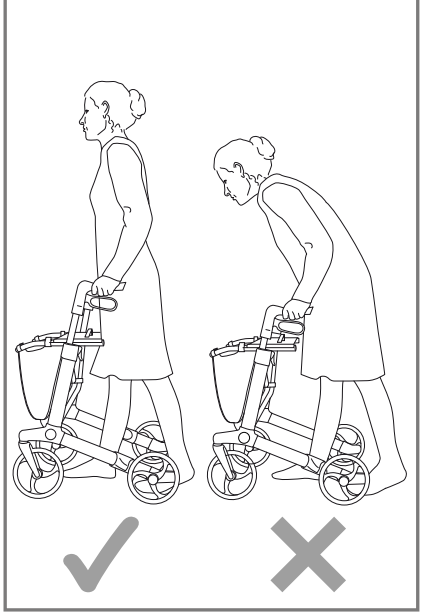

7

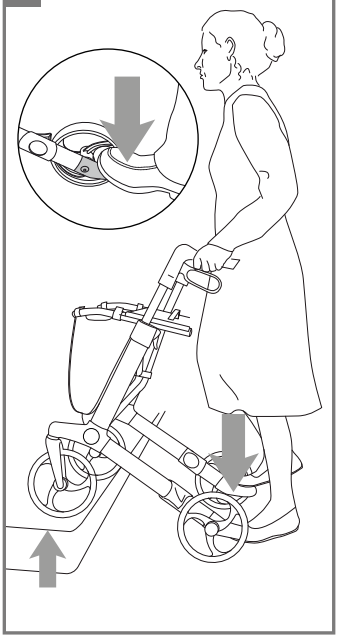

8

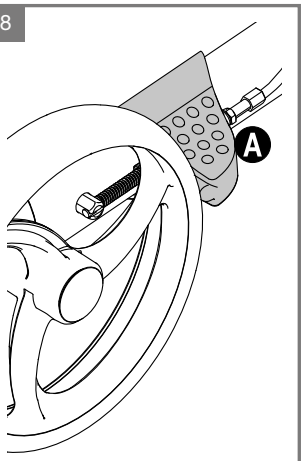

9

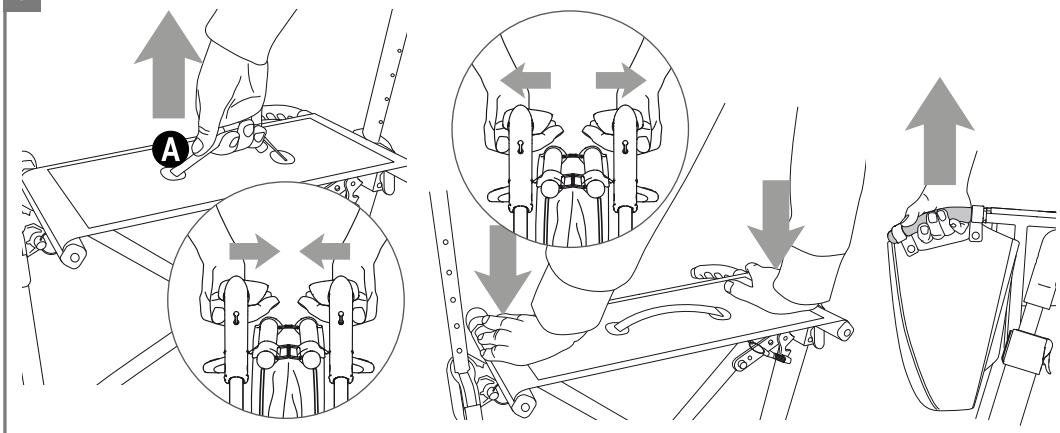

10

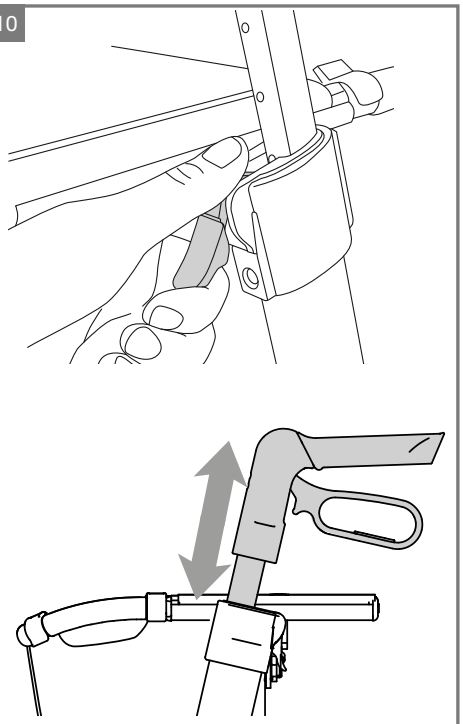

11

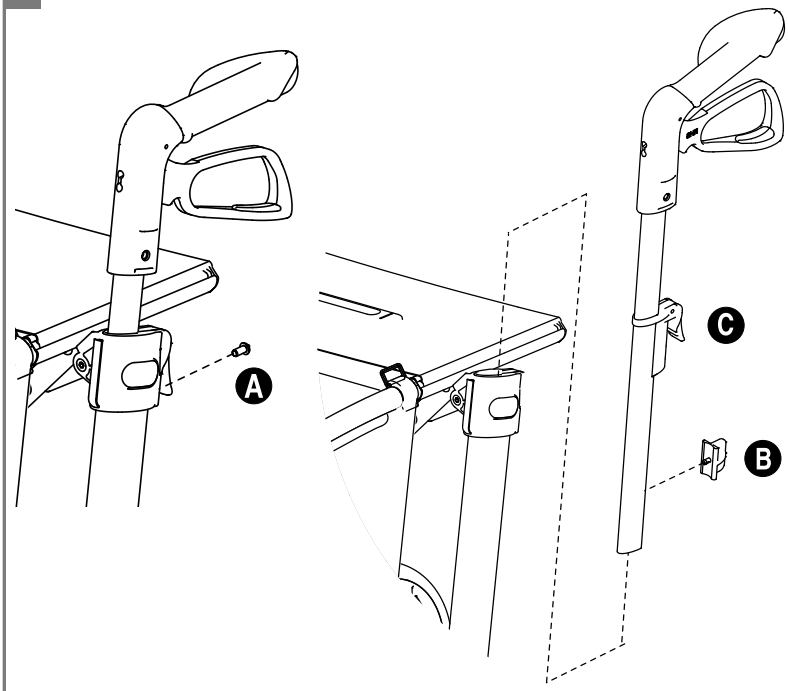

12

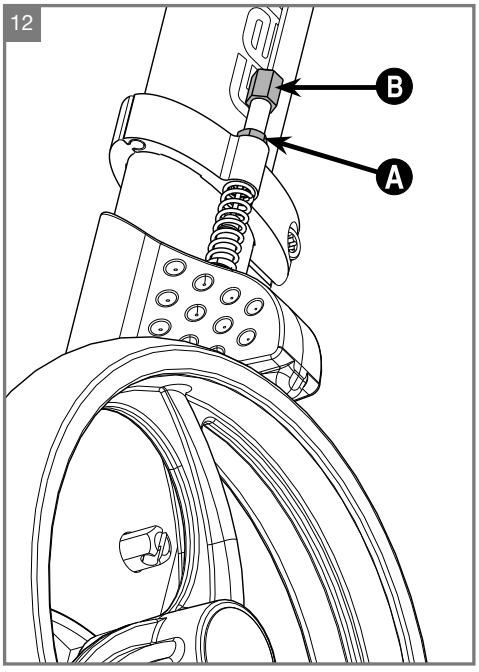

13

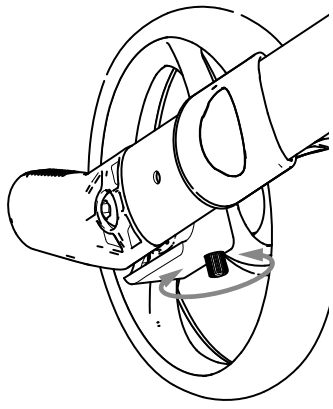

14

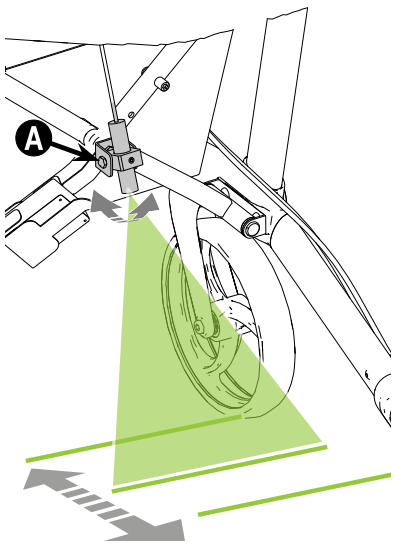

Česky

Obsah

Postup před dalším použitím výrobku 6

Když obdržíte chodítko Gemino 7

Používání chodítka 7

Seřízení chodítka 7

Bezpečnost 8

Údržba 8

Technické údaje 9

Záruka 10

Postup před dalším použitím výrobku

Kontrolní seznam úkonů před dalším použitím výrobku

Chodítko je určeno/vhodné k opakovanému používání.

- ☐ Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně
- ☐ V případě potřeby seřiďte brzdy.
- ☐ Zkontrolujte, že brzdové páky jsou ve správné poloze.
- ☐ Vyčistěte brzdové klínky.
- ☐ Zkontrolujte brzdové pružiny.
- ☐ Zkontrolujte, že kola jsou v dobrém stavu a nepoškozená.
- ☐ Opotřebená nebo poškozená kola vyměňte.
- ☐ Zkontrolujte, že všechny pohyblivé součásti jsou funkční.
- ☐ Zkontrolujte a podle potřeby seřiďte všechny šroubové spoje.
- ☐ Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte zavěšení kol.
- ☐ Ujistěte se, že je chodítko čisté a hygienické.
- ☐ Zkontrolujte, zda je sedadlo v dobrém stavu a zda není poškozené.
- ☐ Poškozené sedadlo vyměňte.
- ☐ Zkontrolujte, zda rám není poškozen a v jeho spojích nejsou vůle.

Gratulujeme vám k výběru vašeho nového chodítka

Kvalita a funkčnost jsou hlavní přednosti všech výrobků spol. Sunrise Medical.

Budeme velice rádi, když nám sdělíte jakékoli zkušenosti s používáním tohoto chodítka. Tímto způsobem můžeme naše výrobky neustále zlepšovat.

Z důvodu vaší bezpečnosti, a abyste maximálně využili vlastnosti svého nového chodítka, vám doporučujeme důkladně si přečíst tento návod k obsluze dříve, než začnete chodítko používat.

Systém řízení SUNRISE MEDICAL má certifikaci ISO 13485 a ISO 14001.

Rychlý popis chodítka Gemino

Chodítko Gemino lze snadno přizpůsobit potřebám jednotlivých uživatelů. Chodítko Gemino má stabilní kola pro snadný pohyb a lehce použitelné brzdy. Chodítko Gemino je možné složit, a usnadnit tak jeho přepravu.

Zamýšlené použití

Chodítko Gemino bylo navrženo jako pomůcka k chození pro osoby s pohybovým omezením. Je možné ho používat ve venkovním i vnitřním prostředí na rovném a zpevněném povrchu. Sedátko chodítka lze využít k odpočinku v průběhu delší procházky. Není určeno k žádnému jinému účelu, např. jako pomůcka ke stoupání nebo k převážení těžkých nákladů.

Indikace

Byly stanoveny tyto specifické indikace:

- kontraktury kloubu/zranění kloubu
- choroby jako jsou srdeční a oběhové poruchy, poruchy rovnováhy nebo kachexie a také pro starší lidi, kteří dosud mají sílu v horní a dolní části těla.

Kontraindikace

Chodítko se nesmí používat v případě těchto onemocnění:

- porucha vnímání
- závažná ztráta rovnováhy
- paralýza
- kontraktura kloubů nebo poškození kloubů na obou pažích.

UPOZORNĚNÍ:
Pamatujte prosím, že jízda na chodítka vyžaduje dostatečné kognitivní, fyzické a vjemové schopnosti. Uživatel musí být schopen posoudit dopady činností v důsledku používání chodítka a v případě potřeby zajistit jejich nápravu. Tyto schopnosti a bezpečné používání dodatečně instalovaných komponentů nemůže posoudit společnost Sunrise Medical jakožto výrobce. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku této skutečnosti.
Přečtěte si návod k obsluze chodítka a dodatečně instalovaných komponentů. Seznamte uživatele s bezpečným používáním chodítka a dodatečně instalovaných komponentů. Informujte uživatele o příslušných varováních, která je zapotřebí si přečíst, porozumět jim a řídit se jimi.

Když obdržíte chodítko Gemino

1 Montáži

Chodítko je standardně dodáváno jako smontované. Vše, co musíte udělat:

- Rozložte chodítko.
- Nastavte tlačné rukojeti do správné výšky.
- Namontujte a seřiďte veškeré příslušenství.
- Zkontrolujte a v případě potřeby seřiďte brzdy.

Obal

Obal zlikvidujte vhodným způsobem, např. ve sběrném dvoře. Použité plasty a kartonové obaly lze recyklovat.

Používání chodítka

2 Jízdní brzda

Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, že jeho brzdy jsou funkční.

- Stiskněte brzdové páky, abyste mohli chodit s pomocí chodítka.
- Uvolněním brzdových pák chodítko zabrzdíte.
- Brzdy se aktivují, když jsou brzdové páky uvolněné.
- Chodítko netlačte, když jsou brzdy v zajištěné poloze. Pokud budete chodítko tlačit, když jsou brzdy zajištěné nebo částečně zajištěné, dojde k poškození pneumatik a brzd, což může znemožnit správnou funkčnost brzd.
- Nepoužívejte chodítko, které má vadné brzdy.

3 Laserové světlo pro případy „zamrznutí“ při chůzi

Laserové světlo zobrazuje zelenou čáru. Dojde-li k „zamrznutí“ při chůzi, je možné takovou situaci vyřešit pomocí laserového světla, které plní funkci vizuálního orientačního bodu.

- Stiskněte tlačítko Ⓐ pro zapnutí laserového světla.
- Laserové světlo se automaticky vypne po uplynutí 15 (+/-3) sekund.

4 Zpomalovací brzda

Chodítko je vybaveno zpomalovací brzdou. Brání „ujetí“ chodítka v důsledku neúmyslných pohybů nebo při chůzi z kopce dolů. Zpomalovací brzda působí odpor při chození.

- Zpomalovací brzdu aktivujete stisknutím rukojeti dolů. Deaktivujete ji přitažením rukojeti nahoru. Když je zpomalovací brzda deaktivovaná, kola chodítka se otáčejí bez odporu.

5 Sed

- Sedejte si vždy na celý potah sedadla, zády ke směru jízdy.
- Jako příslušenství je možné zakoupit síťované opěradlo.

6 Chození s chodítkem

Nejlepší opory a nejbezpečnějšího pohybu dosáhnete při zcela vzpřímené chůzi s chodítkem blízko těla. Zadnici držte rovně se vzpřímeným tělem. Dívejte se dopředu, ne dolů.

> ⚠ **Varování!**
>
> Netlačte chodítko na dlouhou vzdálenost před svým tělem. Mohlo by dojít k pádu a nesprávnému zatížení.
>
> Neopírejte se a ani se nenaklánějte příliš na stranu, když používáte chodítko, neboť boční zatížení způsobí nestabilitu chodítka.

7 Překonávání překážek, naklápěcí lišta

Sešlápněte naklápěcí lištu, aby se nadzvedla přední kola chodítka, když potřebujete přejet přes obrubník, práh nebo jinou překážku.

8 Boční deflektor

Chodítko Gemino je vybaveno bočním deflektorem Ⓐ, který brání přečnívání zadních kol, aby se nezachytávala o překážky jako dveřní zárubně nebo rohy stěn.

9 Složení chodítka

Chodítko se automaticky zajistí ve zcela složené poloze.

- Zatáhněte za popruh Ⓐ a chodítko složte. Jakmile je chodítko zcela složené, zajistí se. To signalizuje slabé cvaknutí.

> ⚠ **Varování!**
>
> Dávejte pozor, aby při skládání nebo rozkládání chodítka nedošlo ke zranění kvůli skřípnutí.
>
> Pamatujte, že chodítko nelze složit do zajištěné polohy ve všech výškových nastaveních! S krytem tlačítka Parkinson namontovaným na vnitřní straně.

9 Rozložení chodítka

Chodítko se automaticky zajistí ve zcela otevřené poloze.

- Ovládací páky odtáhněte od sebe.
- Boční tyče zatlačte dolů, dokud neuslyšíte slabé cvaknutí signalizující dosažení úplně rozložené polohy.
- Před použitím chodítka se přesvědčte, že skládací mechanismus je zajištěn v rozložené poloze.

9 Zvedání a přenášení chodítka

Zvedací rukojeti jsou nejlépe přístupné, když je chodítko složené.

- Než budete chodítko zvedat, nejprve ho složte. To je nejlepší a nejsnadnější způsob s ohledem na jeho hmotnost a polohu zvedacích rukojetí.

Seřízení chodítka

10 Výška tlačných rukojetí

Abyste dosáhli správné polohy pro tlačení a vyvarovali se nesprávného zatížení, tlačné rukojeti se musí nastavit tak, aby uživatel při používání chodítka chodil ve vzpřímené poloze a při tlačení nemusel být ohnutý v zádech.

- Zvedněte západku.
- Zatlačením nebo vytažením nastavte tlačnou rukojeť do správné výšky.
- Uvolněte západku. Tlačná rukojeť se nyní automaticky zajistí ve správné výšce.

11 Funkce paměti pro správnou výšku tlačné rukojeti

Funkce paměti umožňuje rychle nastavit tlačnou rukojeť zpět do správné výšky, pokud byla výška změněna z důvodu přepravy apod.

- Než aktivujete funkci paměti, nejprve musíte určit správnou výšku tlačných rukojetí.
- Imbusovým klíčem 3 mm uvolněte šroub Ⓐ.
- Vytáhněte tlačnou rukojeť.
- Otočte paměťovou zarážku Ⓑ o 90° a vyjměte ji.
- Zarážku umístěte do správné výšky. Nyní není možné tlačnou rukojeť umístit výše než do bodu, kde byla paměťová zarážka, nicméně rukojeť je možné stlačit dolů pro účely přepravy.
- Pevně zavřete západku nastavení výšky Ⓒ , jakmile umístíte tlačnou rukojeť do správné polohy.
- Znovu utáhněte šroub Ⓐ.

12 Nastavení brzd

- Povolte pojistnou matici Ⓐ.
- Nastavte brzdu šroubováním seřizovací matice lanka Ⓑ směrem dovnitř nebo ven.
- Vyzkoušejte funkčnost brzd tak, že uvolníte brzdové páky.
- Kola by se měla úplně zablokovat

13 Nastavení odporu zpomalovací brzdy

- Otáčením knoflíku Ⓐ nastavte velikost odporu.
- Ujistěte se, že obě kola mají nastavený stejný odpor.

14 Nastavení laserové čáry

Umístění laserové čáry je možné upravit.

- Povolte šroub Ⓐ a nastavte umístění laseru tak, aby laserová čára dosahovala do požadované polohy.
- Utáhněte šroub.

Bezpečnost

⚠ Varování!

Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, že jeho brzdy jsou funkční.

Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, zda je jeho laser funkční.

Laserové záření - Nedívejte se do paprsku.

Před použitím chodítka vždy zkontrolujte potah sedadla. Pokud je poškozený, je třeba jej vyměnit.

Po rozložení chodítka se ujistěte, že skládací mechanismus je zajištěn.

Když chodítko zastavíte nebo zaparkujete, vždy použijte parkovací brzdu.

Zkontrolujte, že chodítko bylo nastaveno do správné výšky, aby nedošlo k nesprávnému zatížení a pádu. Netlačte chodítko na dlouhou vzdálenost před svým tělem.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění kvůli skřípnutí; nestrkejte prsty mezi pohyblivé součásti chodítka. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména při skládání a rozkládání chodítka.

Uživatelé se musí s chodítkem pohybovat po chodnících, ne po silnicích pro vozidla. Pokud používáte chodítko venku, používejte osvětlení.

Nepoužívejte chodítko k jiným účelům, než k jakým je určeno. Nesmí se používat k přepravě osob nebo těžkých nákladů.

Buďte obezřetní, pokud jsou ve vaší blízkosti děti. Nenechte děti, aby si hrály s chodítkem.

Maximální hmotnost uživatele chodítka je:
130 kg Gemino 30
130 kg Gemino 30 M

Maximální zatížení košíku je 5 kg.

Chodítko byste měli pravidelně kontrolovat, jestli jsou všechny šrouby a další upevňovací prvky řádně utažené.

Neprovádějte změny nebo úpravy na chodítku, které mohou negativně ovlivnit jeho bezpečnost, jež je integrovaná do jeho konstrukce.

Nepoužívejte chodítko, jestliže je poškozené nebo nefunguje správným způsobem. Obraťte se na prodejce s žádostí o opravu.

Nikdy nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo schváleno společností Sunrise Medical.

Údržba

Údržba popsaná v této části může být prováděna uživatelem. Ostatní činnosti údržby musí být prováděny odborným personálem u prodejce nebo ve středisku technické podpory. Informace o opravách a servisu získáte ve středisku technické podpory ve svém regionu.

Čištění

Správné čištění a dezinfekce výrobku jsou nezbytné pro prodloužení jeho životnosti a udržení jeho nového vzhledu po delší dobu, ale také pro zabránění šíření bakterií a virů, jako je např. COVID-19.

Čištění versus dezinfekce

V první řadě je třeba si uvědomit, že čištění není totéž co dezinfekce. Čištěním odstraňujeme z povrchů zárodky a nečistoty, ale nezabíjíme je. Jejich odstraněním se pouze sníží počet zárodků a riziko šíření infekcí.

Na druhou stranu dezinfekcí chodítka ničíme mikroorganismy, jako jsou bakterie, pomocí chemických přípravků. Tento proces nemusí nutně vyčistit znečištěné povrchy. Zabití zárodků na povrchu po čištění může dále zabránit šíření infekčních onemocnění.

Čištění rámu

Rám by měl být pravidelně omýván teplou mýdlovou vodou do max. teploty 60 °C. Pokud je rám velmi znečištěný, lze použít odmašťovací prostředek. Rám je možné umývat vysokotlakou hadicí. Při použití této metody nestříkejte vodu přímo na kuličková ložiska. Po skončení mytí nebo pokud jste chodítko používali v dešti, důkladně ho vysušte, například v sušárně. Pokud jste k čištění použili odmašťovací prostředek, pohyblivé součásti by se měly následně namazat.

Dezinfekce

Dezinfekci smí provádět pouze odborný personál. Chodítko lze dezinfikovat dezinfekčním prostředkem obsahujícím 70–80 procent etanolu, max. 1000 ppm chloridu (bělidlo) nebo horkou vodou do 85° po dobu max. 10 minut. Nepoužívejte desinfekční prostředky, které obsahucí fenoly.

⚠ Nebezpečí!

Pokud chodítko používá více osob, je třeba jej pečlivě čistit, aby nedošlo k šíření infekce. Hygienická opatření pro použitý vozík: Dříve než bude invalidní vozík používat jiná osoba než původní majitel, je třeba jej pečlivě připravit. Věnujte pozornost pokynům výrobce desinfekčního prostředku, který používáte.

Dříve než bude chodítko používat jiná osoba než původní majitel, je třeba jej pečlivě připravit. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s uživatelem, je nutno ošetřit desinfekčním sprejem. Musíte k tomu použít desinfekční prostředek schválený nebo doporučený ve vaší zemi, který zajistí rychlou desinfekci na bázi alkoholu pro zdravotnické výrobky a prostředky, které je nutno desinfikovat rychle. Dbejte pokynů výrobce desinfekčního prostředku, který používáte. Obecně nelze zajistit úplnou desinfekci ve švech. Proto vám doporučujeme zlikvidovat potah sedadla a zad pro zamezení vzniku mikrobakteriální kontaminace aktivními chemickými látkami podle místního zákona o ochraně proti infekcím.

⚠ Pozor!

Nepoužívejte rozpouštědla, bělidla, brusné prostředky, syntetické saponáty, voskové leštěnky nebo aerosoly. Lze však použít rozředěné desinfekční prostředky podle návodu jejich výrobce. Povrchy důkladně setřete čistou vodou a pečlivě osušte. Dezinfikujte jej pomocí speciálního dezinfekčního prostředku na povrchy nebo pomocí ubrousků, které obsahují 70–80% roztok etanolu/alkoholu, nebo jiných schválených roztoků na dezinfekci povrchů zakoupených v obchodě. Tyto přípravky jsou označeny jako baktericidní a virucidní. Sanitační prostředek musí zůstat na povrchu nejméně 15 minut. Povrch by se měl poté očistit utěrkou a opláchnout aseptickým hadříkem.

⚠ Varování!

Vždy si přečtěte štítek o veškerých čistících prostředcích ke komerčnímu použití nebo pro domácnost. Vždy pečlivě dodržujte pokyny.

⚠ Pozor!

Písek a mořská voda (nebo sůl v zimě) mohou poškodit ložiska kol. Po vystavení působení soli invalidní vozík pečlivě vyčistěte.

⚠ Pozor!

Nadměrné používání chemických prostředků nebo používání nevhodných prostředků může způsobit korozi nebo znehodnocení použitých materiálů. • Tělesné tekutiny mohou způsobit korozi nebo znehodnocení použitých materiálů. Dojde-li ke kontaktu s tělesnými tekutinami, příslušné části vozíku vyčistěte a dezinfikujte.

Čištění brzd

Pravidelně čistěte brzdové klíny a brzdové pružiny.

Čištění košíku

Košík lze vyjmout a vyčistit samostatně. Můžete jej vyprat v automatické pračce (60 °C), v ruce (40 °C) nebo dezinfikovat.

K dezinfekci použijte schválený dezinfekční čisticí prostředek. Nepoužívejte tepelnou dezinfekci.

Podmínky, které mohou poškodit chodítko

Chodítko by se nemělo používat při teplotách nižších než -35 °C nebo vyšších než 60 °C. Na vlhkost ani tlak vzduchu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. Podmínky skladování nevyžadují žádné další požadavky.

Šrouby a matice

Šrouby a matice se mohou v průběhu času povolovat. Proto je nezapomeňte pravidelně kontrolovat a v případě potřeby utahovat. Na jejich závity můžete nanést zajišťovací prostředek, například modrý Locktite (č. 243).

Pokud byly pojistné matice demontovány, zhorší se jejich jisticí funkce a musí být vyměněny.

Dezinfekce

Dezinfekci smí provádět pouze odborný personál. Chodítko lze dezinfikovat pomocí dezinfekčního prostředku se 70–80% koncentrací etanolu. Nepoužívejte dezinfekční prostředky obsahující bělidla nebo fenoly.

Hygienická opatření pro použitý výrobek:

Dříve než bude chodítko používat jiná osoba než původní majitel, je třeba jej pečlivě připravit. Všechny povrchy, které přicházejí do styku s uživatelem, je nutno ošetřit desinfekčním sprejem.

Musíte k tomu použít desinfekční prostředek schválený nebo doporučený ve vaší zemi, který zajistí rychlou desinfekci na bázi alkoholu pro zdravotnické výrobky a prostředky, které je nutno desinfikovat rychle.

Dbejte pokynů výrobce desinfekčního prostředku, který používáte.

Pravidelná kontrola

- Zkontrolujte, zda brzdy fungují správně. Podle potřeby seřiďte.
- Zkontrolujte, že jsou kola v dobrém stavu a nepoškozená.
- Zkontrolujte chodítko, jestli je čisté a zda všechny pohyblivé části fungují správně.
- Zkontrolujte a podle potřeby seřiďte všechny šroubové spoje.

Výměna baterií

Baterie je zapotřebí vyměnit přibližně jednou za rok, v závislosti na používání laseru. Nejprve odpojte tlačítko a laser od elektrické skříňky. Vycvakněte elektrickou skříňku ze základní desky a vyměňte 3 baterie typu AA. Používejte pouze baterie vysoké kvality. Namontujte elektrickou skříňku zpět na základní desku tak, že ji zacvaknete na místo. Dbejte, aby otvory pro připojení tlačítka a laseru směřovaly k zemi. Připojte zpět laser a tlačítko, chodítko je znovu připraveno k používání.

Opravy

Kromě drobných oprav nátěru, výměny kol a seřizování brzd musí být všechny opravy prováděny odborným personálem místního prodejce nebo ve středisku technické podpory.

Informace o opravách a servisu získáte ve středisku technické podpory ve svém regionu.

Skladování

Chodítko skladujte postavené.

Chodítko je možné nechávat venku.

Přeprava

Sklopte chodítko před tím, než ho budete přepravovat. Chodítko by se mělo zvedat a přenášet za zvedací rukojeti.

Nikdy nezvedejte chodítko za brzdová lanka nebo sedací popruh.

Technické údaje

Použité materiály

Chodítko a většina součástí jsou vyrobeny ze speciální hliníkové slitiny.

Oblasti použití

Chodítko je určeno pro vnitřní i venkovní použití na rovném a zpevněném povrchu. Bylo vyvinuto pro osoby se sníženou svalovou silou, omezenou pohyblivostí, sníženou mobilitou a omezenou stabilitou.

Předpokládaná životnost výrobku je 10 let.

Likvidace / recyklace materiálů

V následující kapitole je popis materiálů použitých na chodítku z hlediska likvidace nebo recyklace chodítka a jeho obalu. Mohou také existovat speciální platné místní předpisy pro likvidaci a recyklaci, které je nutno respektovat při likvidaci vašeho chodítka. (Mohou zahrnovat čištění a dekontaminaci chodítka před likvidací.)

Hliník: příčné výztuhy, tlačné rukojeti, boční rámové trubky

Ocel: Upevňovací body, osy.

Plasty: Kola, rukojeti, trubkové dorazy, kolečka a pneumatiky.

Obal: karton.

Čalounění: Polyesterová tkanina s povrchovou úpravou z PVC.

Likvidaci či recyklaci je třeba provádět prostřednictvím autorizovaného zástupce či na autorizovaném místě k likvidaci. Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem. Předávejte je k ekologické likvidaci na zákonem stanovená místa.

Více informací o ekologické likvidaci elektronických součástí a baterií typu AAA získáte u místní společnosti zabývající se likvidací odpadů. Alternativně můžete chodítko vrátit k likvidaci prodejci.

Označení CE

SUNRISE MEDICAL jakožto výrobce prohlašuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení o zdravotnických prostředcích (2017/745).

Upozornění pro uživatele anebo klienta: Jakákoli závažná nehoda, ke které dojde v souvislosti s tímto zařízením, by se měla oznámit výrobci a kompetentnímu orgánu členského státu, ve kterém se uživatel nebo klient nachází.

Zvláštní úpravy výrobku B4Me

Společnost Sunrise Medical důrazně doporučuje, abyste si před prvním použitím výrobku přečetli všechny informace pro uživatele dodané s výrobkem B4Me a porozuměli jim. Jedině tak lze zajistit funkčnost výrobku B4Me tak, jak je určeno jeho výrobcem.

Společnost Sunrise Medical dále doporučuje, abyste informace pro uživatele nevyhazovali, ale uschovali je na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Kombinace zdravotnických zařízení

Toto zdravotnické zařízení může být možné zkombinovat s jedním nebo více jinými zdravotnickými zařízeními či jiným produktem. Informace o možných kombinacích naleznete na stránce www.medicco.cz. Všechny uvedené kombinace byly ověřeny a splňují všeobecné požadavky na bezpečnost a výkonnost uvedené v příloze I oddílu 14.1 nařízení pro zdravotnická zařízení 2017/745.

Příslušné pokyny ke kombinaci, např. k montáži, naleznete na stránce www.medicco.cz.

Záruka

TATO ZÁRUKA NIKTERAK NEOMEZUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA.

Sunrise Medical* poskytuje svým zákazníkům záruku, jak je uvedena v záručních podmínkách na výrobky, která pokrývá následující.

Záruční podmínky:

1. Záruka 24 měsíců se vztahuje na výrobní nebo materiálové vady všech součástí výrobku. Vadná součást v rámci této lhůty bude zdarma vyměněna nebo opravena. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
2. Pro uplatnění záruky se, prosím, obraťte na zákaznické centrum společnosti Sunrise Medical s přesnými informacemi o povaze potíží. Jestliže bude zákazník výrobek používat mimo oblast působnosti poskytovatele služeb zákaznického servisu Sunrise Medical, opravy nebo výměny budou provedeny jiným poskytovatelem, jenž bude určen výrobcem. Výrobek musí být opraven poskytovatelem služeb zákaznického servisu určeným společností Sunrise Medical (obchodní zástupce).
3. Na díly, které byly opraveny nebo vyměněny v rámci této záruky, je poskytována záruka v souladu s bodem 1 těchto záručních podmínek po zbývající dobu záruky na výrobek.
4. Na originální náhradní díly, nainstalované na náklady zákazníka, se poskytuje záruka v délce trvání 12 měsíců (od montáže), v souladu s těmito záručními podmínkami.
5. Nárok na tuto záruku nevzniká, jestliže je oprava nebo výměna výrobku nebo jeho části vyžadována z následujících důvodů:
   a. Normální opotřebení, které mimo jiné zahrnuje následující součásti: baterie, opěrky rukou, čalounění, pneumatiky, brzdové segmenty, ochranné kroužky atd.
   b. Výrobek, který byl přetěžován. Maximální hmotnost uživatele je uvedena na výrobním štítku.
   c. Jedná se o výrobek nebo díl, jehož údržba nebo servis nebyli prováděny v souladu s doporučeními výrobce, uvedenými v příručce uživatele nebo v servisní příručce.
   d. Bylo použito příslušenství, které není specifikováno jako originální příslušenství.
   e. Došlo k poškození chodítka nebo jeho součásti v důsledku zanedbání, nehody nebo nesprávného používání.
   f. Na výrobku nebo jeho části byly provedeny změny/úpravy, které se liší od požadavků výrobce.
   g. Opravy byly provedeny před tím, než byl o okolnostech informován zákaznický servis společnosti Sunrise Medical.
6. Tato záruka podléhá zákonům země, ve které byl výrobek od společnosti Sunrise Medical zakoupen.

* To znamená, provozovnu společnosti Sunrise Medical, ve které byl výrobek zakoupen.

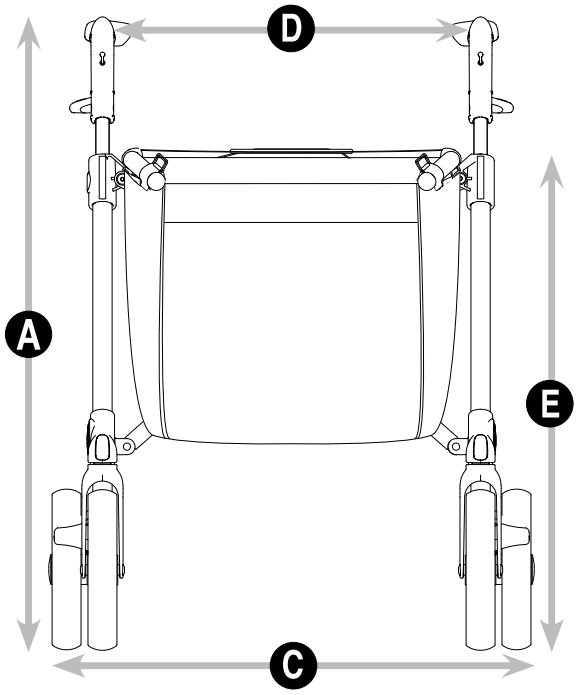

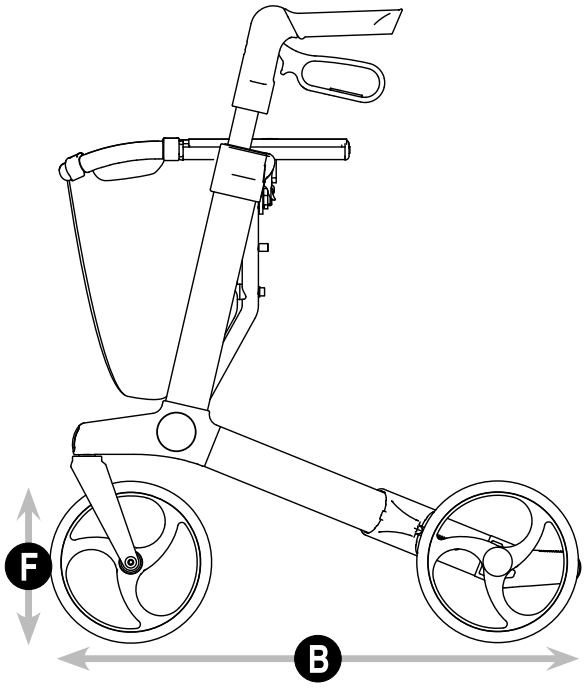

	CZ	Gemino 30 Parkinson	Gemino 30 M Parkinson
A	Celková výška, od země po nejvyšší bod tlačných rukojetí	780 - 1000 mm	690 - 880 mm
B	Celková délka	650 mm	650 mm
C	Celková šířka	600 mm	600 mm
D	Šířka mezi tlačnými rukojeťmi	470 mm	470 mm
E	Výška sedadla	620 mm	550 mm
	Výška ve složeném stavu	800 mm	760 mm
	Délka ve složeném stavu	650 mm	650 mm
	Šířka ve složeném stavu	230 mm	230 mm
	Kruh otáčení	840 mm	840 mm
F	Přední/zadní kola	200 x 36 mm	200 x 36 mm
	Celková hmotnost	7,8 kg	7,7
	Maximální hmotnost uživatele	130 kg	130 kg
	Max. nosnost košíku	5 kg	5 kg
	Doporučená výška uživatele	1500-2000 mm	1350-1700 mm

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 – Montale
29122 Piacenza
Italia
Tel.: +39 0523 573111
Fax: +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel. +41 (0)31 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
Norge
Telefon: +47 66 96 38 00
Faks: +47 66 96 38 80
post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Sunrise Medical AB
Neongatan 5
431 53 Mölndal
Sweden
Tel.: +46 (0)31 748 37 00
post@sunrisemedical.se
www.SunriseMedical.se

MEDICCO s.r.o.
H – Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
Tel.: (+420) 547 250 955
Fax: (+420) 547 250 956
www.medicco.cz
info@medicco.cz
Bezplatná linka 800 900 809

Sunrise Medical Aps
Mårkærvej 5-9
2630 Taastrup
Denmark
+45 70 22 43 49
info@sunrisemedical.dk
Sunrisemedical.dk

Sunrise Medical Australia
11 Daniel Street
Wetherill Park NSW 2164
Australia
Ph: +61 2 9678 6600
Email: enquiries@sunrisemedical.com.au
www.SunriseMedical.com.au

Prodejce/distributor:

Výrobní číslo:

CE

SUNRISE MEDICAL

OM_MB4400_Gemino Parkinson_CZ_
Rev.R_2025-11-04

Sunrise Medical GmbH
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/Heidelberg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7253/980-0
Fax: +49 (0) 7253/980-222
www.SunriseMedical.de

Sunrise Medical
Thorns Road
Brierley Hill
West Midlands
DY5 2LD
England
Phone: 0845 605 66 88
Fax: 0845 605 66 89
www.SunriseMedical.co.uk

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
Tel.: +34 (0) 902142434
Fax: +34 (0) 946481575
www.SunriseMedical.es

Sunrise Medical Poland
Sp. z o.o.
ul. Elektronowa 6,
94-103 Łódź
Polska
Telefon: + 48 42 275 83 38
Fax: + 48 42 209 35 23
E-mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu
(International)

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : +33 (0) 2 47 55 44 00
Email: info@sunrisemedical.fr
www.sunrisemedical.fr