GrandSlamX

RGK

Al

ALUMINIUM 7020

Stand: 14.04.2025

CE

Rechnungsadresse oder Kundennummer		**Versandadresse** (falls von Rechnungsadresse abweichend)	
Kontaktperson	_____	Kontaktperson	_____
Strasse	_____	Strasse	_____
PLZ / Ort	_____	PLZ / Ort	_____
E-Mail	_____	E-Mail	_____
Fon	_____	Fon	_____

Zusätzliche Informationen

☐ Kostenvoranschlag	☐ Bestellung	Nutzername	_____
Datum	_____	Nutzergewicht (kg)	_____
Kommission	_____	Nutzergrösse	_____
Sunrise Medical Auftrags-Nr.	_____	E-Mail	_____

Wichtige Hinweise

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
Alle Preise in CHF exkl. MWST. Unverbindliche Preisempfehlung.

☐ **Hiermit bestätige ich die nachfolgenden Informationen verstanden und akzeptiert zu haben.**

Für die Offert- sowie Auftragserstellung verrechnen wir Ihnen im Vorfeld CHF 295.00 netto, exkl. MWST. Das beinhaltet die erste CAD-Zeichnung inkl. zwei Anpassungen. Dieser Betrag wird Ihnen bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

Ab der dritten CAD-Anpassung werden erneut CHF 295.00 netto exkl. MWST in Rechnung gestellt.

Nach der Auftragsbestätigung erhalten Sie eine CAD-Zeichnung des Rollstuhls. Mit Ihrer Unterschrift, unter dieser Zeichnung, geben Sie die Produktion des massgefertigten RGK Rollstuhls frei. **Nur mit einer unterschriebenen Zeichnung wird Ihr Rollstuhl gebaut.**

Bitte beachten Sie, dass massgefertigte RGK Rollstühle vom Umtausch ausgeschlossen sind.

SUNRISE MEDICAL

GrandSlamX

RGK

Anleitung:

● Standard ■ Standard Optionen □ Zusätzliche Optionen ⓘ Benötigte Informationen

RAHMENDESIGN

● **GXAXZ010 GRANDSLAM X**
CHF 5'990

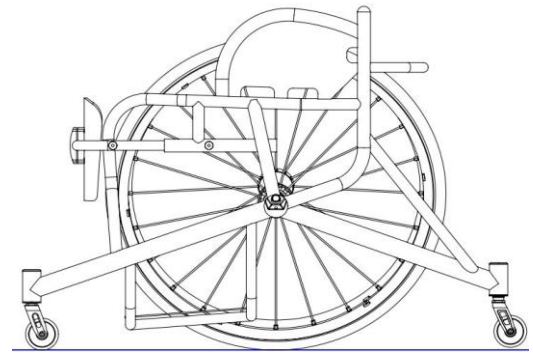

Max. Zuladung: 125 kg

BITTE BEACHTEN: ALLE RGK ROLLSTÜHLE SIND HANDGEFERTIGT UND HABEN EINE HERSTELLUNGS-MASSTOLERANZ VON +/- 5 MM

GRUNDMASSE

■ XY010 Sitzbreite ***(gemessen zwischen den Seitenteilen)***

ⓘ _____ mm *(max. 500 mm)* *(min. 250 mm)*

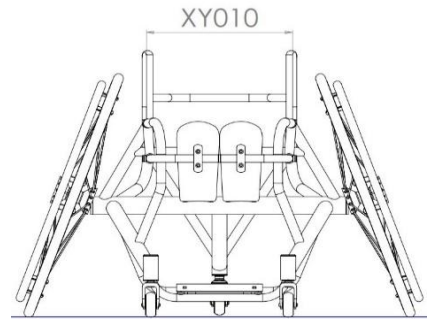

■ XY020 Sitztiefe

ⓘ _____ mm *(max. 500 mm)* *(min. 250 mm)*

□ XY030 Zusätzliche Rahmenlänge *(für zusätzliche Beinführung und Griff z. B. bei / für Transfers)*

ⓘ _____ mm *(Nicht mit XA200)*

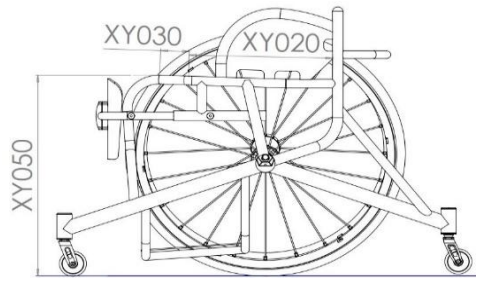

■ XY050 Vordere Rahmenhöhe

ⓘ _____ mm *(max. 630 mm)* *(min. 360 mm)*

■ XY060 Hintere Rahmenhöhe

ⓘ _____ mm *(max. 630 mm)* *(min. 360 mm)*

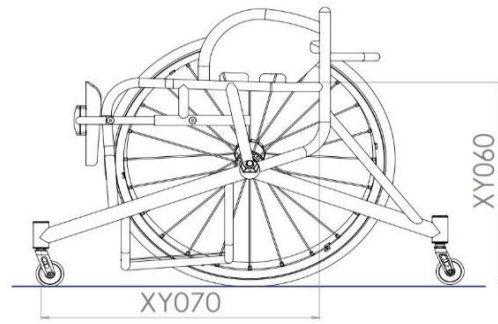

■ XY070 Rahmenlänge *(beeinflusst auch den Rahmenwinkel)*

ⓘ _____ mm *(min. XY020 + XY030 + 110 mm)*

□ XA020 Ergositz *(angewinkeltes Sitzrohr für verbesserte Beckenpositionierung)*
CHF 89

Länge

ⓘ _____ mm *(Standard = 120 mm)*

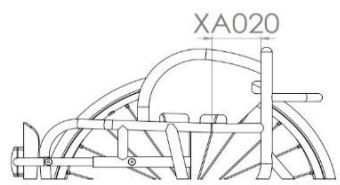

SUNRISE MEDICAL

FRONTRAHMEN

Verjüngung Frontrahmen

☐ XY080 Frontrahmen: Einzug oben;
Biegung Vorderkante der Sitzbespannung
(Breite des Frontrahmens oben, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

Breite _____ mm

(Optional für Frontrahmenbreite (oben) kleiner als Sitzbreite: verbesserte Unterschenkel-positionierung und -führung.)

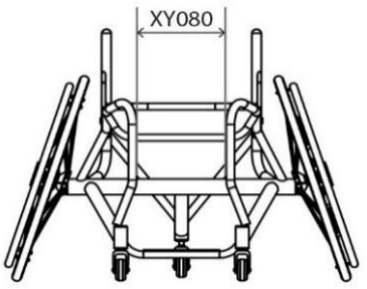

☐ XA130 Frontrahmen: V-förmig, nach unten verjüngt
CHF 236
(Breite des Frontrahmens unten, gemessen von Rahmeninnenseite zu Rahmeninnenseite)

Breite _____ mm

(Die Verjüngung der Rahmenrohre beginnt am hinteren Ende der Sitzfläche, d.h. die Sitzbreite wird nach vorne schmaler.)

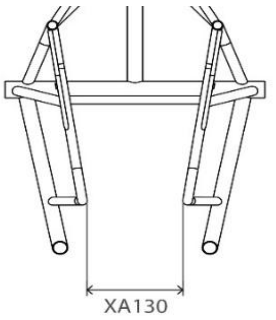

Verjüngung Frontrahmen: Weitere Optionen

☐ XA136 Paralleles Frontrahmen-Design
CHF 93 *(nicht mit Frontrahmen XY080)*

Breite Frontrahmen _____ mm

(Der Einzug beginnt erst sehr spät und unterhalb des Kniewinkels. Dadurch ist der Frontrahmen im oberen Bereich noch breit (Sitzbreite) und verjüngt sich erst weiter unten.)



☐ XA131 V-förmig nach vorne zulaufende Sitzrohre in
CHF 317 Kombination mit Rahmeneinzug

Breite Sitzfläche vorne (A) _____ mm

Breite Frontrahmen (B) _____ mm



Knieschutz

☐ XA200 Knieschutz mit Rastergurt
*(Rohre an der **Aussenseite**)*

Länge _____ mm

☐ *Optimierte Masse (am kürzesten)*

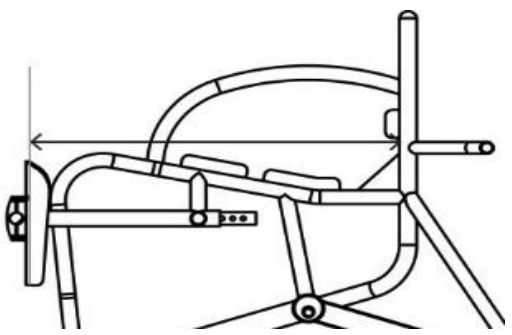

☐ XA202 Schienbeinschoner, Kunststoff
(inkl. Polsterung, 5 mm, hart)

☐ XA203 Schienbeinschoner, Karbon
CHF 379 *(inkl. Polsterung, 7 mm, hart)*

☐ XA204 Extra Polsterung + Überzug für Schienbeinschoner
CHF 93

Dicke der Polsterung _____ mm

Härte der Polsterung angeben

☐ Medium ☐ Hart

Sitzfläche

☐ XR040 Sitzplatte Alu, mit Stützrohren
CHF 147 ***(an Rahmen genietet)***

Länge der Sitzplatte _____ mm *(Std. XY020 -20 mm)*

☐ XR050 Sitzplatte Karbon, mit Stützrohren
CHF 370 ***(an Rahmen genietet)***

Länge der Sitzplatte _____ mm *(Std. XY020 -20 mm)*

FUSSRASTE

Fussraste fix

☐ GXAXB080 Fussraste fest verschweisst
(keine Höhenverstellung möglich)

Höhe und Position

☐ Fussrastenhöhe vorne

_____ mm *(min. 35 mm)*

☐ Fussrastenhöhe hinten

_____ mm *(min. 35 mm)*



☐ Abstand Fussraste zur Lenkradaufnahme

_____ mm



Grösse Fussbrett (nicht für Fussbrett ABS Kunststoff)

☐ Fussbrett Breite

_____ mm *(Std. = 200 mm)*



☐ Fussbrett Tiefe

_____ mm *(Std. = 250 mm)*



Fussraste

☐ XB180 Fussraste, Alu
(2.5 mm)

☐ XB190 Fussraste, Karbon
CHF 244

☐ GXAXB140 Distanz-Kit
CHF 20 *(+25 mm Höhenverstellung)*

☐ XB100 Fussraste geformt, ABS Kunststoff
CHF 143

Länge

_____ mm *(max. 380 mm)* *(Std. = 330 mm)*

Fussrastenabdeckung

☐ XB240 Erhöhte Kanten, Alu
CHF 83 *(Kosten pro Kante)*

☐ *Vorne* ☐ *Hinten* ☐ *Links* ☐ *Rechts*

Höhe

_____ *(max. 60 mm)*

☐ XB250 Erhöhte Kanten, Karbon
CHF 573 *(nur eine Seite)*

☐ *Vorne* ☐ *Hinten*

Höhe

_____ *(max. 45 mm)*

Abstand Lenkräder

■ XY330 Abstand Lenkräder *(gemessen von Lenkradgabelbolzen zu Lenkradgabelbolzen)*

_____ mm *(max. 320 mm)*

☐ Optimierte Masse
(Fussbrettbreite +50 mm)

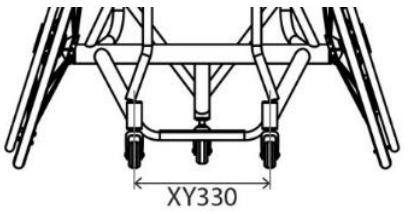

GrandSlamX

RgK

RAMMSCHUTZBÜGEL & KIPPSCHUTZ

Schwerpunkt

☐ GXAXY510 Fixer Schwerpunkt, fest verschweisst

Masse angeben

ⓘ _____ mm

*(**Notiz:** Gemessen wird von der Vorderseite Rückenrohr bis Achsmitte)*



Radsturz & Kippschutz

■ XY390 Radsturz in Grad

ⓘ 18 ☐ 20 ☐ 22 ☐

■ GXAXJ040 Sport-Kippschutz, fest verschweisst

Abstand zum Hinterrad

ⓘ _____ mm *(Std. = 100 mm)*



SEITENTEILE

☐ GXAXE240 Seitenteil, verschweisst, Sport
CHF 415

☐ GXAXE230 Seitenteil, verschraubt, Karbon
CHF 265

☐ XE030 Seitenteil, verschraubt, Alu
CHF 196

☐ XE050 Seitenteil, verschraubt, Karbon
CHF 265

Abmessungen Seitenteil

☐ Seitenteil Länge

ⓘ _____ mm

☐ Seitenteil Höhe

ⓘ _____ mm



☐ 25 mm über dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)

☐ Individuell über dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)

ⓘ _____ mm

☐ Bündig mit dem Reifen
(dem Radverlauf folgend)



RÜCKEN

Rückenhöhe

☐ XY230 Rückenhöhe fix (fest verschweisst)

Höhe

ⓘ _____ mm



☐ XY245 Rückenhöhe verstellbar
CHF 143 *(+/-25 mm)*

Höhe

ⓘ _____ mm



Rückenwinkel / Lumbalknick / Verjüngung oder Aufweitung der Rückenbreite

■ XY360 Rückenwinkel

-5 ☐ -3 ☐ 0 ☐ +3 ☐ +5 ☐

Individuell *(max. -10 / +10 Grad)*

ⓘ _____ Grad



☐ XG100 Lumbalknick
CHF 89

Höhe bis zum Knick

ⓘ _____ mm



Tiefe des Knicks

ⓘ _____ mm



☐ XG110 Verjüngung der Rückenbreite
CHF 89 *(nicht mit XY245)*

Breite oben
(Innenseite zu Innenseite)

ⓘ _____ mm



☐ XG120 Aufweitung der Rückenbreite
CHF 89 *(nicht mit XY245)*

Breite oben
(Innenseite zu Innenseite)

ⓘ _____ mm



SUNRISE MEDICAL

GrandSlamX

RGK

LENKRÄDER UND ANTRIEBSRÄDER

Lenkräder und Lenkradgabeln

- ■ XC160 — Lenkrad, Sport, 61 mm *(Schwarz)*
- ■ XC170 — Lenkrad, Sport, 72 mm *(Schwarz)*
- ☐ XC181 — "Bones Reds" Kugellager *(alle Kugellager der Lenkräder)*
- ☐ XC182 **CHF 309** — "Bones Swiss Ceramic" Kugellager *(alle Kugellager der Lenkräder)*

Antriebsräder

Radgrösse

- ☐ XY420 Radgrösse 24"
- ☐ XY430 Radgrösse 25"
- ☐ XY440 Radgrösse 26"
- ☐ XY450 Radgrösse 700c

Abstand Antriebsrad / Seitenteil

☐ XY460 Abstand Rad zu Seitenteil / Rahmer

15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐

Individuell _____ mm



ODER

☐ XY470 Abstand Rad zu Rad
Wird zu XA130, XA131 benötigt

_____ mm



Antriebsräder

- ☐ XK080 **CHF 771** — Spinergy **SLX** 24 Speichen
- ☐ XK100 **CHF 813** — Spinergy **XSLX** 24 Speichen

Auswahl Farbe Spinergy Speichen

☐ Schwarz ☐ Weiss ☐ Gelb
☐ Rot ☐ Blau ☐ Pink
☐ Lila ☐ Orange ☐ Grün

☐ XK180 **CHF 181** — Individuelle Speichenfarbe *(bitte hier angeben)*

Innen: _____

Aussen: _____

Auswahl Farbe Spinergy Nabe/Felge, eloxiert

- ■ XK190 Nabe/Felge Schwarz
- ☐ XK200 **CHF 95** Nabe/Felge Silber
- ☐ XK201 **CHF 382** Nabe/Felge Rot
- ☐ XK205 **CHF 392** Individuelle Farbe Nabe/Felge: _____
- ☐ XK202 **CHF 382** Nabe/Felge Lila
- ☐ XK203 **CHF 382** Nabe/Felge Blau
- ☐ XK204 **CHF 382** Nabe/Felge Gold

Greifreifenanbau

- ☐ XY480 Anbau eng
- ☐ XY485 Anbau weit
- ☐ XL090 **CHF 113** — Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen (nur bei Greifringanbau eng möglich) *(empfohlen für engen Abstand Seitenteil / Rad)*
- ☐ XL080 **CHF 226** — Greifreifenanbau supereng und Entfernen des Überstands der Befestigungslaschen *(nur mit XL040)*

Greifreifen

- ☐ XL010 — Greifreifen, Alu, eloxiert, **6 Befestigungslaschen**
- ☐ XL040 **CHF 267** — Greifreifen, Titan, **6 Befestigungslaschen** ***(nicht mit 700c)***
- ☐ XL070 **CHF 113** — Greifreifen, Alu, eloxiert, **12 Befestigungslaschen** ***(nicht mit 24")***
- ☐ XL100 **CHF 315** — Greifreifen, Para grip, **6 Befestigungslaschen** ***(nicht mit 700c)***
- ☐ XL020 **CHF 315** — Greifreifen, Tetra Grip, **6 Befestigungslaschen**

Bereifung

- ☐ XM070 — Kenda Kaliente ☐ *Rot* ☐ *Blau*
- ☐ XM095 **CHF 45** — Kenda Wide *(nur in Grau)*
- ☐ XM150 **CHF 92** — IRC Exeracer Pro *(nur in Rot)*
- ☐ XM080 **CHF 93** — Tufo MS3, schlauchlos *(nur in Blau)*

Schlauch

- ☐ XY500 — Schlauch mit Schraeder-Ventil
- ☐ XY490 — Schlauch mit Presta-Ventil *(Standard wenn nichts gewählt wird)*

GrandSlamX

RGK

RAHMEN OBERFLÄCHE

Rahmen / Anbauteile

☐ XN010 Rahmenfarbe pulverbeschichtet

☐ XN150 Anbauteile pulverbeschichtet *(in Rahmenfarbe, wenn keine Angabe)*

Rahmen	Anbauteile	***Glänzend***	Rahmen	Anbauteile	***Matt***	Rahmen	Anbauteile	***Spezial***
☐	☐	Black gloss 103	☐	☐	Black matt 105	☐	☐	Chrome Mirror 300
☐	☐	White gloss 100	☐	☐	White matt 101	☐	☐	Sparkle silver 170
☐	☐	Grey gloss 132	☐	☐	Grey matt 131	☐	☐	Metallic black matt 104
☐	☐	Cream gloss 135	☐	☐	Light grey matt 133	☐	☐	Metallic grey matt 130
☐	☐	Red gloss 108	☐	☐	Navy blue matt 152	☐	☐	Black sandpaper 201
☐	☐	Yellow gloss 120				☐	☐	Grey sandpaper 202
☐	☐	Forest green gloss 143				☐	☐	White sandpaper 200
☐	☐	Green gloss 107						
☐	☐	Dark blue gloss 151						
☐	☐	Royal blue gloss 154						
☐	☐	Blue gloss 174						
☐	☐	Duckegg blue gloss 141						
☐	☐	Pink gloss 188						
☐	☐	Orange gloss 180						
☐	☐	Purple gloss 157						

☐ XN200 **CHF 205** Individuelle Lackfarbe (RAL-Code): _____ Rahmen ☐ Anbauteile ☐

☐ GXAXN030 **CHF 263** Oberfläche unbeschichtet, gebürstet ***(Alle Anbauteile schwarz, ausser XN160 wird gewählt)***

☐ GXAXN050 **CHF 514** Oberfläche unbeschichtet, poliert ***(Alle Anbauteile schwarz, ausser XN170 wird gewählt)***

☐ XN160 **CHF 112** Anbauteile unbeschichtet, gebürstet *(nicht erforderlich bei GXAXB080 und XY230)*

☐ XN170 **CHF 174** Annauteile unbeschichtet, poliert *(nicht erforderlich bei GXAXB080 und XY230)*

Akzentfarbe

Lenkradgabeln, Kappe der Lenkradanbindung und Aufkleber

☐ Schwarz ☐ Silber ☐ XN250 **CHF 205** Individuelle Akzentfarbe: _____

☐ Rot ☐ Blau

☐ Lila

BESPANNUNG

Sitzbespannung

☐ XP040 Sitzbespannung, anpassbar

Rückenbespannung

☐ XP055 Rückenbespannung "Airtech Sport", anpassbar, atmungsaktiv, schwarz

☐ XP070 **CHF 133** Rückenbespannung, Ecken Leder verstärkt, schwarz

Rückenbespannung (Farbe der Nähte)

☐ Silber ☐ Schwarz ☐ Blau ☐ Individuelle Farbe: _____

☐ Rot ☐ Orange ☐ Lila

Rückenbespannung (Farbe des RGK-Schriftzugs)

☐ Weiss (Std.) ☐ Grün ☐ Blau ☐ Individuelle Farbe: _____

☐ Rot ☐ Orange ☐ Lila

SUNRISE MEDICAL

GrandSlamX

RGK

SITZKISSEN

☐ XP080 **CHF 93** — Sitzkissen, Schaumstoff *(wählen Sie die Härte und Höhe des Kissens)*
☐ Weich (CMS040) ☐ Medium (CMS050) ☐ 100 mm
☐ 50 mm ☐ 75 mm
☐ Andere _____ *mm*

☐ XP340 **CHF 87** — Sitzkissen Plastazote (Hartschaum) *(bitte die max. Höhe angeben)*
☐ 58 mm ☐ 63 mm

Sitzkissenbezug

☐ XP085 — Nylonbezug, schwarz
☐ XP090 **CHF 72** — Sitzkissenbezug "Air Lite", schwarz
☐ XP380 **CHF 99** — Neoprenbezug, schwarz

GURTE

Klettverschlussgurte

☐ XS050 **CHF 133** — Klettverschlussgurt "pro", 100 mm, verstärkt und gepolstert, mit RGK-Stickerei

☐ XS055 **CHF 133** — Klettverschlussgurt "pro", 50 mm, verstärkt und gepolstert

☐ XS057 **CHF 134** — Knieklettverschlussgurt "pro", 50 mm *(von Rohr zu Rohr, über den Knien, gemessen)*

Position Klettverschlussgurte

☐ **Gurt 1** *Typ* _____

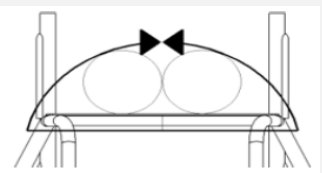

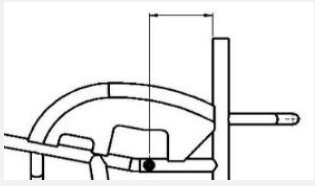

Gurtlänge _____ mm

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs _____ mm

☐ **Gurt 2** *Typ* _____

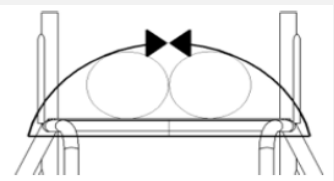

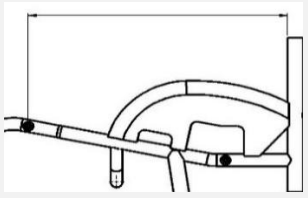

Gurtlänge _____ mm

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs _____ mm

Rastergurte

☐ XS020 **CHF 91** — Rastergurt "Sport" *(11" x 2" Polster)*

☐ XS021 **CHF 92** — Rastergurt "Sport" *(Polster durchgehend)*

☐ XS025 **CHF 236** — Rastergurt "Pelvi Loc 2DA" *(für Oberschenkel und Knie)*

Grösse:

☐ M (12") ☐ L (14")

☐ XS030 **CHF 252** — Rastergurt "Pelvi Loc 3DA" *(für die Hüften)*

Grösse:

☐ S (8") ☐ M (12") ☐ L (14") ☐ XL (17")

☐ XS035 **CHF 150** — Rastergurt "M2" *(für Oberschenkel und Knie)*

☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

☐ XS036 **CHF 149** — Rastergurt "M2" *(für die Füsse, Polsterung durchgehend)*

☐ 8" ☐ 10" ☐ 12"

☐ **Gurt 1** *Typ* _____

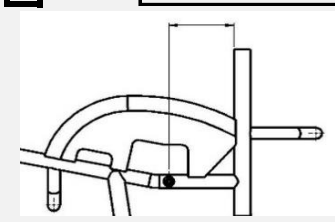

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs _____ mm

☐ **Gurt 2** *Typ* _____

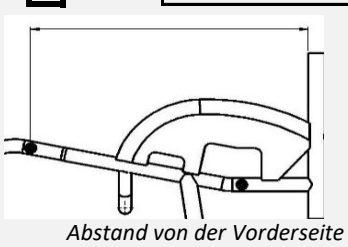

Abstand von der Vorderseite des Rückenrohrs _____ mm

☐ XS040 **CHF 95** — Befestigungspunkte zur Montage der Rastergurte am Rahmen *(ein Paar)* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

☐ XS045 **CHF 95** — Montageklemmen für Rastergurte *(ein Set pro Rastergurt)* ☐ x1 ☐ x2 ☐ x3

OPTIONEN

☐ XR060 **CHF 113** — Angeschweisste Ösen zur Wadenbandmontage



☐ XR065 **CHF 113** — Angeschweisste Ösen zur Gurtmontage



ZUBEHÖR

☐ XR030 **CHF 204** — Tasche für 3 Antriebsräder, schwarz

☐ XP130 **CHF 101** — Rahmenschutz, Nylon, gepolstert, mit Logo

☐ XS100 **CHF 101** — Brustgurt ☐ Kurz ☐ Lang

☐ XS070 — Fussband

☐ XS060 — Wadenband

■ XP400 — Schutz für das Rückenquerrohr, gepolstert, Klettverschluss

■ XR090 — Werkzeugsatz

SUNRISE MEDICAL

NOTIZEN – bitte Kommentare und Spezifikationen angeben!