F35

GUIDE DE COMPATIBILITÉ

MARQUE & MODÈLE	PINCES DE FIXATION	MARQUE & MODÈLE	PINCES DE FIXATION
BREEZY Basix²	D	RGK Octane	G
BREEZY Rubix²	D	RGK Octane Sub4	G
BREEZY Rubix² M	D	RGK Tiga	A
QUICKIE Argon²	A	RGK Tiga F2	A
QUICKIE Easy 200	A	RGK Tiga FX	A
QUICKIE EasyMax	A	RGK Tiga Sub4	A
QUICKIE EasyMax SA	A		
QUICKIE Helium	B		
QUICKIE Life	A		
QUICKIE Life R	A		
QUICKIE Life T	A		
QUICKIE Life RT	A		
QUICKIE Neon²	A		
QUICKIE Nitrum	B		
QUICKIE Nitrum Hybrid	B		
QUICKIE QS5 X	A		
QUICKIE Xenon²	B		
QUICKIE Xenon² Hybrid	B		
QUICKIE Xenon² SA	B		

Remarque : la liste ci-dessus donne une indication des modèles de fauteuils roulants sur lesquels le F35 peut être monté. Cependant la forme du cadre, le réglage du centre gravité et la profondeur d'assise ont une influence sur le montage. En outre, il faut une section droite d'au moins 35 mm pour pouvoir fixer les attaches aux tubes de châssis. C'est pourquoi il est essentiel de faire des essais et tests préalables pour être 100% sûr, ou alternativement de demander des conseils auprès de votre revendeur. La liste de produits compatibles montre uniquement les fauteuils roulants avec une clause signée. Sur la page suivante, vous trouverez des informations sur l'amarrage du F35. Voir la liste de prix pour les restrictions à respecter lorsque vous combinez le F35 avec des fauteuils roulants Sunrise Medical.

PB-EMPULSE-F35-COMPATIBILITY-GUIDE-BE-FR-REV-A01-260724

F35

INFORMATIONS SUR LES FIXATIONS

Le F35 est compatible avec les fauteuils roulants les plus courants répondant aux specifications suivantes :

TYPE DE CHÂSSIS (FERMÉ, OUVERT, CHÂSSIS FIXE OU REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLES)

» Tubes de châssis ronds de 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm et 30 mm.
» Tubes de châssis ovalisés (Xenon², Helium et Nitrum).

Pour le montage sur d'autres modèles de châssis vous pouvez commander des attaches spéciales. Voir la liste des produits compatibles et la liste de prix pour les détails.

VERSION A (EMD010029)
Pour tubes ronds. Adaptable aux diamètres 19.5 mm, 23 mm, 25 mm, 28.6 mm et 30 mm grâce au kit de réducteurs (inclus).

VERSION B (EMD010030)
Compatible avec les tubes ovalisés de Nitrum, Xenon² et Xenon² Hybrid.

VERSION D (EMD010031)
Compatible avec Xenon² SA.

VERSION G (EMD010062)
Pour tubes ronds. Adaptable aux diamètre de 32 mm.

POSITION DES ATTACHES

L'angle optimal de la F35 par rapport au sol est de 80°. Pour des performances optimales, il est recommandé de monter les pinces d'arrimage à une hauteur minimale de 249 mm et maximale de 370 mm (mesurée du sol à la partie supérieure de la pince).

LARGEUR DU CHÂSSIS

Mesurez le châssis avant du fauteuil roulant (distance entre les centres des tubes):

» En cas d'ajustement de châssis, la position de montage des pinces doit se situer en dessous de la courbure.
» La largeur mesurée différe de la largeur d'assise du fauteuil en raison de la méthode de mesure ou la version du cadre (ajustement de châssis, châssis en V, abduction ou adduction, etc.).
» Pour vérifier la compatibilité, comparez la largeur mesurée (jamais la largeur d'assise) avec la plage de montage.
» Plage de montage : 260 à 480 mm.

PB-EMPULSE-F35-COMPATIBILITY-GUIDE-BE-FR-REV-A01-260724

SUNRISE MEDICAL

Empulse

NO-GO CHECKER

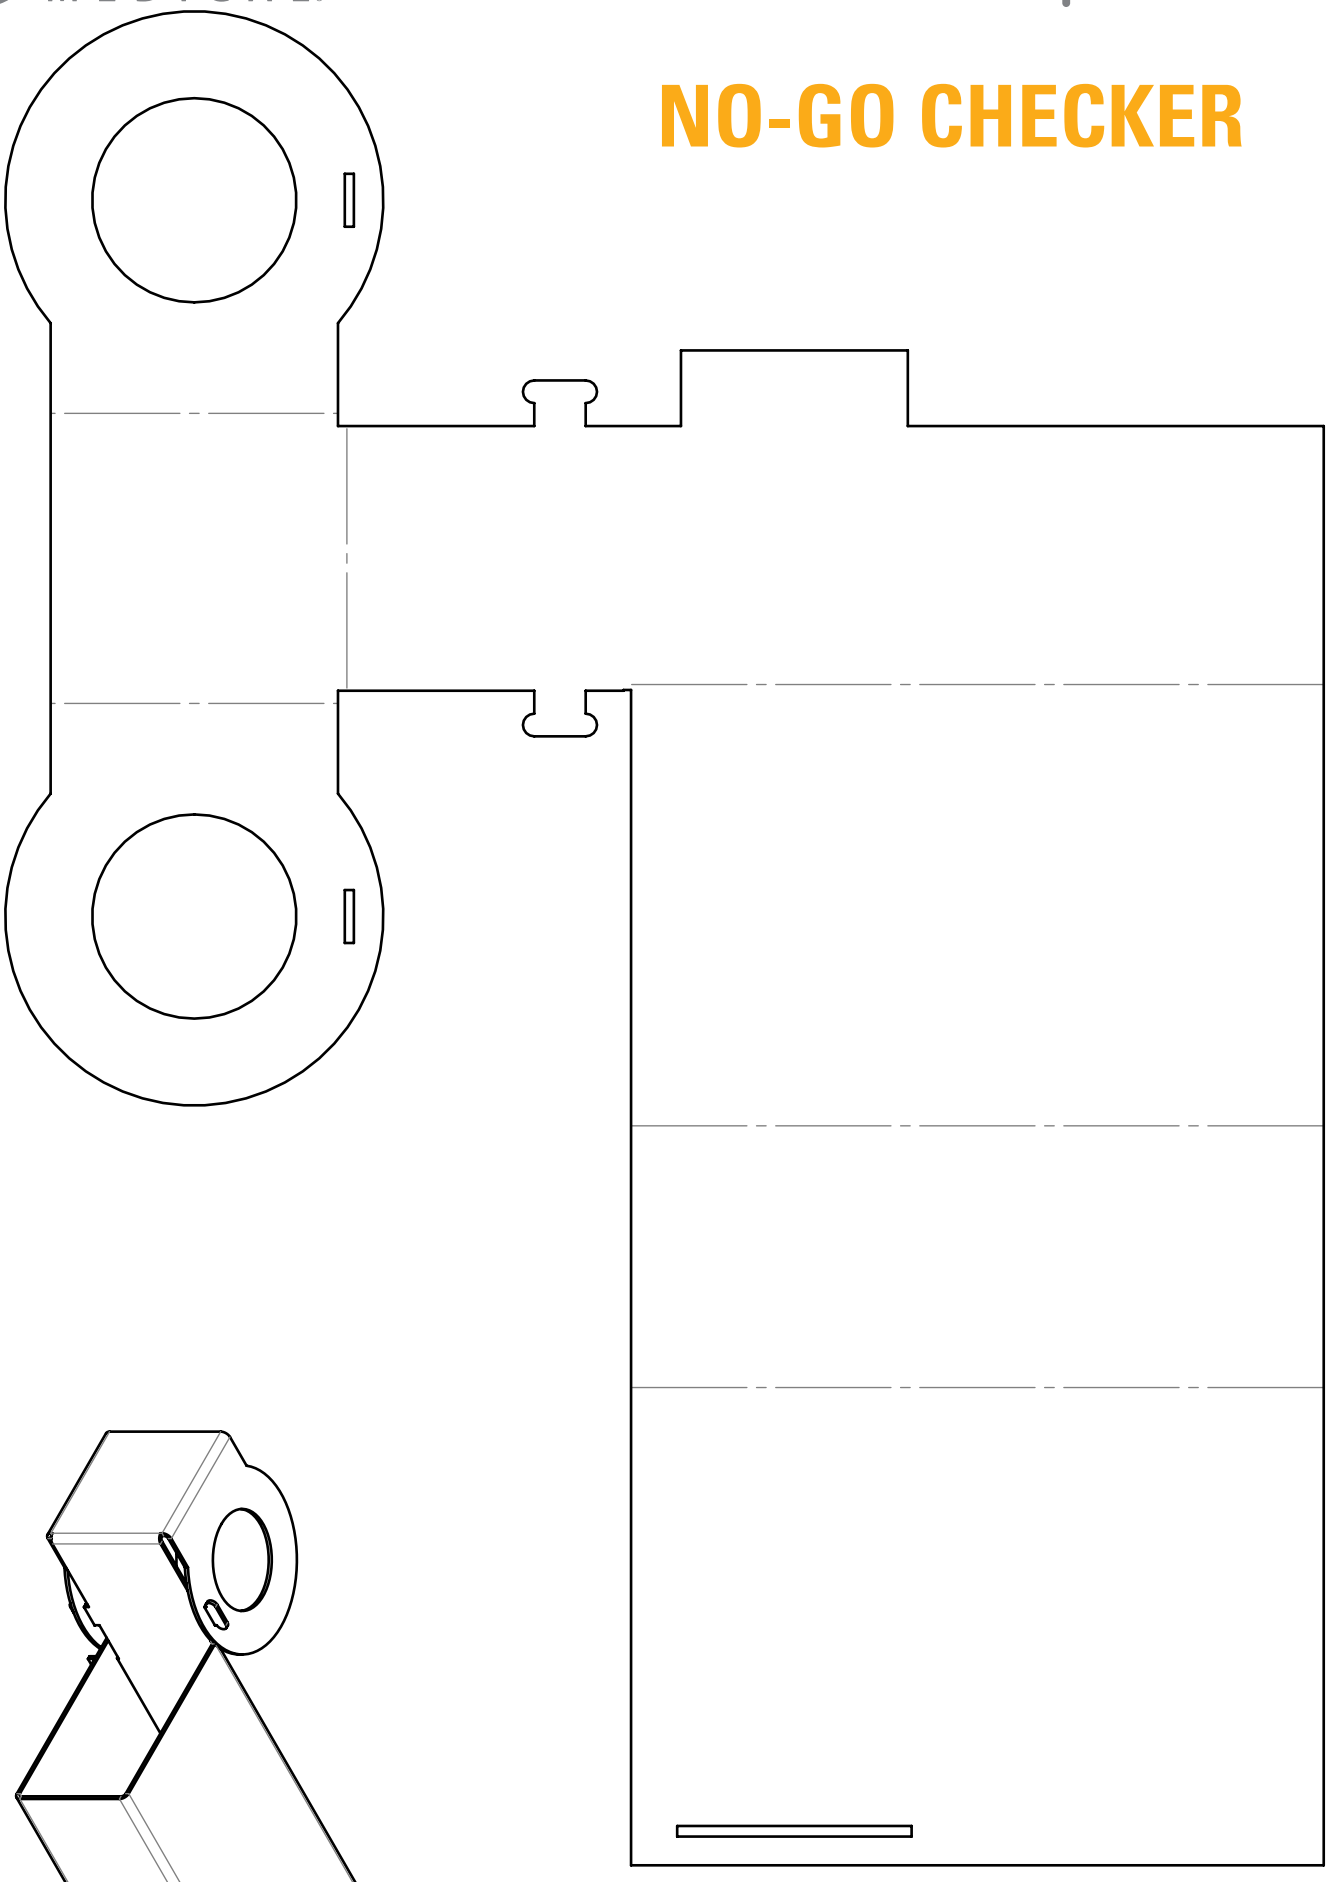

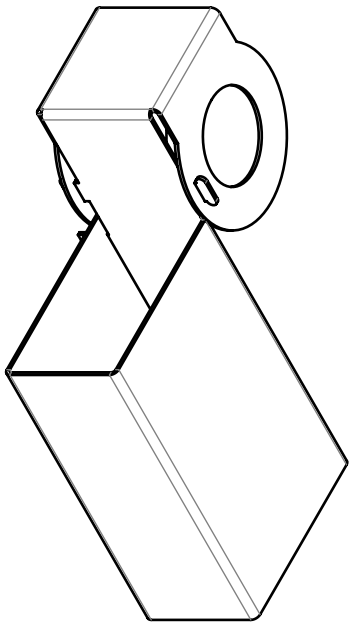

PB-EMPULSE-F35-COMPATIBILITY-GUIDE-BE-FR-REV-A01-260724

NO-GO CHECKER

FAUTEUILS ROULANTS SUNRISE MEDICAL

Tous no-go's sont basés sur des roues de 24 pouces.

QUICKIE ARGON2 PINCES DE FIXATION A

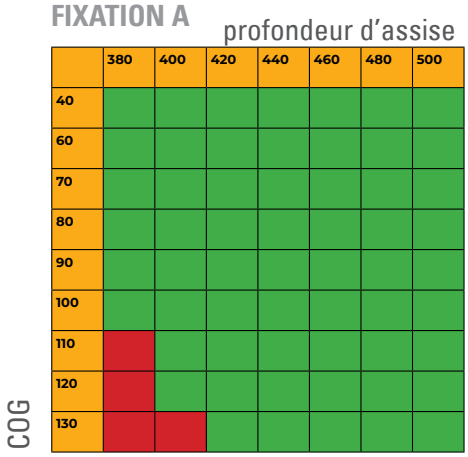

QUICKIE LIFE FF PINCES DE FIXATION A

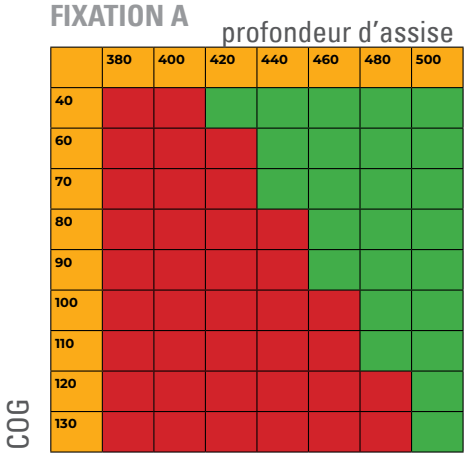

QUICKIE LIFE SA PINCES DE FIXATION A

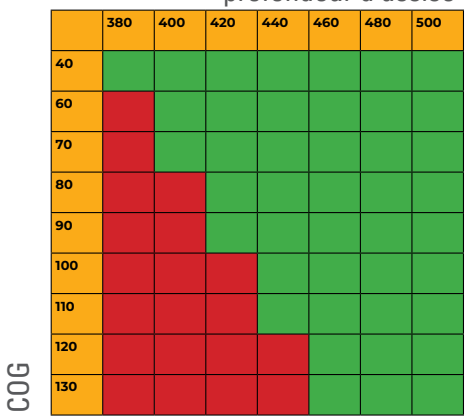

QUICKIE LIFE R FF PINCES DE FIXATION A

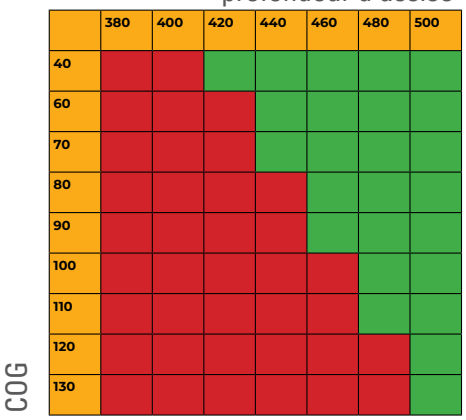

QUICKIE LIFE R SA PINCES DE FIXATION A

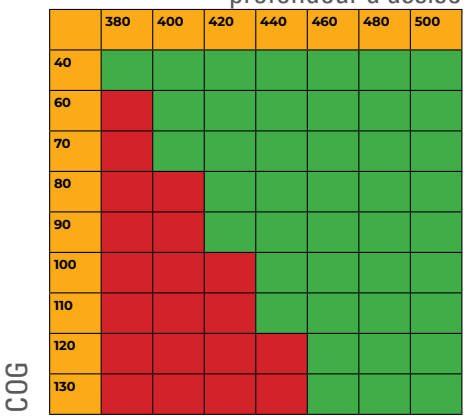

QUICKIE NEON2 PINCES DE FIXATION A

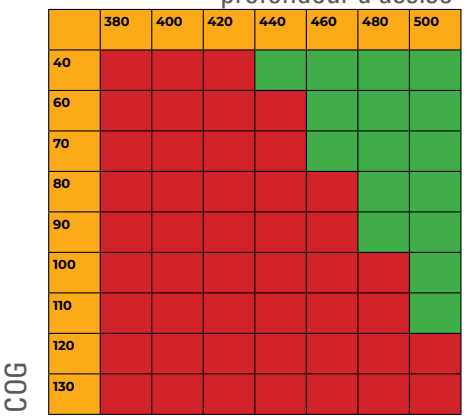

NO-GO CHECKER

FAUTEUILS ROULANTS SUNRISE MEDICAL

Tous no-go's sont basés sur des roues de 24 pouces.

QUICKIE NITRUM & NITRUM HYBRID
PINCES DE FIXATION B

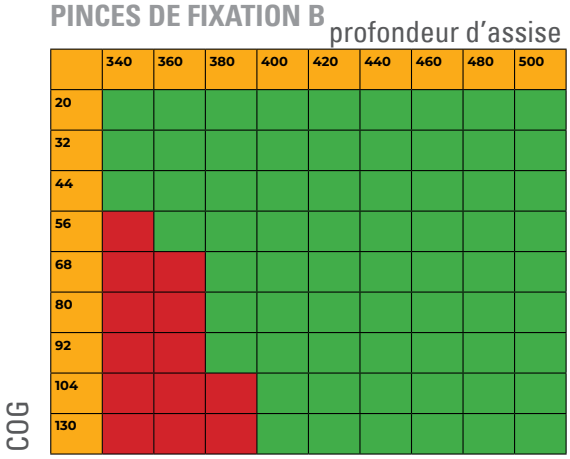

QUICKIE XENON² PINCES DE FIXATION B

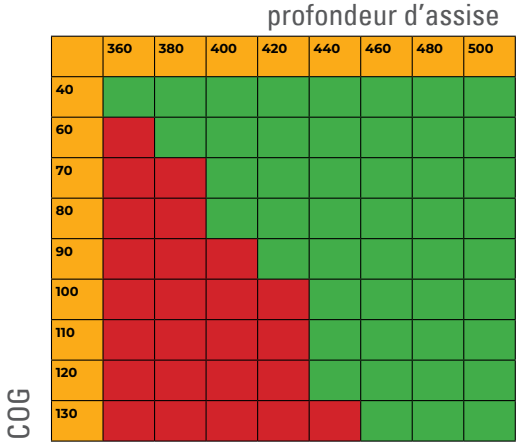

QUICKIE XENON² HYBRID PINCES DE FIXATION B

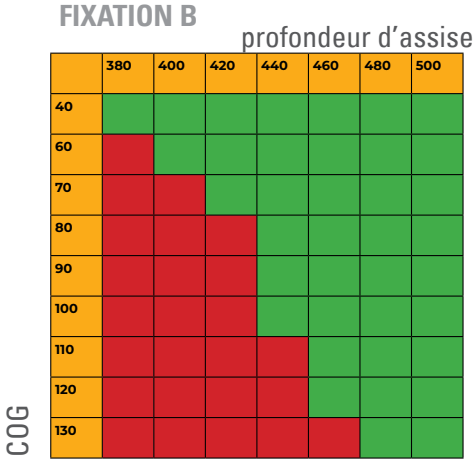

QUICKIE XENON² SA PINCES DE FIXATION B

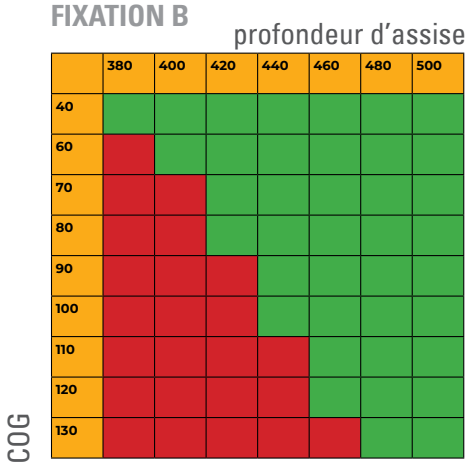

QUICKIE QS5X PINCES DE FIXATION A

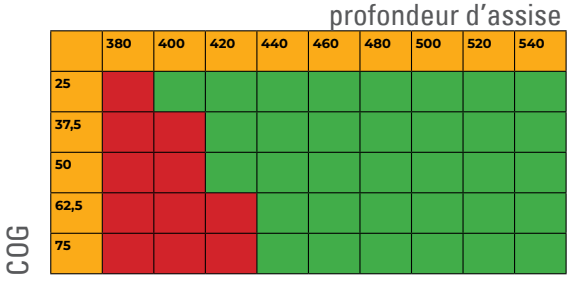

24" roues

QUICKIE QS5X PINCES DE FIXATION A

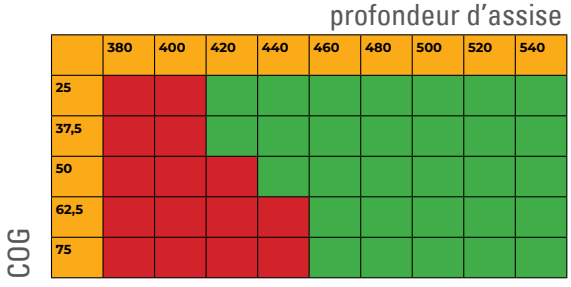

25" roues

PB-EMPULSE-F35-COMPATIBILITY-GUIDE-BE-FR-REV-A01-260724